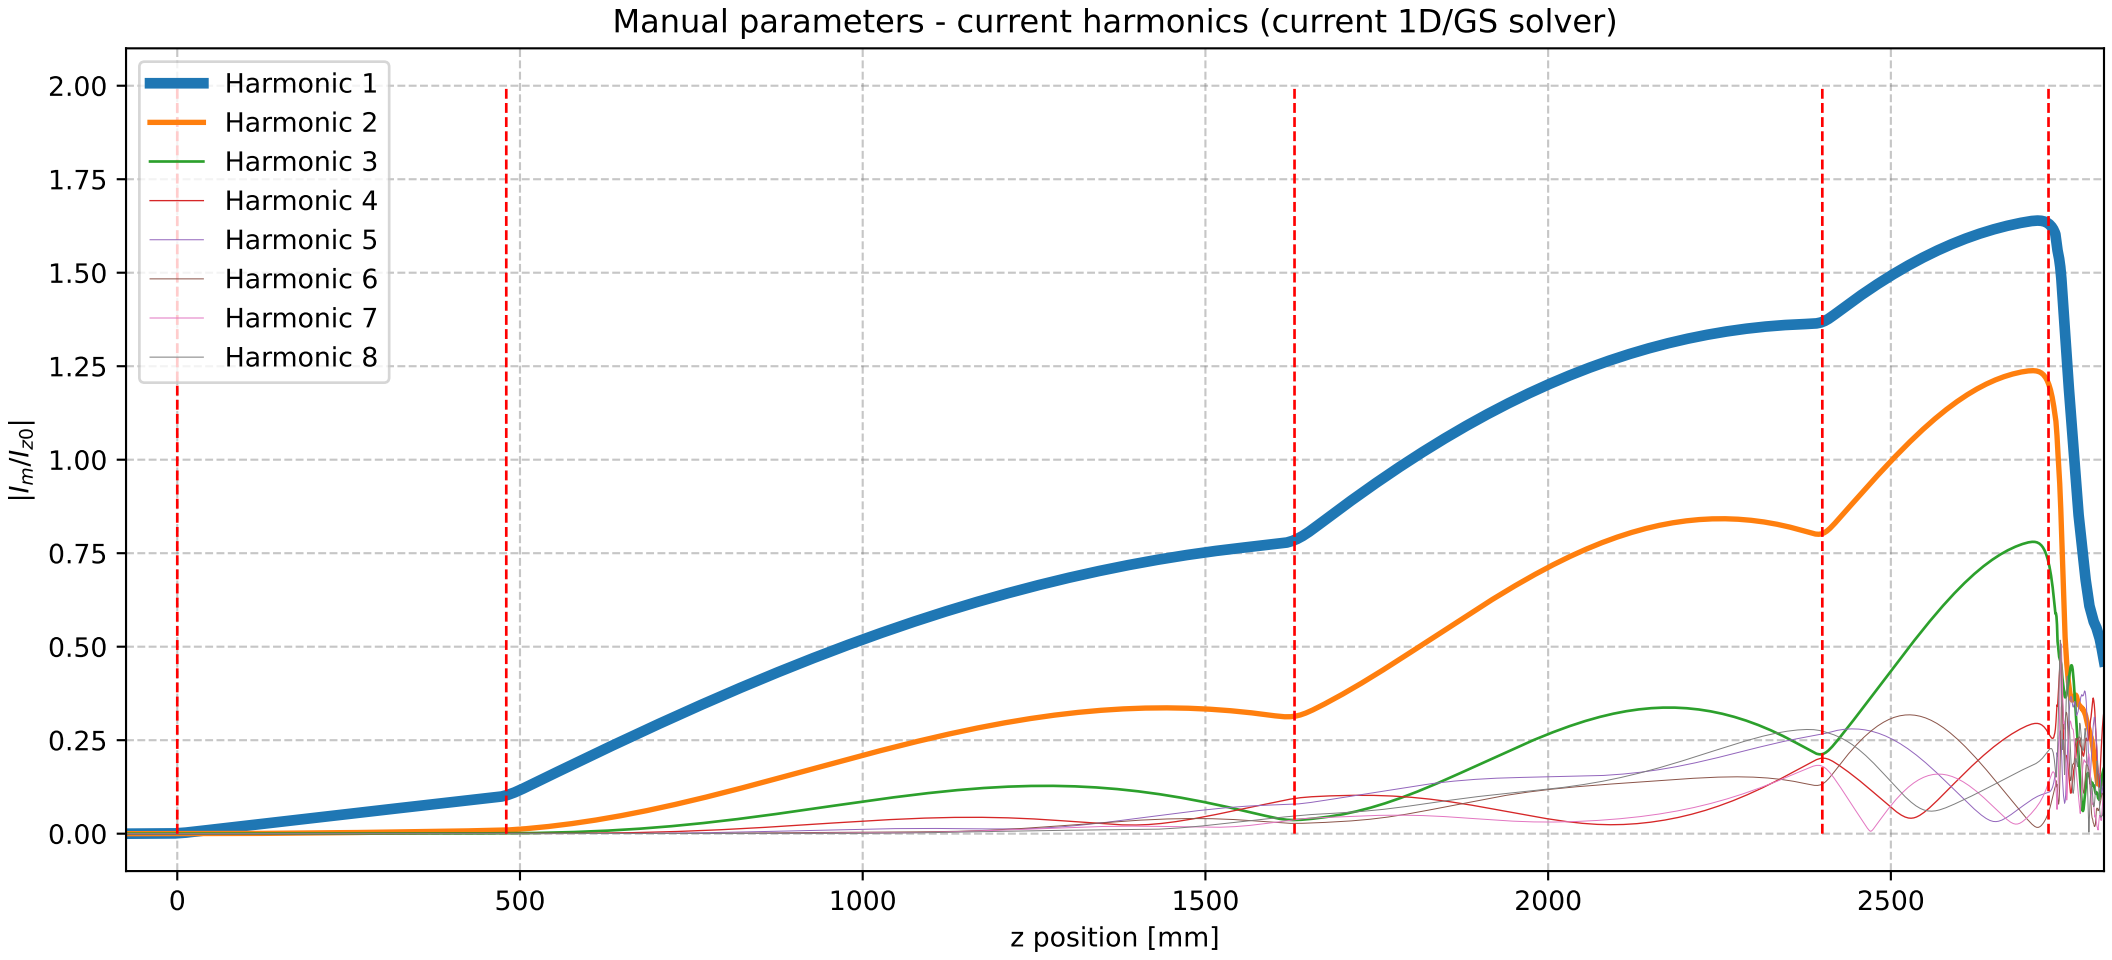
Manual parameters - current harmonics (current 1D/GS solver)
Harmonic 1
Harmonic 2
Harmonic 3
Harmonic 4
Harmonic 5
Harmonic 6
Harmonic 7
Harmonic 8
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
$|I_m/I_{z0}|$
0
500
1000
1500
2000
2500
z position [mm]