TGA_LTC-PH122_ANA1410

13.01.2026 15:10:20

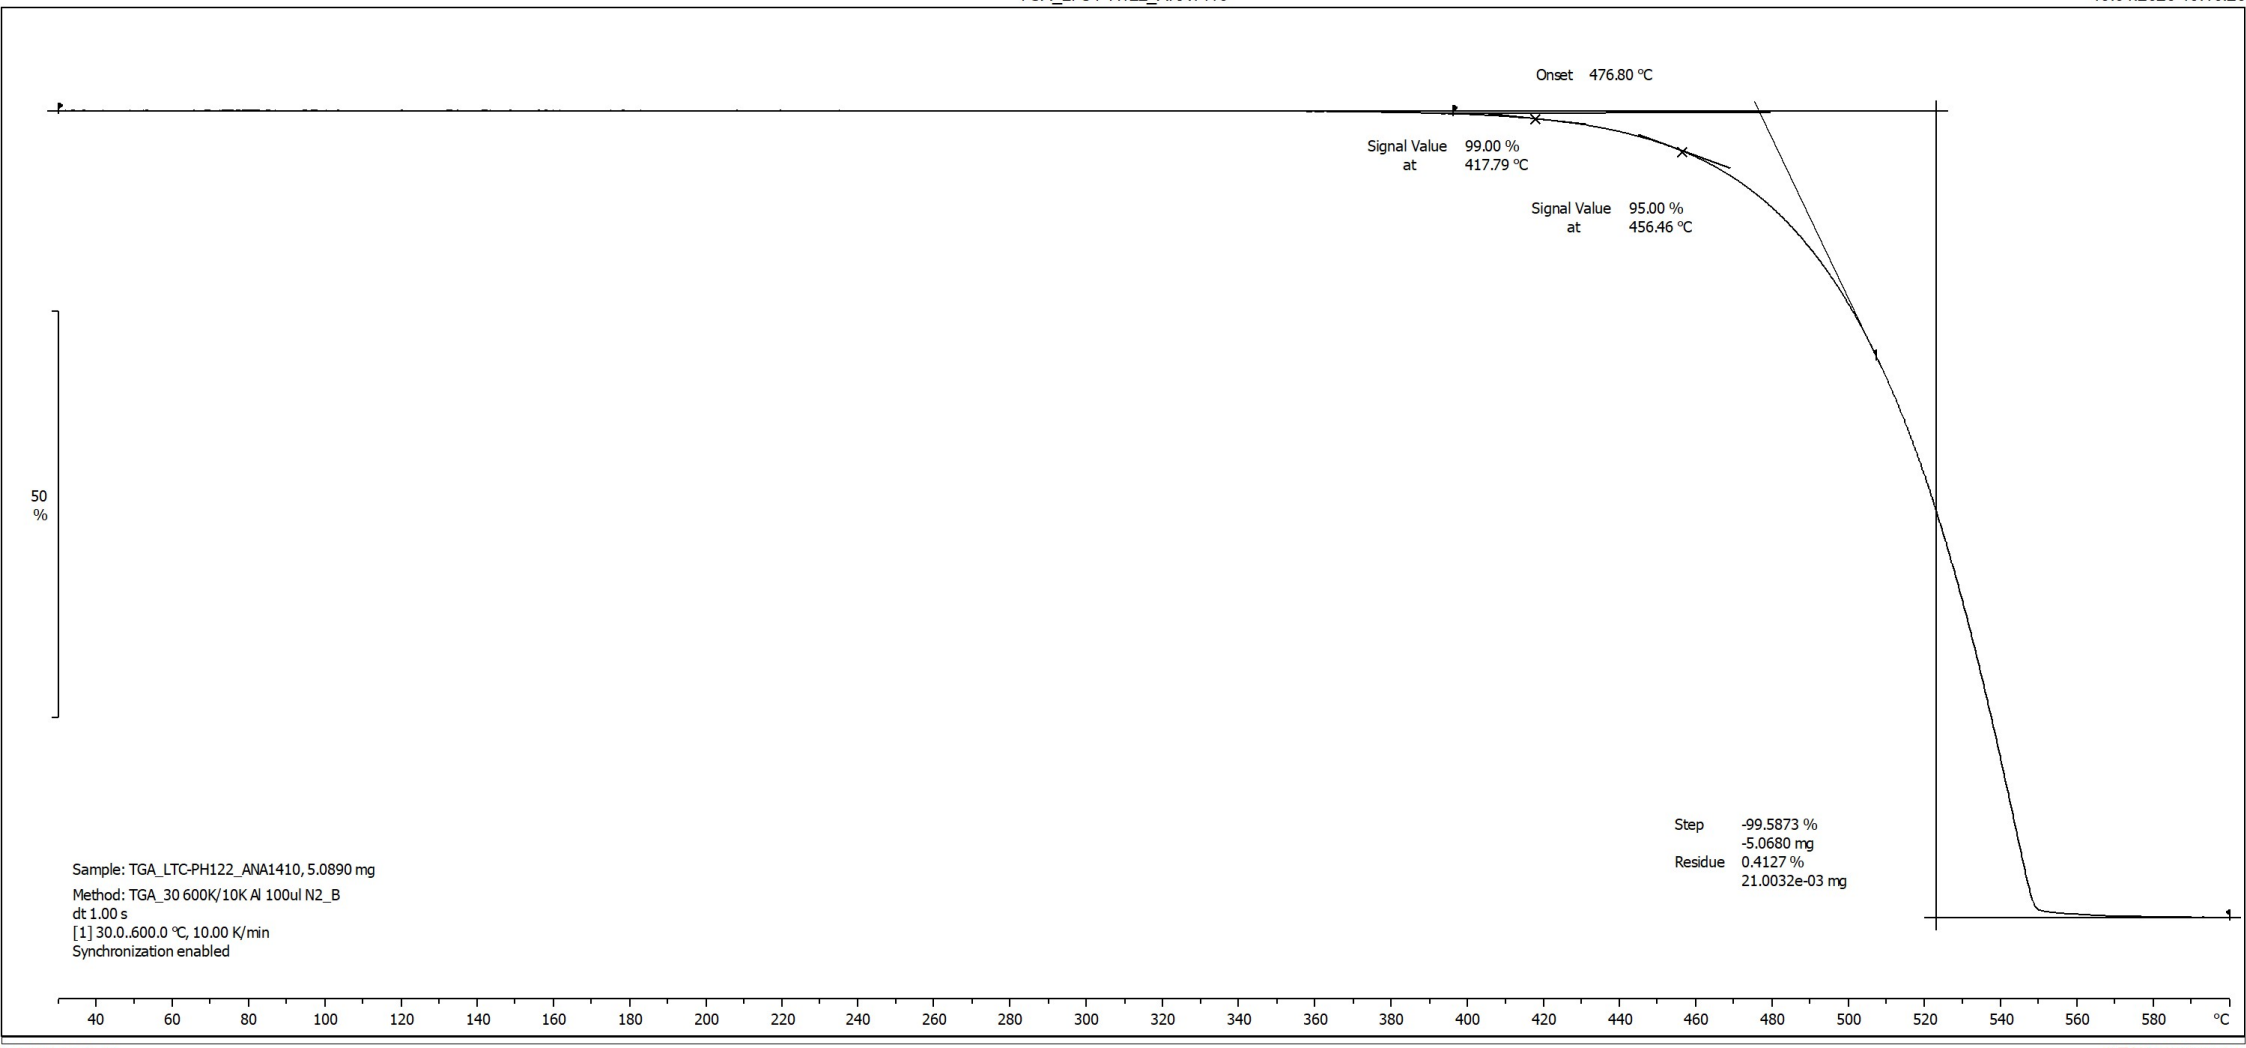

Lab: METTLER

STAR® SW 18.00

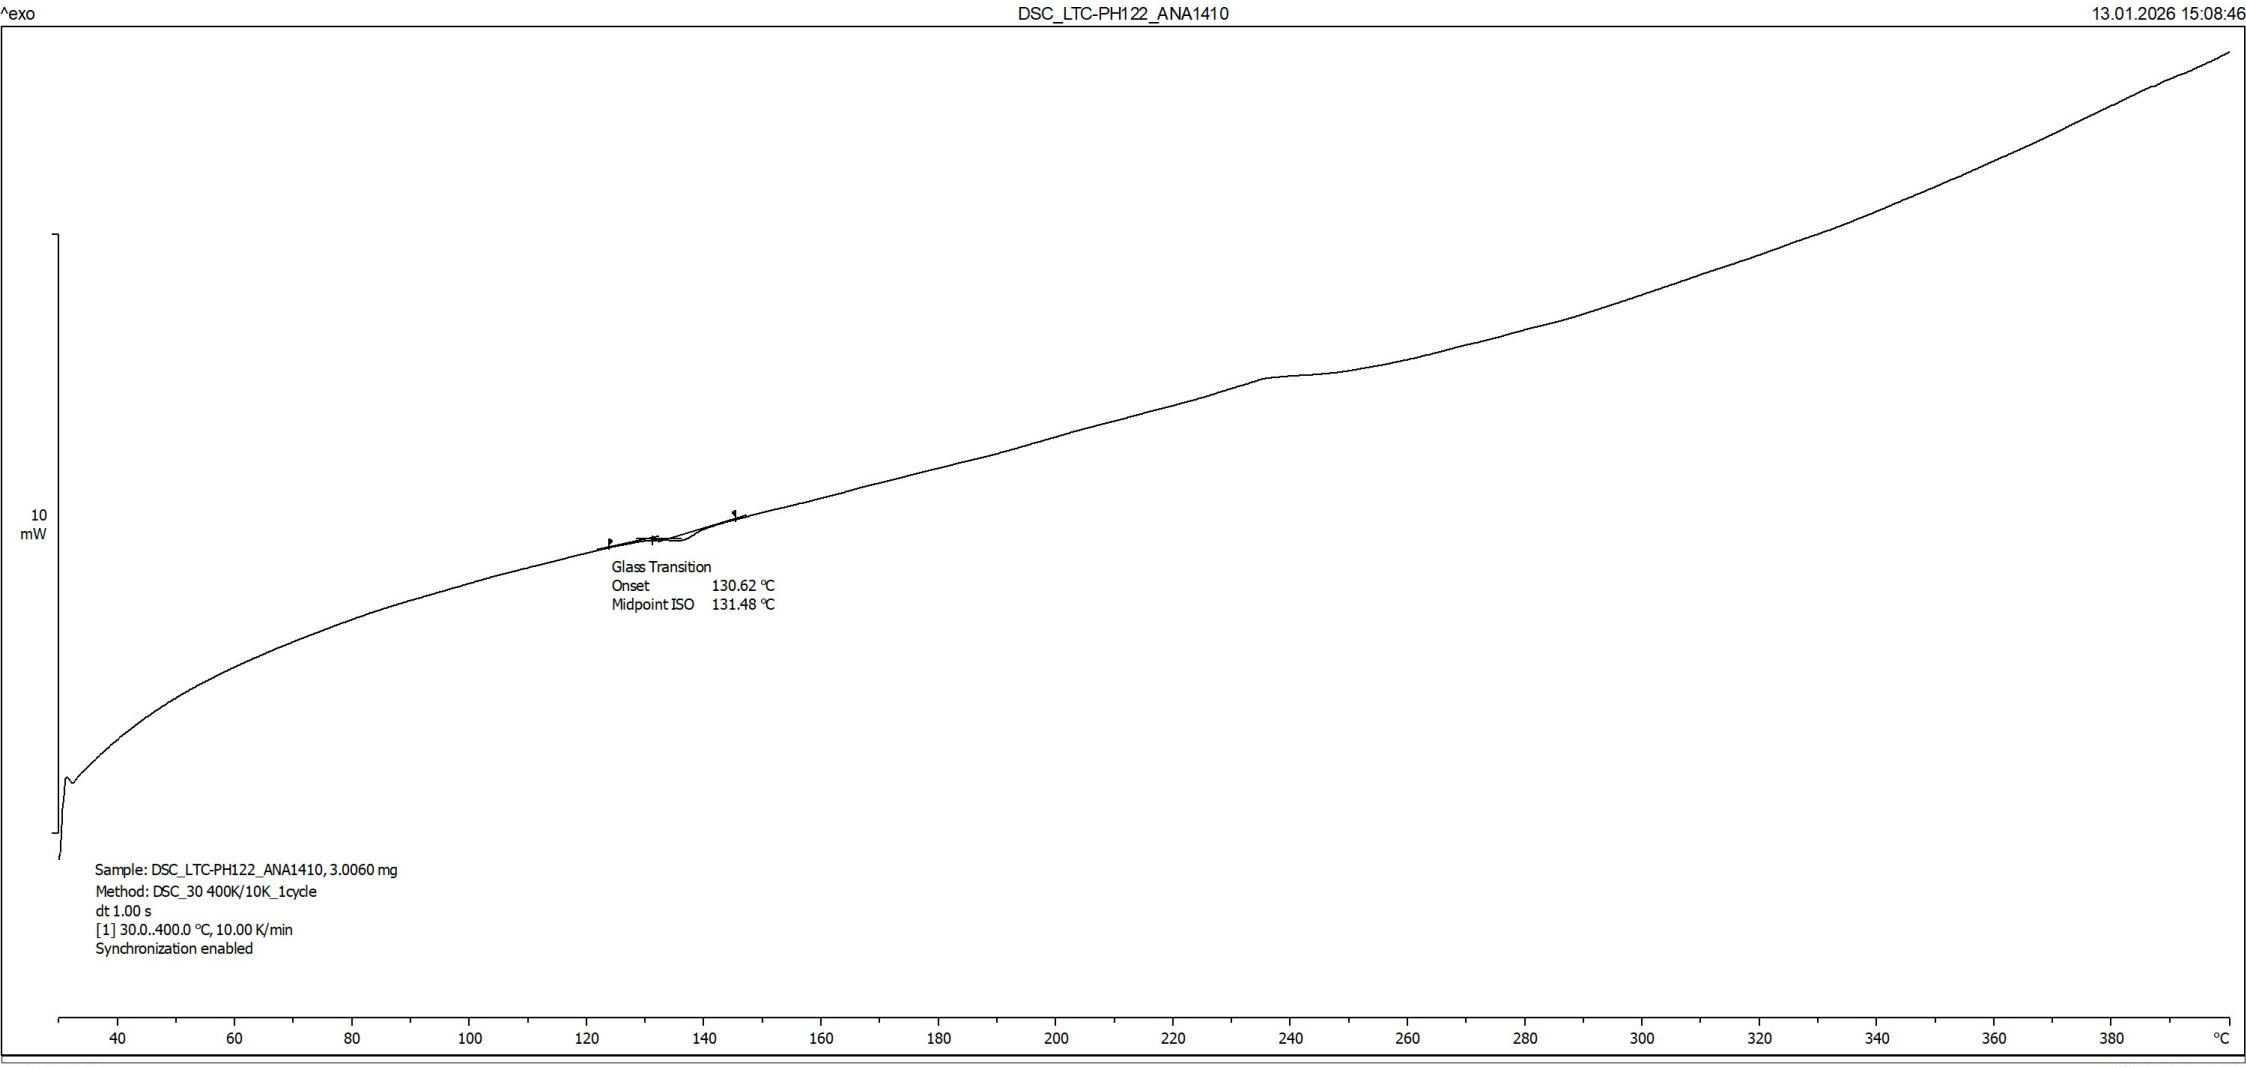
^exo
DSC_LTC-PH122_ANA1410
13.01.2026 15:08:46
10
mW
Glass Transition
Onset 130.62 °C
Midpoint ISO 131.48 °C
Sample: DSC_LTC-PH122_ANA1410, 3.0060 mg
Method: DSC_30 400K/10K_1cycle
dt 1.00 s
[1] 30.0..400.0 °C, 10.00 K/min
Synchronization enabled
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
°C
Lab: METTLER
STAR® SW 18.00