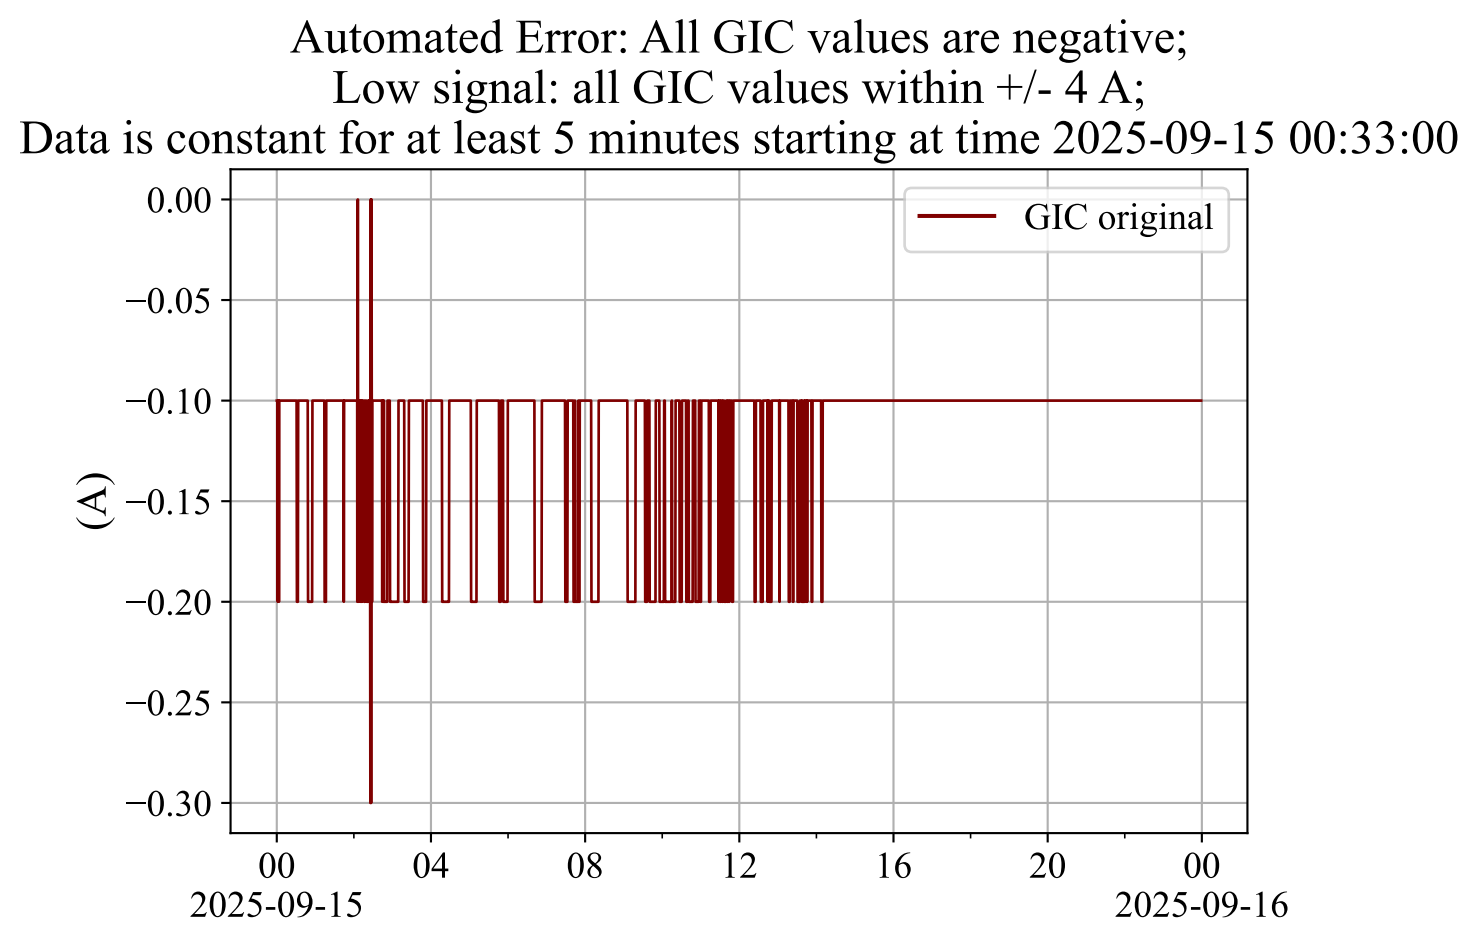
Automated Error: All GIC values are negative;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-09-15 00:33:00
GIC original
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
(A)
00
2025-09-15
04
08
12
16
20
00
2025-09-16