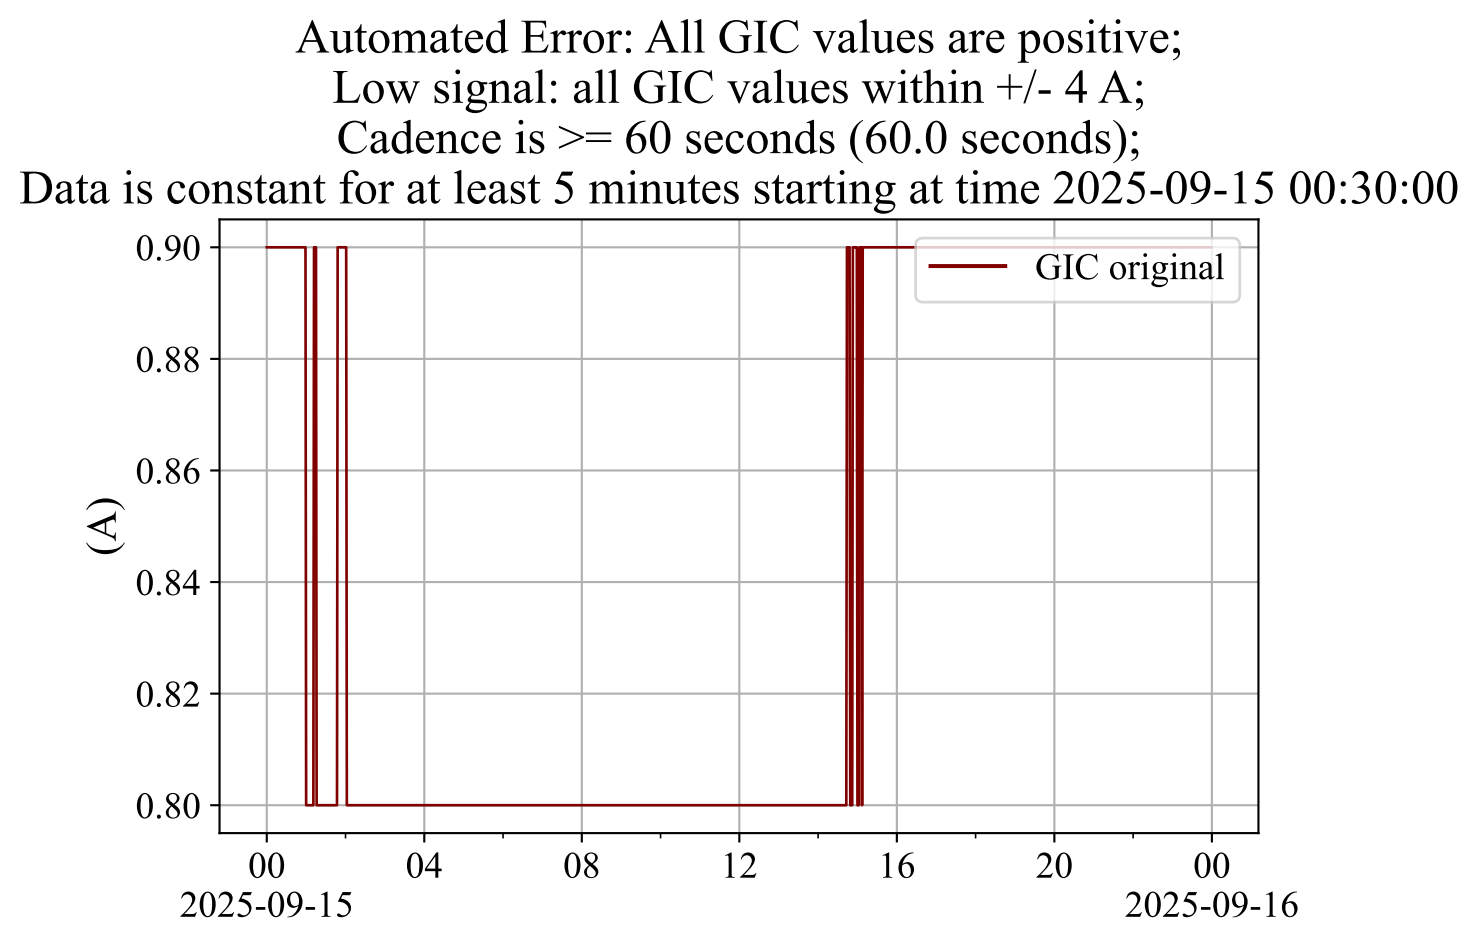
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-09-15 00:30:00
GIC original
(A)
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
00
2025-09-15
04
08
12
16
20
00
2025-09-16