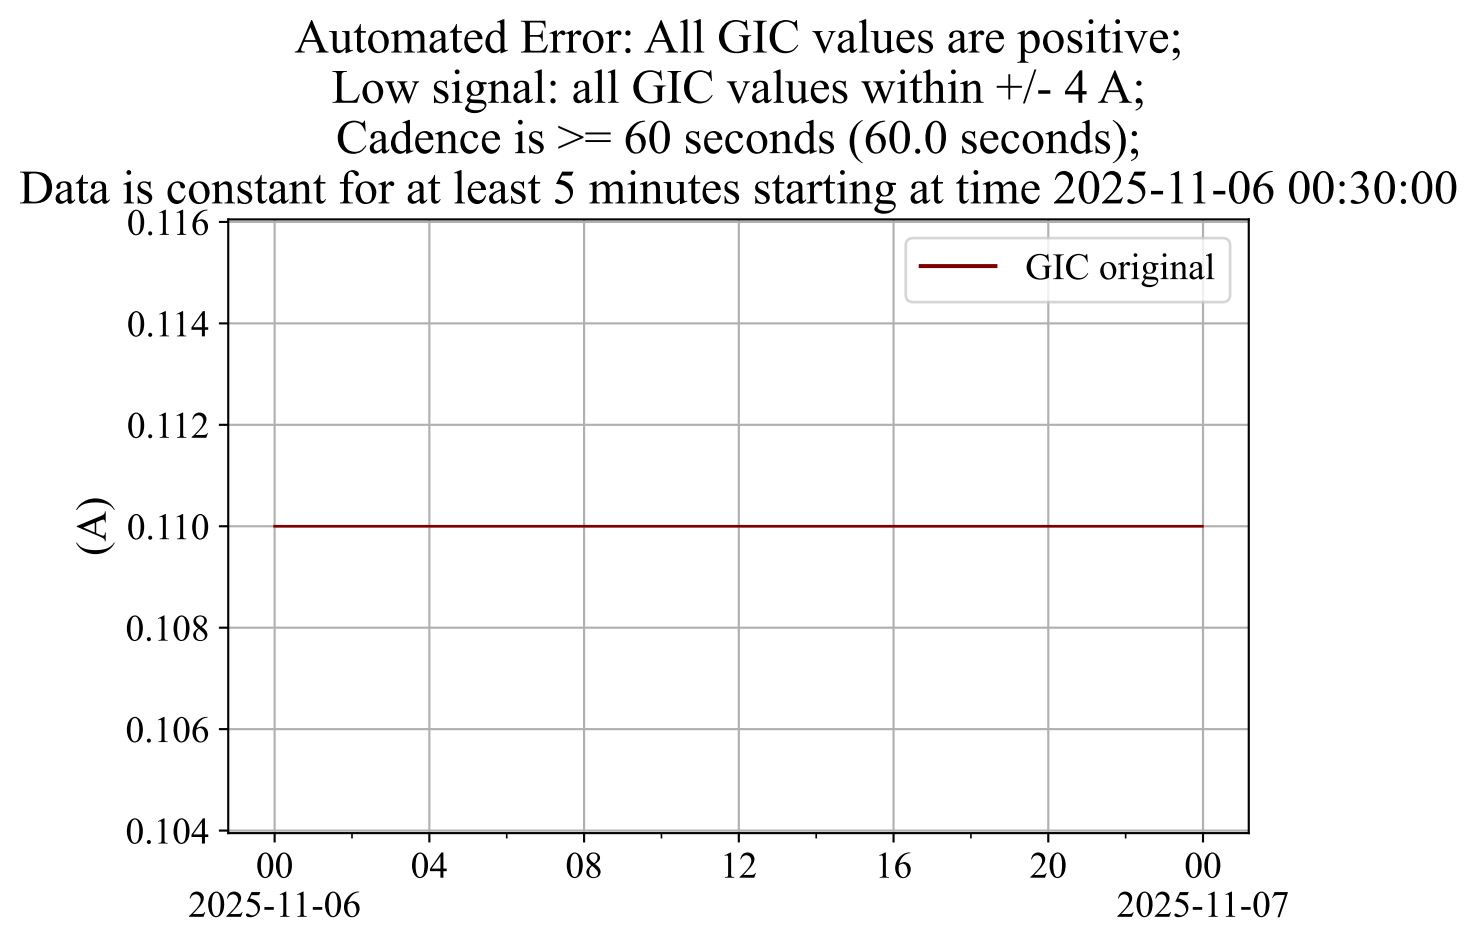
Automated Error: All GIC values are positive;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-06 00:30:00
GIC original
(A)
0.116
0.114
0.112
0.110
0.108
0.106
0.104
00
04
08
12
16
20
00
2025-11-06
2025-11-07