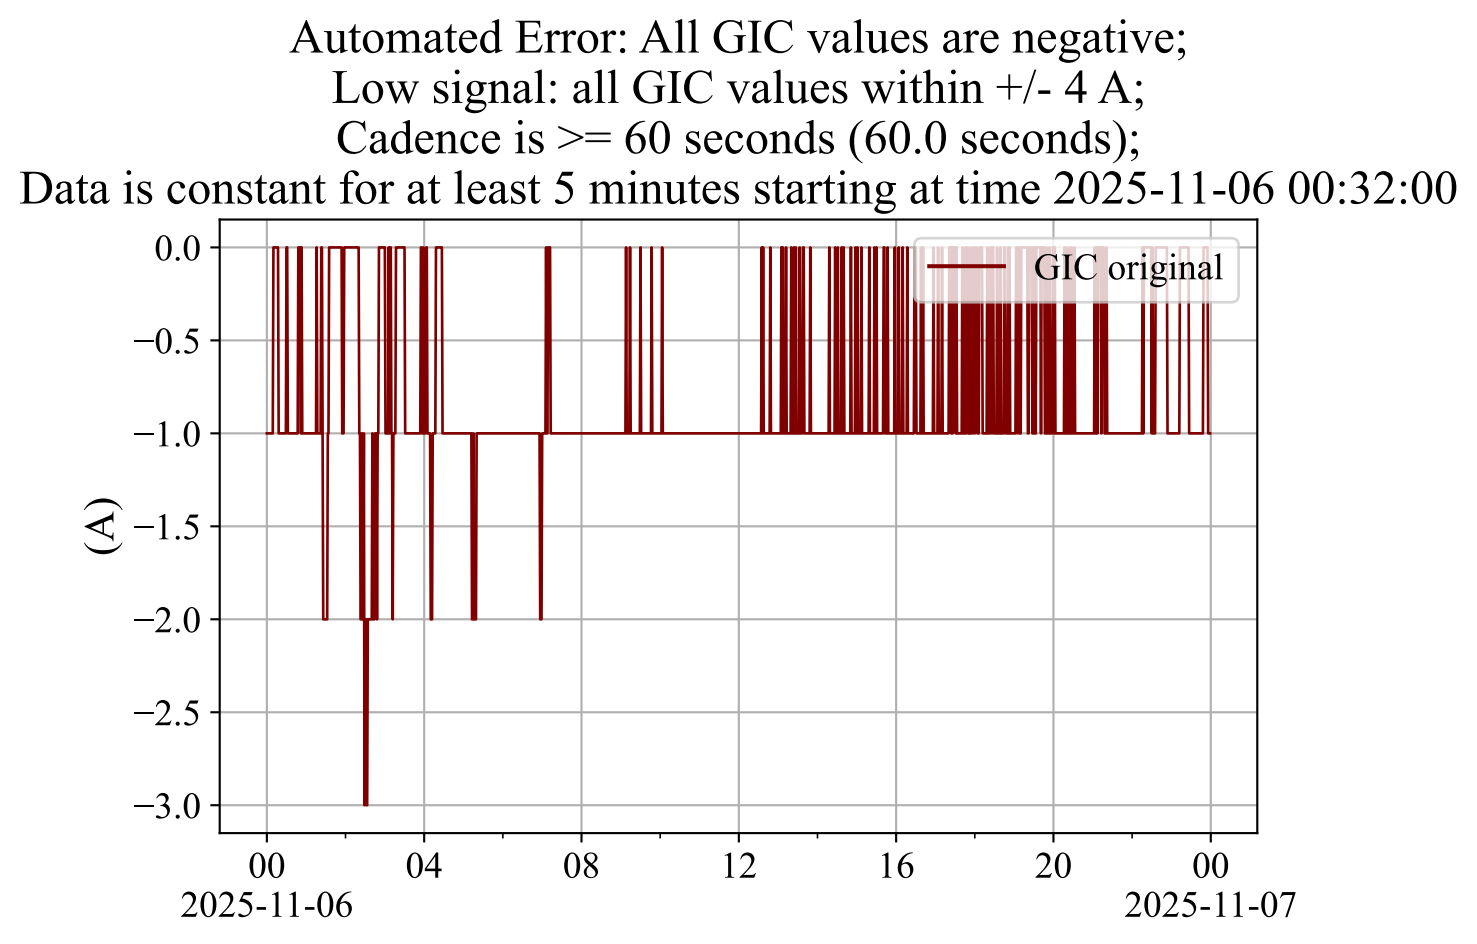
Automated Error: All GIC values are negative;
Low signal: all GIC values within +/- 4 A;
Cadence is >= 60 seconds (60.0 seconds);
Data is constant for at least 5 minutes starting at time 2025-11-06 00:32:00
GIC original
(A)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
00
2025-11-06
04
08
12
16
20
00
2025-11-07