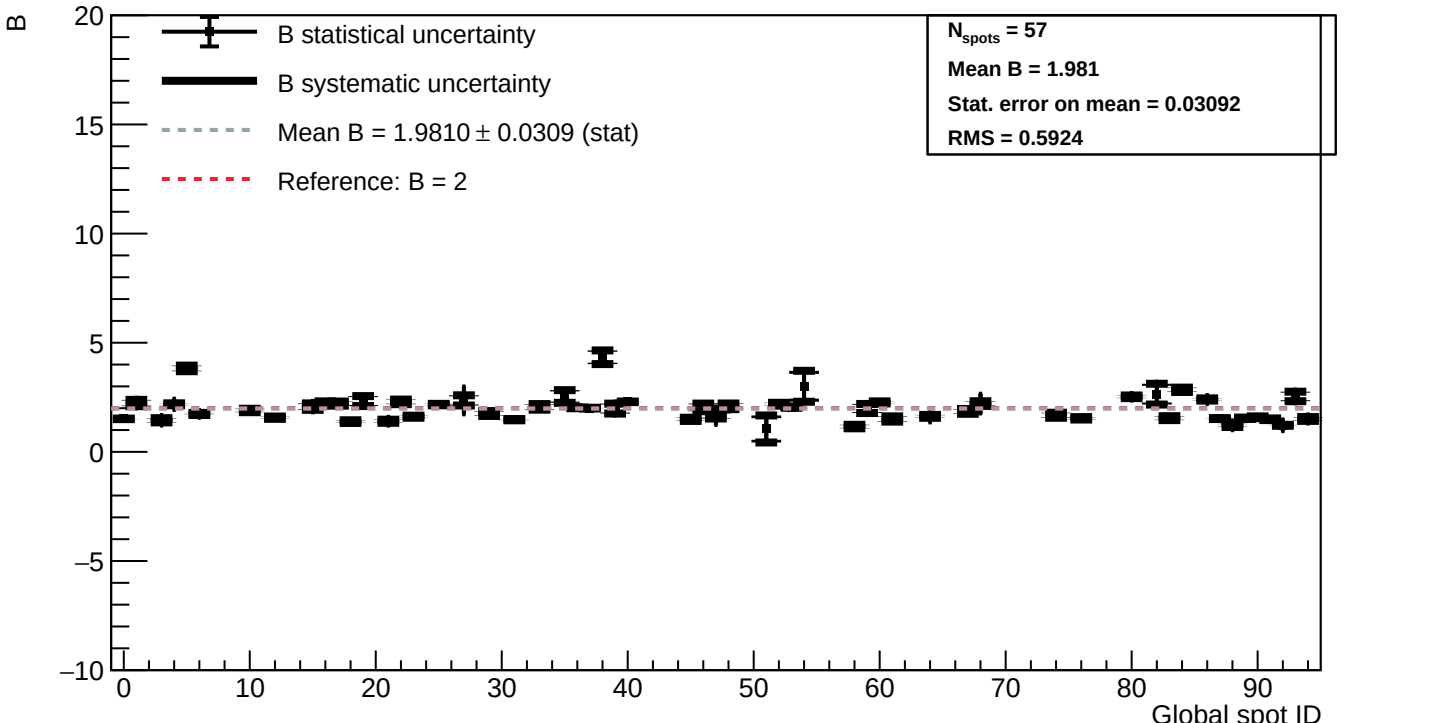
Sensor B1 - Power-law exponent B - annealing_T=100_h=25
B
B statistical uncertainty
B systematic uncertainty
Mean B = 1.9810 ± 0.0309 (stat)
Reference: B = 2
N_spots = 57
Mean B = 1.981
Stat. error on mean = 0.03092
RMS = 0.5924
20
15
10
5
0
−5
−10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Global spot ID