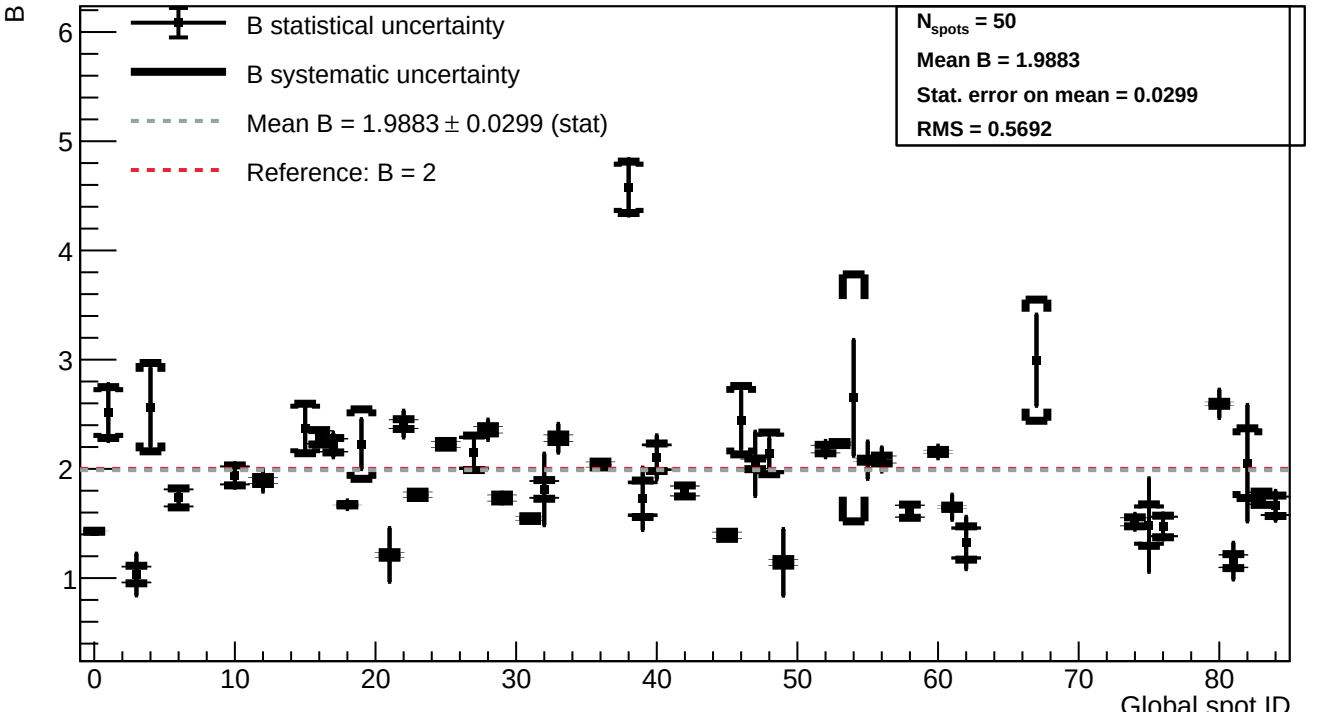
Sensor B1 - Power-law exponent B - annealing_T=100_h=5
B
B statistical uncertainty
B systematic uncertainty
Mean B = 1.9883 ± 0.0299 (stat)
Reference: B = 2
N_spots = 50
Mean B = 1.9883
Stat. error on mean = 0.0299
RMS = 0.5692
Global spot ID