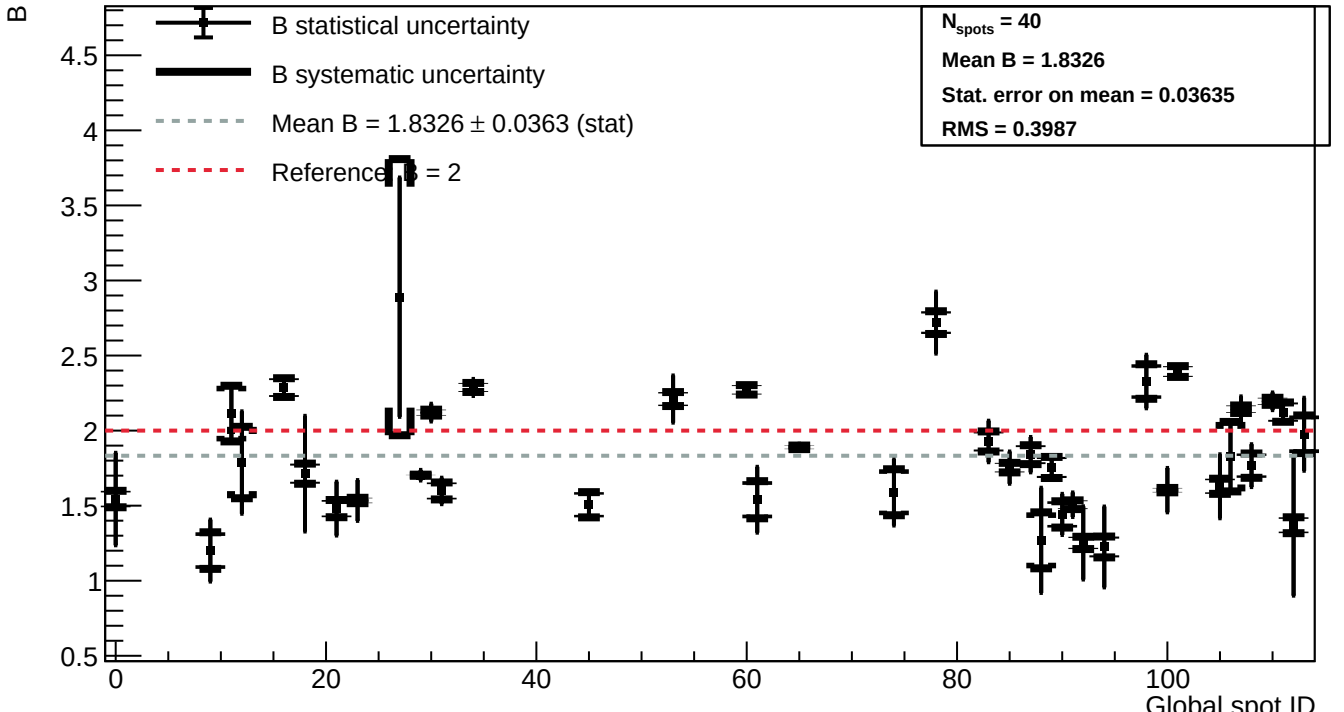
Sensor B1 - Power-law exponent B - annealing_T=150_h=5
B
B statistical uncertainty
B systematic uncertainty
Mean B = 1.8326 ± 0.0363 (stat)
Reference B = 2
N_spots = 40
Mean B = 1.8326
Stat. error on mean = 0.03635
RMS = 0.3987
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
20
40
60
80
100
Global spot ID