



Calibración de Electrodo de pH

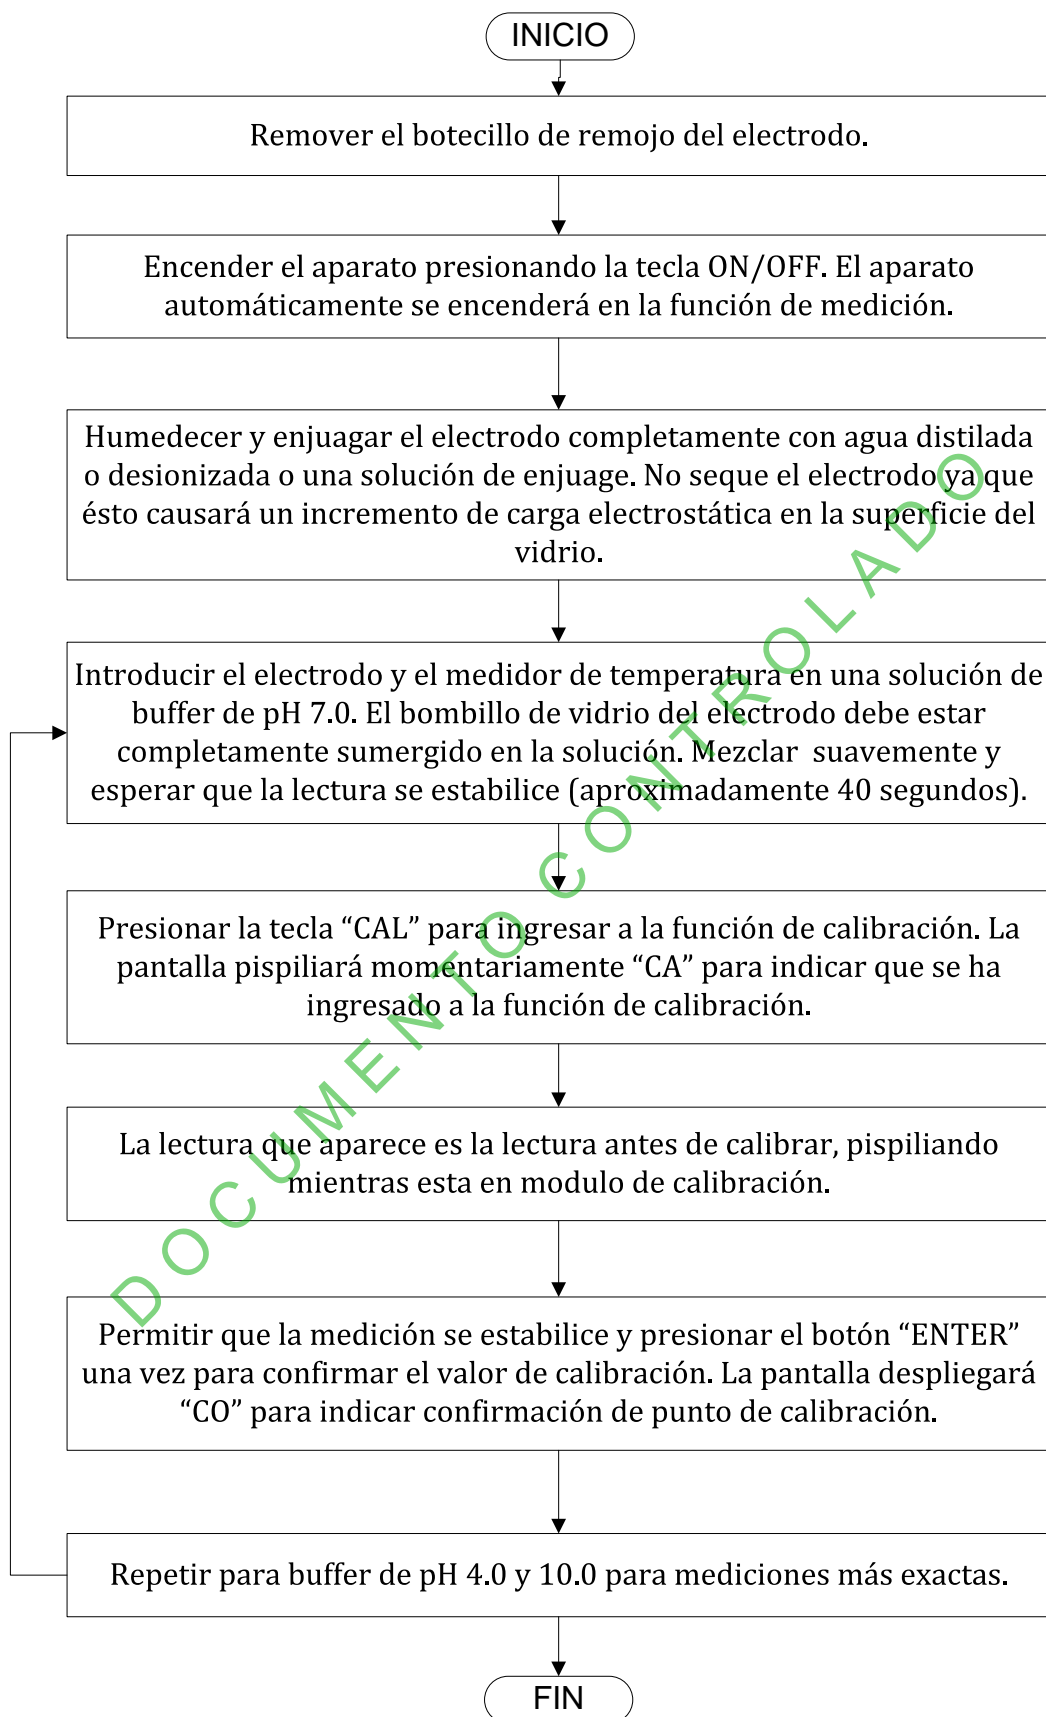

ADVERTENCIA:

NO debe reutilizar buffer que ha sido usado para calibrar anteriormente. Contaminantes en la solución de buffer puede afectar la calibración y la exactitud de las mediciones.

Calibración de Sensor de Temperatura

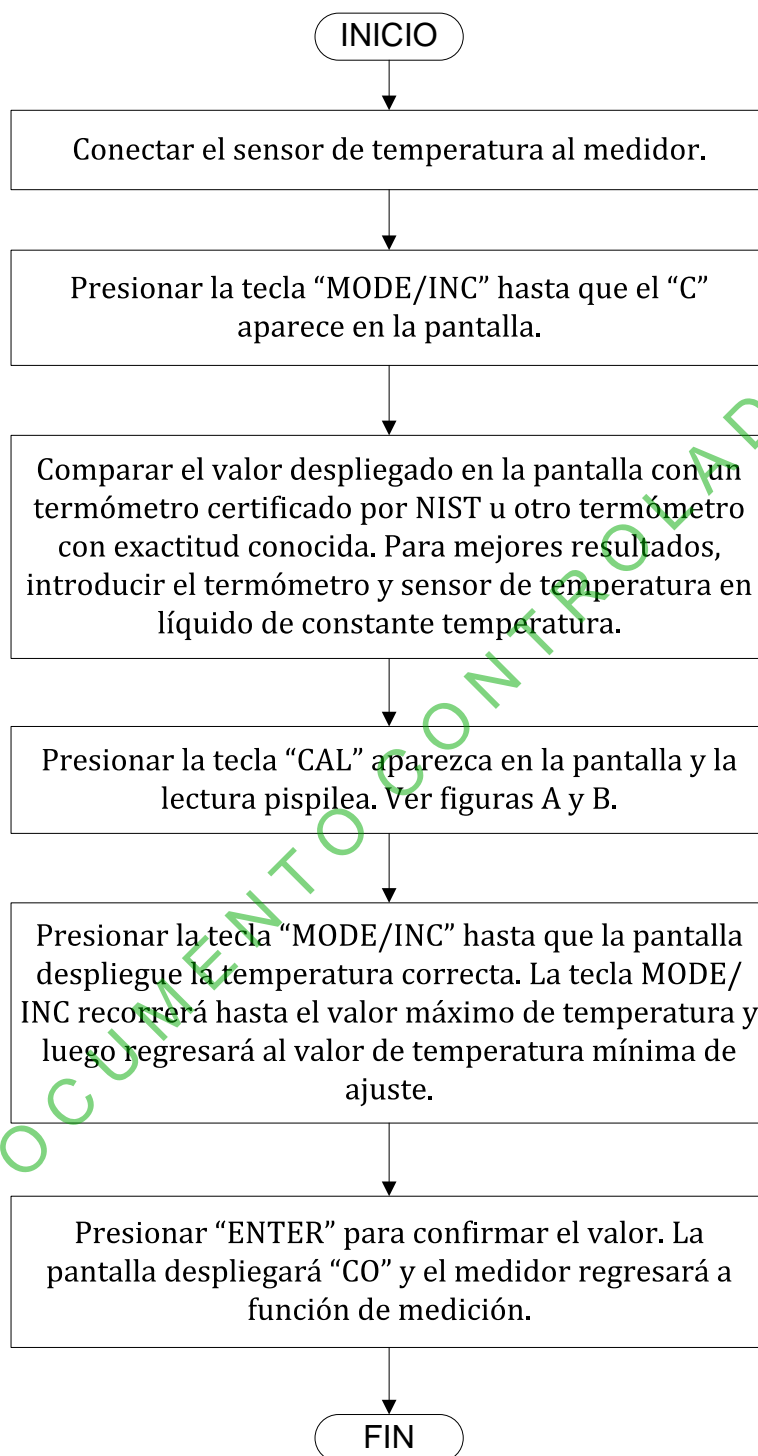

Medición de pH

