

CALIBRACIÓN DE RECIPIENTE DE MEDIDA METÁLICO (SEGÚN ASTM C-29)

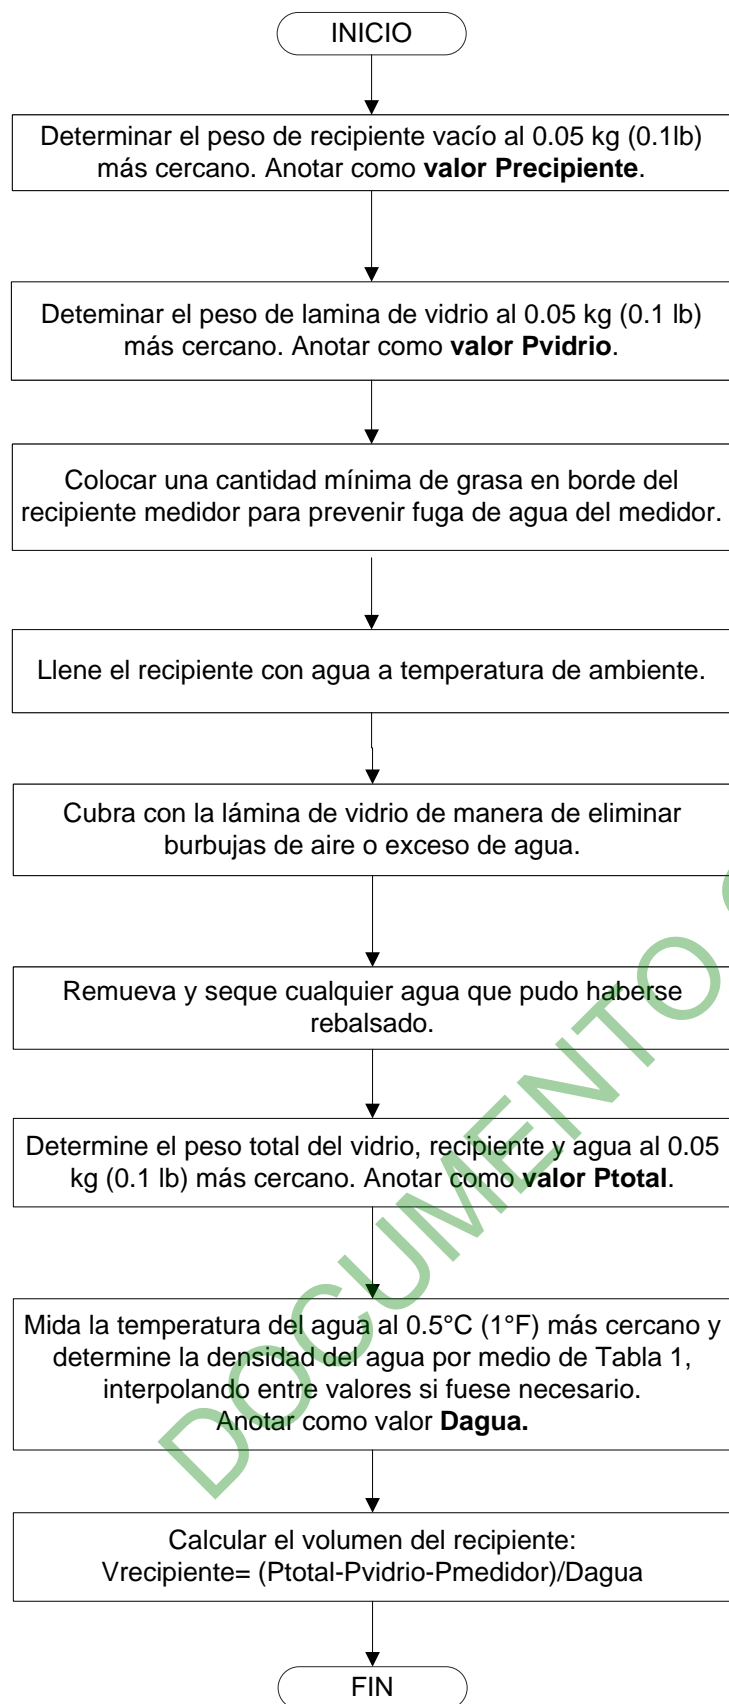


Tabla 1- Densidad del Agua en función de temperatura

Temperatura		kg/m3	lb/ft3
°C	°F		
15.6	60.0	999.01	62.366
18.3	65.0	998.54	62.336
21.1	70.0	997.97	62.301
23.0	73.4	997.54	62.274
23.9	75.0	997.32	62.261
26.7	80.0	996.59	62.216
29.4	85.0	995.83	62.166

NOTA: Recipiente medidor debe ser calibrada una vez al año o cuando haya razón para dudar de la precisión deLL valor calibrado.