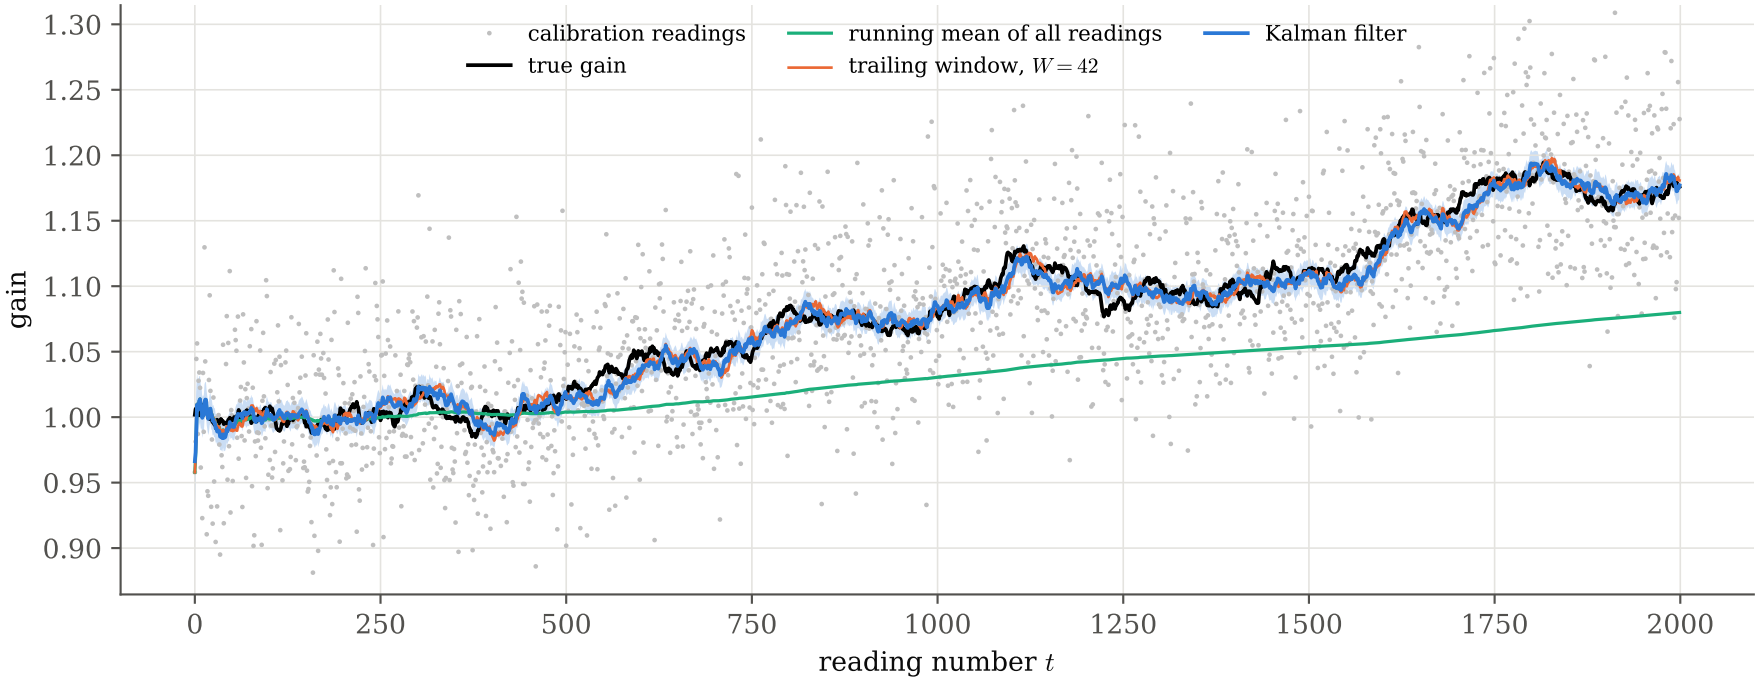

calibration readings
true gain
running mean of all readings
trailing window, $W = 42$
Kalman filter
gain
reading number t
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000