

经黑色素与线宽修正的脉搏血氧标定

Giles Blaney¹, Jodee Frias¹, Ravi Durbha², Sergio Fantini¹, Valencia Koomson²

¹ 塔夫茨大学生物医学工程系, 美国马萨诸塞州梅德福;

² 塔夫茨大学电气与计算机工程系, 美国马萨诸塞州梅德福。通讯作者: Giles.Blaney@tufts.edu

关键词: 脉搏血氧测定, 肤色偏差, 黑色素, 光谱着色, 修正 Beer-Lambert 定律, OpenOximetry

摘要

现行脉搏血氧仪倾向于高估色素较深患者的动脉血氧饱和度, 使隐匿性低氧血症的漏检率上升。一种被提出的机制是光谱着色: 黑色素会改变宽线宽光源实际被探测到的光谱形状, 标定背后的波长相关参数随之带上肤色依赖。扩散光学理论允许写出一个同时修正黑色素与线宽的标定方程, 据我们所知它还从未在活体上检验过。本文把经验线性方程、扩散光学理论方程以及它的修正形式分别拟合到公开的 OpenOximetry 数据库, 共纳入 98 名同时具备动脉血气采样、原始光电容积脉搏波与皮肤反射光谱的受试者。三种做法在精度上几乎无法区分, 而饱和度误差对黑色素的依赖却从每单位黑色素体积分数的 +2.8 个百分点, 依次降到 +1.2 与 +0.1, 方向与光谱着色理论一致。这三条依赖在本数据中都尚未被统计分辨出来——那需要大约再大十倍的队列——因此这一修正的依据是理论与它预期的方向。三种标定做法各含两个自由度: 理论方程可以直接并入现行标定流程, 而它的黑色素感知形式需要逐例测量肤色。本文展示的是脉搏血氧理论模型如何落地到标定环节。

引言

脉搏血氧测定是一种非侵入式光学技术, 用穿透组织的红光与红外光来推断患者的动脉血氧饱和度 SaO_2 。仪器报出的指标通常叫脉搏血氧饱和度 SpO_2 (顺带说明, SpO_2 里的 p 既可以指“外周”也可以指“脉搏”); 本文统一使用 SaO_2 , 因为它才是真正要测的那个量。脉搏血氧仪真正测量的是红光与红外光上由心脏搏动引起的相对幅值之比, 即双比值 RoR [1], [2]。把测得的 RoR 换算成 SaO_2 , 靠的是在一支规模不大的队列上做一次经验标定, 人数往往只有 10 名患者量级 [3]。然而近年情况已经清楚: 现行脉搏血氧设备存在与肤色相关的系统偏差, 黑人患者的 SaO_2 读数比白人患者更容易虚高 [4], [5], [6], [7], [8], [9]。这一偏差的直接后果, 是色素较深的患者中隐匿性低氧血症的比例更高 [10], [11], [12] (所谓隐匿性低氧血症, 是指真实 SaO_2 已经低到需要干预, 但因为血氧仪错误地显示为高值而没有人去干预)。美国食品药品监督管理局 (FDA) 2013 年的标定规程要求, 标定队列里至少要有两名深肤色受试者, 或者占队列的 15%, 两者取大者 [3]。该规程本身正在被重新审议: 2024 年一个 FDA 顾问小组复审了 2013 年的临床研究设计, 并权衡用哪些色素度量表 (包括本文用到的个体类型角 ITA) 来评价设备性能 [13]。这种不对称的队列要求也许能解释肤色偏差, 但也留下一个问题: 标定凭什么会依赖肤色, 又该怎么改才能把肤色算进去。

光谱着色是肤色偏差的一种机制解释, 它源于光源的有限线宽 [14], [15], [16], [17], [18]。论点是: 一旦使用宽线宽光源 (例如发光二极管 LED) 而不是单色光源 (例如激光二极管 LD), 被探测到的光谱形状及其标称波长就取决于组织的光学属性, 其中对表皮黑色素体积分数 M 的依赖特别强。落到操作上就是, 所有与波长相关的物理常数 (例如血红蛋白的摩尔消光系数) 都要按肤色重新取值, 标定方程因此必须显式含 M 。这一机制最近得到了直接实验支持: 把一台常规血氧仪的 LED 换成窄线宽 LD 之后, 无论在台架测试还是 18 名受试者的临床研究中, 与色素相关的偏差都消失了, 而被测的两台 LED 设备都表现出偏差 [19]。也有人提出别的机制, 例如真皮探测深度随肤色改变 [20], 或者心动周期中背景光学属性的变化与 M 之间存在非线性耦合 [21]。究竟哪一种机制主导了肤色偏差尚无定论, 完全可能是几种机制共同作用的结果。

脉搏血氧标定自身的经验性质同样受到质疑: 这种标定既说不清什么因素会干扰它, 也说不清拟合出的系数对应什么物理量 [22], [23]。我们近期从修正 Beer-Lambert 定律 (mBLL) 出发推导出了线性的脉搏血氧标定方程, 使线性系数可以被解释成具体的物理量 [24]。那一工作还给出了基于血红蛋白摩尔消光系数与光学路径长度的 SaO_2 - RoR 非线性理论表达式。我们进一步完全在仿真中检验了光谱着色这一肤色偏差机制, 并初步提出了针对标定的光谱着色修正 [18]。这一修正如今已经可以放到活体血氧标定数据上检验。这样的检验要求在一支肤色多样的群体中把原始红光与红外光电容积脉搏波 (PPG) 波形和动脉血气 (ABG) 测得的 SaO_2 配对, 公开的 OpenOximetry 数据库正好提供这些 [25]。所提修正还有一个不可少的要素: 一个与 M 直接挂钩、可量化的肤色度量, 而它同样能从数据库的原始皮肤反射光谱中导出。

SaO ₂ 范围	65.2–99.4 %
SaO ₂ 四分位距	76.4–93.1 %
SaO ₂ 中位数	85.0 %
RoR 范围	0.376–1.740
RoR 四分位距	0.740–1.211
RoR 中位数	0.986

表 1 标定集血氧参数汇总（98 名患者、2991 个样本）

本文的核心是比较三种标定情形：一是标准的线性经验标定；二是带一个附加项的 mBLL 推导式；三是在同一 mBLL 表达式上按 M 计入光谱着色修正。我们只比较自由度同为两个的标定方法，这样三者才可比——也正因此，本文不纳入有时会被使用的二次经验标定，它需要三个自由度。据我们所知，这是第一次把 mBLL 推导出的脉搏血氧标定方程 [24] 及其随肤色变化的光谱着色修正 [18]，放到一支 M 还可以被定量确定的受控降氧实验数据（即 OpenOximetry 数据库 [25]）上加以检验。

结果

可分析的 OpenOximetry 队列

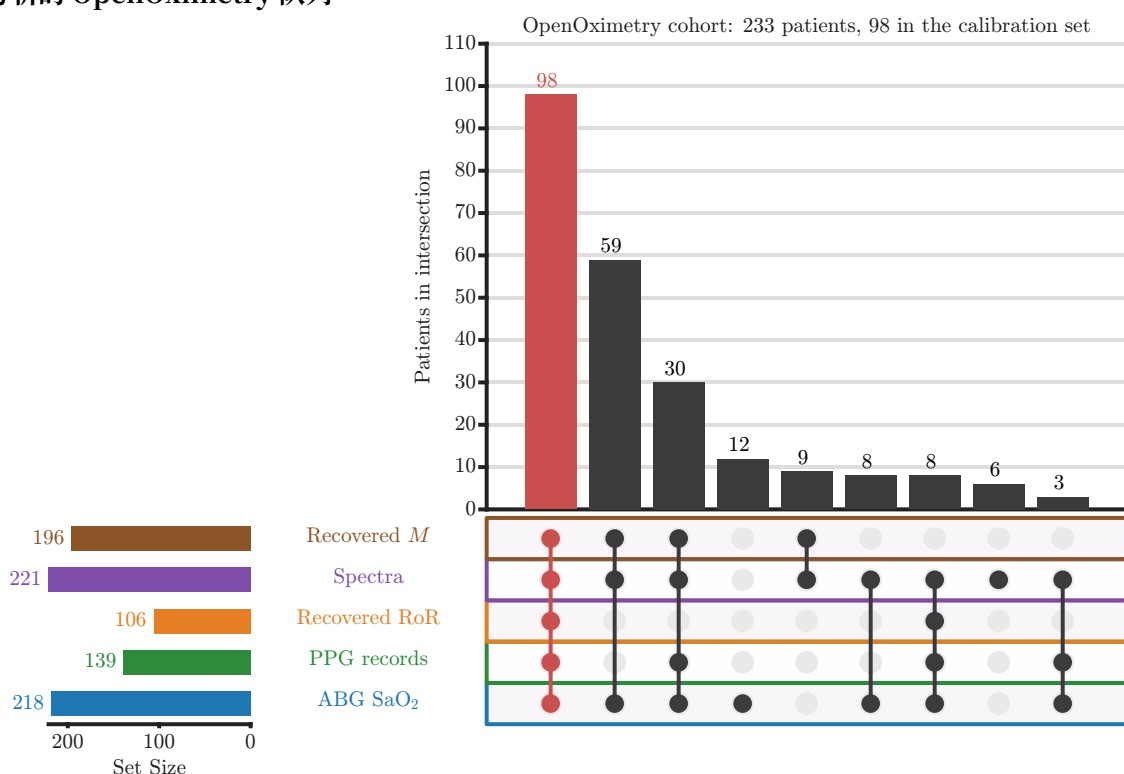


图 1 用 UpSet 图划分的 OpenOximetry 队列中与本工作相关的各子集。所有数值均指患者人数，各交集柱之和即数据集总人数（233 名患者）。（蓝）218 名患者有来自 ABG 的 SaO₂ 值。（绿）139 名患者有原始 PPG 记录。（橙）106 名患者恢复出了 RoR 值。（紫）221 名患者有反射光谱。（棕）196 名患者恢复出了指部 M 值。（红）98 名患者同时满足标定所需的三个集合（ABG SaO₂、恢复出的 RoR、恢复出的 M ）。

标定需要两个血氧参数：SaO₂ 与 RoR。数据集总共 233 名患者，其中 106 名满足这一要求（图 1 橙柱），但有 8 名没有恢复出 M ，于是本文标定集剩下 98 名患者（图 1 红色交集）。ABG SaO₂ 这一条限制最宽松，数据集里几乎每名患者都有这项数据，贡献者为 218 名（图 1 蓝集）。被排除在标定之外的 135 名患者中，多数是因为没有 PPG 记录——OpenOximetry 只对它其中的 139 名患者采集了这类数据（图 1 绿集）。换言之，本文的信号处理方法在恢复 RoR 时剔除了 $\frac{33}{139}$ ，即 24 % 的 PPG 记录。

标定集的 SaO₂ 与 RoR 分布汇总于表 1。标定集的 SaO₂ 跨度比全部被接受值的 58.1–100.0 % 要窄（需要说明，完整数据集中存在大于 100 % 的值，这类值不予接受），原因是极低的 SaO₂ 往往对应没有恢复出 RoR 的情形。即便如此，标定集的范围仍然向下越过了 FDA 规定的标定下限 70 % [3]。

肤色参数

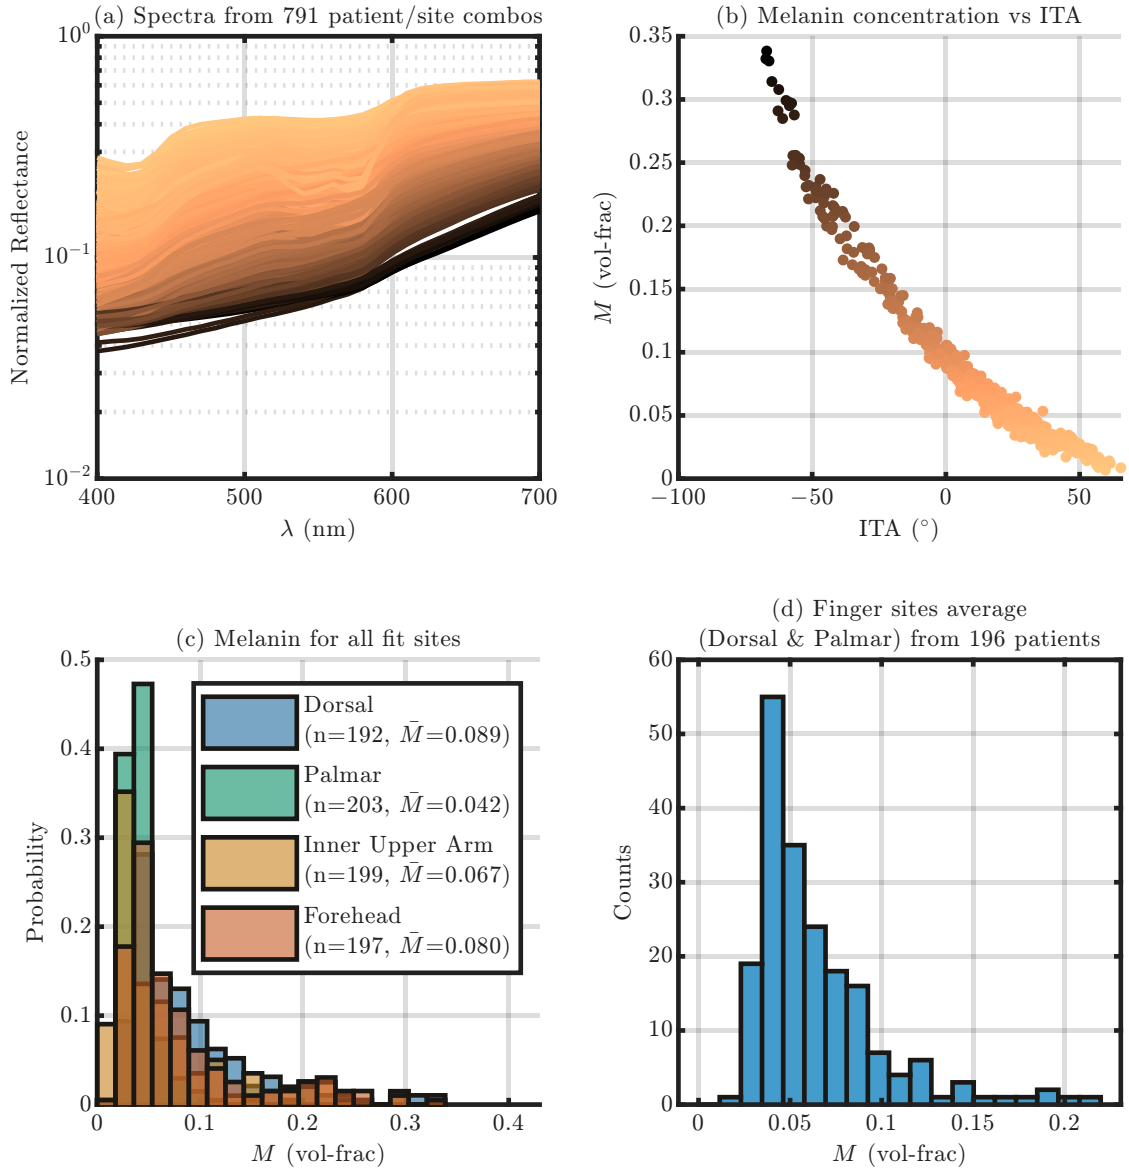


图 2 由反射光谱导出的肤色与肤色观感参数。(a) 791 条代表唯一“患者-部位”组合的光谱，线条表示恢复出的 M ，越深表示越大。(b) 每条光谱的恢复 M 与比色学 ITA 的关系，点色与 (a) 中的线条一致。(c) 四个拟合部位各自的 M 分布。(d) 指部合并后的 M 值，供后续分析使用，196 名可恢复出 M 的患者各一个值。

肤色用 M 表征，肤色观感（颜色）用 ITA 表征，两者都取自可见光波段的反射光谱（图 2 (a)）。这两个量不能混用： M 是通过真皮光学模型反演出的光谱学浓度，而 ITA 只是对同一光谱的一个感知层面的概括。之所以两个都报，是因为 ITA 在文献中足够流行；但只有 M 被当作物理量处理。 M 对 ITA 的散点见图 2 (b)，两者明显是非线性关系。造成这种关系的主要原因是 ITA 间接度量感知亮度，而 M 是色素浓度：在 $ITA = -90^{\circ}$ （即完全不反光、纯黑）的极限下， M 会发散到无穷（即完全不透光、全吸收）。

谱拟合对全部 791 条代表唯一“患者-部位”组合的光谱执行（这里也包含非指部部位）。这一次最小二乘拟合同时估计了 795 个自由参数：每条光谱各有一个 M ，另有在全部光谱之间共享的真皮血氧饱和度 StO_2 、总血红蛋白浓度 HbT 、瑞利散射份额和镜面反射因子各一个。共享参数的结果为 HbT 34 $\mu\text{mol/L}$ 、 StO_2 0.76、瑞利散射份额 0.52、镜面反射因子 0.087，整体拟合的决定系数为 0.97。全部光谱的 M 落在 0.0068–0.34 之间（图 2 (c)）。但只有手背与手掌两个指部部位的值被带入后续的血氧分析，因为脉搏血氧仪的指夹测量只对应这两个部位（图 2 (d) 与表 2）。

2013 年的 FDA 指南对标定队列设了深肤色配额，却没有说明该按什么标准判定深肤色 [3]。因此我们假定实践中这一判据通常来自自报种族。用于标定的 98 名患者中，自报类别为亚裔 27 名、白人 25 名、非裔美国人 24 名、西班牙裔 7 名，另有 12 名分散在多族裔组合中、3 名未报告；其中 26 名落在本文视作深肤色的两类（即“非裔美国人”与“其他/多族裔非裔美国人”）。种族是皮肤色素一个粗糙而不称职的替代量，这里用它只是为了复现 FDA 指南实际会怎么做。

	纳入标定	排除于标定
M 范围	0.022–0.193	0.027–0.220
M 四分位距	0.042–0.083	0.038–0.074
M 中位数	0.053	0.055
ITA 范围	–27.9–47.3 °	–34.9–43.6 °
ITA 四分位距	6.6–29.4 °	11.5–32.8 °
ITA 中位数	21.7 °	23.7 °

表 2 196 名可恢复出 M 的患者中，纳入标定的 98 名与被排除的 98 名，其指部肤色与颜色参数的汇总

标定精度及其肤色依赖

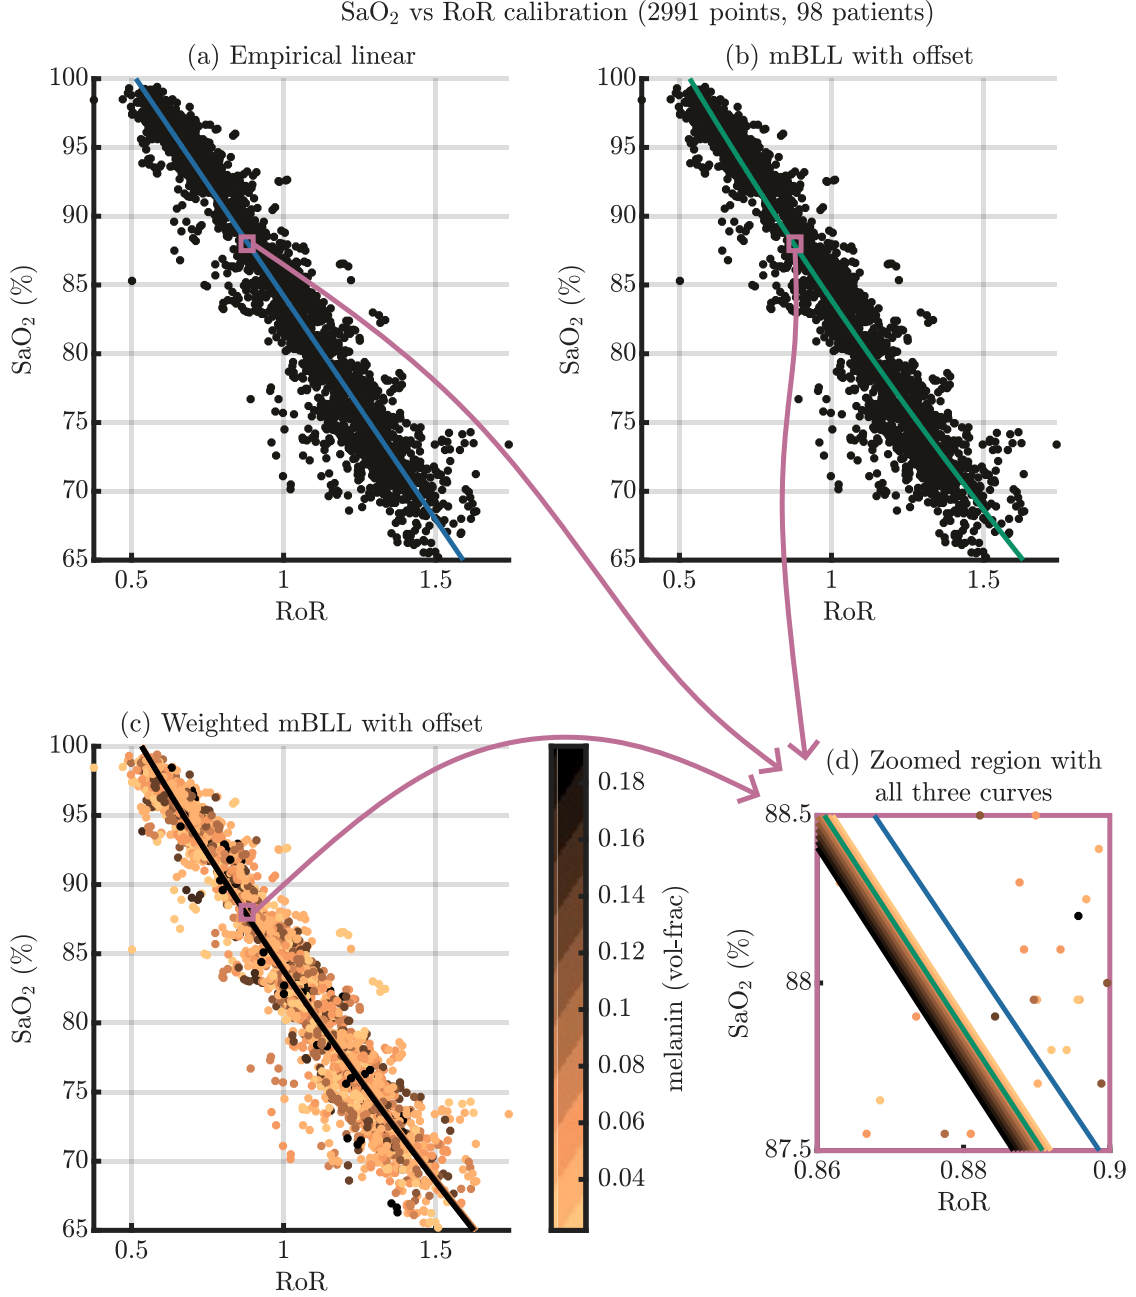


图 3 三种标定情形的定性比较。图中为 98 名患者、2991 次采血的 ABG SaO₂ 对实测 RoR。曲线用整份数据拟合。(a) 经验线性标定 (式 9)，恢复出 $a = -32.53\%$ 与 $b = 116.73\%$ ，均以 SaO₂ 为单位。(b) 带偏移的 mBLL 推导标定 (式 10)，恢复出光程比 $\Gamma = 0.987$ 与偏移 $o = 10.21\%$ (SaO₂ 单位)。(c) 按被探测光谱加权、计入 M 造成的光谱着色的 mBLL 标定 (式 12)，恢复出 $\Gamma = 0.957$ 与 $o = 9.85\%$ (SaO₂ 单位)；这一情形给出的曲线依赖于 M 。(d) (a)–(c) 中粉色方框的放大，显示三条曲线之间的细微差别，以及情形 (c) 随 M 不同的那一族曲线。

三种标定情形

本文考虑的第一种标定情形是常规的经验线性式 (式 9)；第二种采用基于 mBLL、假设光源为单色的标定模型 [24] (式 10)；第三种则是同一拟合，但改用按被探测光谱加权的系数，从而计入多色光源的光

谱着色 [18] (式 12)。第一、二种情形对黑色素是“盲”的——都不以 M 作为输入。只有第三种感知黑色素，因为它的被探测光谱——进而它的加权消光系数与加权光程比——取决于 M 。第三种情形还需要知道或假定光源线宽；本文取红线宽 25 nm、红外线宽为其两倍即 50 nm。三种情形的自由度都是二，彼此只在函数形式上不同。

在 98 名患者的完整标定集上拟合，情形一给出 $a = -32.53\%$ 、 $b = 116.73\%$ (均以 SaO_2 为单位，式 9)；情形二给出光程比 $\Gamma = 0.987$ 、偏移 $o = 10.21\%$ (SaO_2 单位，式 10)；情形三给出 $\Gamma = 0.957$ 、 $o = 9.85\%$ (SaO_2 单位，式 12；图 3)。就整体拟合而言，三种情形的精度几乎一致， A_{rms} 分别为 2.420%、2.416%、2.418% (SaO_2 单位)。用符合 FDA 投诉训练集的 200 折交叉验证也得到了相近的平均精度 [3]：三种情形留出集的 A_{rms} 中位数依次为 2.494%、2.482%、2.484% (SaO_2 ，图 4 (a))。200 折交叉验证中，每一种情形的每一个留出折都低于 FDA 指南设定的 3.0% 阈值 [3]。因此可以合理地认为，就整体精度而言这三种标定情形的表现实际上没有差别。

肤色依赖

肤色或颜色依赖用如下线性斜率来度量：把 SaO_2 残差（模型恢复值与 ABG 金标准值之差）对 M 或 ITA 作线性回归。结果见图 4 (b)，对应 200 个交叉验证折。以 M 为肤色变量时，留出折斜率的中位数在情形一为每单位体积分数 +2.76 个百分点 SaO_2 ，情形二为 +1.24，情形三为 +0.10。换成 ITA 后同样的次序以相反符号出现——因为 ITA 随 M 增大而变负（图 2 (b)）——三者中位数依次为每度 ITA -0.0040 、 -0.0017 、 $+0.0007$ 个百分点 SaO_2 。上述次序标示的是光谱着色修正把残差推动的方向。但不能据此宣称在本数据中测到了黑色素相关的偏差，因为每一个斜率的折间范围都包含零。总体上，我们报告的是一个已被施加、且有物理动机的修正，并不主张它在本数据中消除了某个被实测到的肤色偏差。

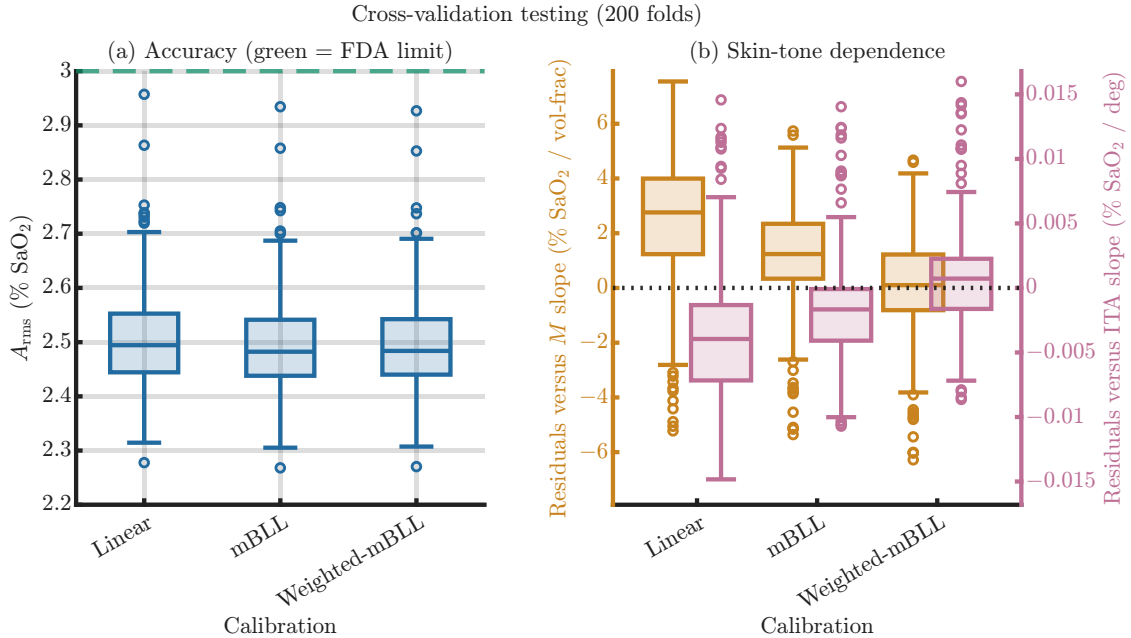


图 4 用 98 名患者的 200 折交叉验证对三种标定情形做定量比较。每折的训练集由 10 名满足 2013 年 FDA 指南 [3] 的患者组成，其余 88 名患者构成测试集。图中给出的是测试集指标。(a) 以 SaO_2 计的均方根精度，绿色虚线为 FDA 接受限。(b) 标定的肤色/颜色依赖，表现为恢复值与 ABG SaO_2 之间残差对 M (橙) 或 ITA (粉) 的斜率。斜率为 0 (黑色点线) 表示与 M 或 ITA 无关。

讨论

本文把三种脉搏血氧标定情形拟合到同一批数据：98 名患者的 2991 次采血。三者的区别只在 SaO_2 与 RoR 之间的函数关系；重要的是，每种都含两个自由度。它们的精度无法区分，均方根误差之差小于 0.02% (SaO_2 单位)。三者真正的差别在于各自能表达什么，以及残差随肤色变化的程度。

第一种情形 (式 9 与图 3 (a)) 完全是经验式的。它的斜率与截距并非由物理原理导出；不过若把 mBLL 推导出的第二种情形线性化，这两个参数就能用物理量表达出来 [24]。mBLL 推导式把 SaO_2 写成含 RoR 的两个线性表达式之商 (即分式线性： $y = \frac{ax+b}{cx+d}$)。而这一分式线性形式里只有一个未知自由度，也就是光程比 Γ ，其余系数都是摩尔消光系数的组合，只要光学波长已知它们就是定值 [18], [24]。第二、三种情形 (式 10 与式 12，图 3 (b)(c)) 取的是理论 mBLL 表达式加一个经验常数 (即偏移 o) 的组合。引入这个偏移有两点理由：一是凑齐与情形一相同的自由度；二是它能显著改善拟合质量——单自由度的拟合不足以刻画实验数据中 SaO_2 与 RoR 的关系。mBLL 的分式线性形式会产生一条弯曲的线，无论加不加偏移都是

如此，而同样自由度的简单线性方程复现不了这条弯线。第三种情形（式 12 与 图 3 (c)）没有增加自由度，但计入了含 M 的组织对宽谱光源的光谱着色 [18]。这一步把 M 变成了自变量，一条曲线因此展开成一族随肤色变化的曲线。所以情形三要在实际中使用，必须既有 M 的测量值，又知道光源线宽。三种情形自由度相同，但只有第二、第三种是物理导出、可作解释的。

第二、三种情形的曲率很小，但在本文考虑的 SaO_2 范围内并不可忽略。在标定集的 RoR 范围 0.376–1.740 上，情形二的曲线偏离其最佳直线不超过 1.36 % (SaO_2)，情形三不超过 1.39 % (SaO_2)。正是这一曲率使拟合出的曲线即使自由度与线性情形相同也仍与直线错开（图 3 (d)），并且可能影响落在标定范围之外的读数——那里没有任何数据参与拟合，外推只能依赖模型形式。尽管三种情形拟合出的曲线互不相同， A_{rms} 却几乎不受影响（图 4 (a)），原因是曲线差异最大的地方恰好是实验数据最稀疏的地方：只有 5.8 % 的采血其 RoR 大于 1.4，只有 5.2 % 小于 0.6，三条曲线主要在支配 A_{rms} 的那段密集区之外才分开。既然三种情形的精度看不出差别，我们就不能以精度为理由推荐其中任何一种；但我们预期，在测量延伸到标定 SaO_2 范围以下、外推曲线形状开始起作用的情形下，三者会有差别 [26], [27]。那种情形下情形二与三应该表现更好，不过本数据里没有证据，因为实验并未达到极低的 SaO_2 。

基于 mBLL 的两种情形拟合出的光程比（两个 Γ ）都高于 0.850 这个单色建模值——那是按整块组织总光程算出的 Γ_{mono} [18]。对不上本是预期之中的，因为我们知道把 Γ 那样理解严格说来并不正确，只能给出真值的粗略估计 [24]。式 10 与 式 12 所依据的 mBLL 表达式里，比值是搏动脉容积内的部分平均光程之比——也就是小动脉扩张所及的那部分组织——而不是穿过整块组织的总光程之比。一项针对这些部分光程的初步蒙特卡洛研究支持这一读法：起作用的量是围绕血管的环形区域内的光程而非总光程，而且这一比值本身就随 SaO_2 变化 [28]。情形二的 0.987 与情形三的 0.957 比整体建模值更接近 1，这与“两个波长上的搏动性部分光程几乎相等”相符。

对附加偏移 o 的解释要困难一些，因为它不是 mBLL 推导的产物。情形二与三分别恢复出 10.21 % 与 9.85 %。这么大一个偏移不太可能来自取整或噪声——它意味着 mBLL 表达式在整个队列上把 SaO_2 系统性低估了约 10 %——而且它在各交叉验证折之间保持稳定，说明是系统性的。可能的解释包括静脉血、组织或水分对搏动信号的污染 [29], [30]，或者 ABG 数值本身存在偏移（数据集中确有高于 100 % 的 ABG SaO_2 ），不过考虑到偏移的量级，后者可能性不大。要解释这一偏移，需要仔细判断 [24] 的哪些假设在真实测量中被破坏了。分辨这些解释已超出本文范围，因此在这里我们把 o 当作一个未经解释的经验参数看待，与线性情形中的 b 同类。

再看三种情形的肤色依赖，可以讨论图 4 (b) 的含义。三种情形的排序显示出各自能表达什么：经验线性情形留下最多的未修正肤色依赖；名义上的 mBLL 推导拟合只考虑单色波长、因而不含光源线宽，其依赖较小；而按 M 计入有限线宽光谱着色的情形三，其肤色与颜色依赖已接近于零。必须强调一个前提：这些斜率在本数据中没有一个被分辨出来（每种情形的 95 % 折间分布区间都包含“零依赖”）。所以我们报告的，是对同一批数据换三种拟合方式时观察到的依赖变化，而不是在情形一中测到了一个肤色偏差、也不是统计上证明了肤色偏差被消除。作为对照，要分辨残差中的肤色依赖大概需要多大的队列是一个有用的参照。本标定集有 98 名患者，而关于脉搏血氧仪误差随肤色变化的临床报道用的是大得多的队列——一篇 1565 名，另一篇 8392 名，两篇同出 [4]。因此，若目标是让 SaO_2 残差对 M 的斜率达到显著，预计需要比本文多约十倍的患者。本数据中没有分辨出依赖，并不否定我们在三种情形之间观察到的变化，只是指明需要更大规模的队列研究。规模够大的公开队列正在出现——例如“血气与血氧联动数据集”（BOLD）把三家重症监护数据库中的 49099 组配对测量合到了一起 [31]——不过这类资源记录的是商用血氧仪读数与 ABG 值的配对，而不是本文所检验的修正需要的原始 PPG 波形（或 RoR）与皮肤反射光谱。尽管如此，我们对结果的理解仍然显示情形二与三有前景，尤其是可能修正脉搏血氧肤色偏差中光谱着色那一部分的情形三。

结语。本文提出并在数据上检验了两种 mBLL 推导的脉搏血氧标定方法，即情形二与情形三。情形三的修正在 [18] 中已被建议，但本文第一次给到足以实现它的细节（见方法节）并把它放到实验数据上检验。情形三表现最好，同时也是实现最麻烦的一个，因为每名患者都要额外测一次 M 。这就使情形二成为对现有血氧仪技术最可行的一种；不过必须指出，情形二对黑色素是盲的，只有情形三感知黑色素。另外，我们提出的是标定方法，黑色素与线宽修正无法直接搬到现役脉搏血氧仪上。后续工作可以用本文的理论与模型去推导这样一个仪器层面的修正。这样的修正也许是必要的，因为要达到足以显示肤色偏差及其统计显著的消除的统计功效，需要的队列规模只在商用血氧仪的临床读数数据里存在，受控降氧研究里没有。至于容易着手的部分，我们建议在未来的降氧式脉搏血氧标定研究中考虑基于 mBLL 的标定模型，特别是情形二：它不需要另测皮肤色素，自由度与线性标定相同，因此可以很方便地把线性标定替换掉。

方法

本文的分析可以用随文公开的 GitHub 仓库中的代码 [32] 复现，数据则是 PhysioNet 上公开的 OpenOximetry 数据库 v1.1.1 [25]。这些数据是在加州大学旧金山分校低氧实验室的受控降氧方案下采集的，该方案与 ISO 80601-2-61 一致：健康成年受试者呼吸按比例调节的氮气、氧气与二氧化碳混合气，把动脉血氧饱和度维持在约 70 %–100 % 之间的一串稳定平台。每个平台上从桡动脉置管采一次动脉血，用血气分析仪 (Radiometer ABL90 Flex Plus) 做血氧测定，得到金标准的 SaO_2 ，同时由一台报出原始 PPG 的定制脉搏血氧仪 (Analog Devices MAX86171) 同步记录。皮肤色素用一台面向颜色测量的反射分光光度计 (Konica Minolta CM-700d) 量化。除 OpenOximetry 数据库之外，本文没有采集或使用任何人体数据。

本工作使用的 OpenOximetry 研究已获得加州大学旧金山分校机构审查委员会批准，批件号 21-35637 与 23-40212，本文作者与该研究没有隶属或参与关系。原始研究负责人取得了全部受试者的知情同意，其中包含匿名数据共享的同意；数据库中所有数据的采集都遵循《赫尔辛基宣言》的伦理原则 [25]。本文在校对与文字修改上使用了大语言模型，没有用它们生成或解读结果，内容责任由作者完全承担。

ABG 数据的索引

分析的第一阶段对 OpenOximetry [25] 建索引，从 ABG 测量中提取 SaO_2 数据。从血气表里取出患者编号、就诊编号、样本序号与 SaO_2 测量值，缺其中任何一项的行予以排除。若某行满足 $\text{SaO}_2 > 100\%$ ，或者其就诊编号与患者编号没有在就诊登记表中作为配对出现，同样排除。同一份样本若重复采了几次 ABG，取其中位数。血气表共有 32877 行、涉及 224 名患者，处理后得到 17756 个 SaO_2 样本、来自 218 名患者 (图 1 蓝集)。这一步对应 GitHub 仓库 [32] 中的 `A_loadSaO2_openox.m` 脚本。

从原始 PPG 提取双比值

每次就诊的原始 PPG 由 PhysioNet 波形数据库 (WFDB) 工具箱 [33] 读入。记录为 86 Hz 采样、红光与红外双波长 (660 nm 与 910 nm)。缺失样点用线性插值补齐，端点取最近值。随后检测尖峰与阶跃伪迹并记下它们的下标 (算法 1)。红光与红外两路伪迹标志按逻辑并集成一张掩模，只保留长度不小于 3 s 的连续有效片段。

1. 输入：整次就诊的 PPG 轨迹 I ；采样率 f_s ；尖峰窗 $w_{\text{sp}} = 2$ s；尖峰阈值 $k_{\text{sp}} = 5$ ；阶跃半窗 $w_{\text{st}} = 0.25$ s；阶跃阈值 $k_{\text{st}} = 6$ ；阶跃下限 $m_{\text{st}} = 0.0015$ ；最短有效段 $\Delta t_{\text{min}} = 3$ s
2. 输出：无伪迹的有效片段集合 $\{s\}$
3. 滑动基线 B 取 I 在 $\max(3, \text{round}(w_{\text{sp}} f_s))$ 个样点窗上的滑动中位数
4. 相对变化 $X \leftarrow \frac{I-B}{B}$
5. 伪标准差 $\sigma_X \leftarrow \frac{\text{median}(|X - \text{median}(X)|)}{\text{norminv}(0.75)}$
6. 尖峰掩模 $A_{\text{sp}} \leftarrow |X| \geq k_{\text{sp}} \sigma_X$
7. 后侧基线 B^- 取该点之前 $\max(2, \text{round}(w_{\text{st}} f_s))$ 个样点上的滑动中位数
8. 前侧基线 B^+ 取该点之后同样长度的滑动中位数
9. 相对边缘变化 $Y \leftarrow \frac{|B^- - B^+|}{B}$
10. 伪边缘标准差 $\sigma_Y \leftarrow \frac{\text{median}(|Y - \text{median}(Y)|)}{\text{norminv}(0.75)}$
11. 阶跃掩模 $A_{\text{st}} \leftarrow Y \geq \max(m_{\text{st}}, k_{\text{st}} \sigma_Y)$
12. 伪迹轨迹 $A \leftarrow A_{\text{sp}} \cup A_{\text{st}}$
13. A 中相邻伪迹之间长度超过 Δt_{min} 的片段即为有效集合 $\{s\}$
14. 返回 $\{s\}$

算法 1 尖峰与阶跃伪迹检测

RoR 在两类定长分析窗上提取：一是窗长 20 s、步进 10 s 的滑动窗，用来构成与 ABG 同步的 RoR 轨迹；二是以每次 ABG 采血时刻为中心的 30 s 窗，为每个 SaO_2 测量给出一个 RoR。在每个分析窗内，心率 f_{HR} 取红外通道 PPG 在 0.8–3.5 Hz 范围内傅里叶幅值的主峰。逐搏 RoR 基于原始 PPG 的峰峰值幅值估计 (算法 2)。一个窗的 RoR 是其逐搏值的中位数，计算前先剔除偏离中位数超过 3 倍伪标准差 (即 $3 \times \frac{\text{median}(|X - \text{median}(X)|)}{\text{norminv}(0.75)}$) 的搏动。窗被接受的条件是：保留搏动不少于 20 次、伪标准差与中位数之比不超过 0.08、伪迹样点数小于窗长的 0.3 倍。这些判据刻意不用于同步轨迹的滑动窗 (算法 3)。

1. 输入：窗内红光与红外 PPG 轨迹 I_r, I_i ；有效片段集合 $\{s\}$ ；心率 f_{HR} ；采样率 f_s ；基线跨度 $w_b = 3$ 个周期；波谷最小间隔 $w_t = 0.5$ 个周期；波谷最小凸度 $p = 0.2$
2. 输出：逐搏 RoR
3. 基线窗长 $W \leftarrow \max\left(3, \text{round}\left(w_b \frac{f_s}{f_{HR}}\right)\right)$ 个样点
4. 去趋势均值 $I' \leftarrow \frac{[(I_r - \text{movmedian}(I_r, W)) + (I_i - \text{movmedian}(I_i, W))]}{2}$
5. 对每个片段 s ：
6. 在 s 上取 I' 的极小点为波谷集合 T ，要求间隔不小于 w_t 个周期、凸度不小于 $p \times (Q_{0.95} - Q_{0.05})$
7. 对 T 中相邻波谷之间的每个周期：
8. $AC_y \leftarrow \frac{\max(I_y) - \min(I_y)}{\max(I_y) + \min(I_y)}, y \in \{r, i\}$
9. $DC_y \leftarrow \frac{\max(I_y) + \min(I_y)}{2}, y \in \{r, i\}$
10. 若 AC_r, AC_i, DC_r, DC_i 全为正，则把 $\frac{AC_r}{AC_i} \frac{DC_r}{DC_i}$ 计入 RoR
11. 返回 RoR

算法 2 峰峰值 RoR 估计器

之所以需要同步，是因为原始 PPG 与记录了 ABG 采血时刻的监护仪文件不在同一条时间轴上，时间偏置只能由波形形状推出，做法见 算法 3。具体是求 RoR 同步轨迹与商用血氧仪报出的 SpO_2 取负之后互相关最大处对应的延迟。同步质量用两路信号在该延迟下的皮尔逊相关系数衡量，系数低于 0.9 的就诊被排除。

1. 输入：整次就诊的红光与红外 PPG 轨迹 I_r, I_i ；参考 SpO_2 轨迹 S （按 ABG 时间轴）；ABG 采血时刻集合 $\{D\}$ ；同步窗 $w_s = 20$ s；同步步进 $\Delta t_s = 10$ s；重采样栅格 $\delta = 1$ s；质量阈值 $r_{\min} = 0.9$ ；采血半窗 $h = 15$ s
2. 输出：每次 ABG 采血对应的 RoR
3. 慢变 RoR 轨迹：用 算法 2 的峰峰值估计器在 w_s 窗、 Δt_s 步进上取中位数，要求窗内至少有两个搏动
4. 监护仪起点 t_0 取 S 时间轴上的最早时刻
5. 对慢变 RoR 轨迹与 $-S$ 各取 z 分数，并各按 δ 间隔重采样到自己的时间轴上
6. 延迟 $\Delta \leftarrow$ 两条 z 分数序列互相关最大处的延迟
7. 把 S 的 z 分数平移 Δ 后与 RoR 的 z 分数求皮尔逊相关系数，记为同步质量 r
8. 若 $r < r_{\min}$ ，则排除该次就诊
9. 同步偏置 $\tau \leftarrow t_0 - \Delta$ ，它把监护仪时间映射到 PPG 记录时间
10. 对每个采血时刻 D ：在 $D - \tau$ 处取 $\pm h$ 窗，用 算法 2 计算 RoR
11. 返回 RoR

算法 3 PPG 的 RoR 与 ABG 采血时刻的同步

这一阶段处理了带有原始 PPG 记录的就诊所对应的 139 名患者（图 1 绿集）。候选采血共 7723 个样本，其中 3376 个样本的 RoR 通过了质量阈值，最终为 106 名患者恢复出这些 RoR 样本（图 1 橙柱）。本节对应的分析步骤在 GitHub 仓库 [32] 的 `B_extractRoR_openox.m` 脚本中。

肤色与黑色素的拟合

皮肤光学模型

本文的分析聚焦于 M ，因为在诸种光学吸收体中，黑色素是唯一能直接刻画不同肤色的那一种 [34], [35]。 M 用实测的 400–700 nm 反射光谱拟合。模型把表皮看作一片有效光学厚度 0.2 mm 的透射滤片，覆在一个代表真皮的半无限介质之上，这一处理与既往工作一致 [18], [36]。表皮的吸收系数 μ_a 只由 M 的吸收决定，取文献报道的形式 [37]：

$$\mu_{a,\text{epi}}(\lambda) = M \times 51.9 \text{ mm}^{-1} \times \left(\frac{\lambda}{500 \text{ nm}}\right)^{-3.5} \quad (1)$$

其中 51.9 mm^{-1} 是 $M = 1$ 、波长 500 nm 时的 μ_a ，幂次 -3.5 表示波长依赖。真皮的 μ_a 由 HbT 浓度、 StO_2 与水体积分数 W 决定 [20]：

$$\mu_{a,\text{der}}(\lambda) = \text{StO}_2[\text{HbT}] \times \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda) + (1 - \text{StO}_2)[\text{HbT}] \times \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda) + W \times \mu_{a,\text{water}}(\lambda) \quad (2)$$

式中的 ε 是按下角标取 HbO_2 或 Hb 的摩尔消光系数。真皮的约化散射系数 μ'_s 用瑞利散射与米氏散射的组合建模 [20], [37]：

$$\mu'_{s,\text{der}}(\lambda) = \mu'_{s,\text{der}}(500 \text{ nm}) \times \left(f_{\text{Ray}} \times \left(\frac{\lambda}{500 \text{ nm}}\right)^{-4} + (1 - f_{\text{Ray}}) \times \left(\frac{\lambda}{500 \text{ nm}}\right)^{-b_{\text{Mie}}}\right) \quad (3)$$

其中 f_{Ray} 是瑞利散射份额， b_{Mie} 是米氏散射幂次。

光谱用 Konica Minolta CM-700d 的小口径档采集——每个部位重复测量三次——照明与视场设置为 D65 / 2° 观察者 [38]。该配置下仪器漫照明一个直径 6 mm 的端口，并在与法线成 8° 的方向上观测直

径 3 mm 的测量区 [39]。照明端口与收集区是两个半径不同的同轴圆盘， $r_{\text{ill}} = 3 \text{ mm}$ 与 $r_{\text{col}} = 1.5 \text{ mm}$ ，因此对测量有贡献的源探间距 ρ 按两圆盘的重叠面积 $\Lambda(\rho)$ 分布，两盘心距即为 ρ ：

$$\Lambda(\rho) = \begin{cases} \pi r_{\text{col}}^2 & \text{if } \rho \leq r_{\text{ill}} - r_{\text{col}} \\ r_{\text{col}}^2 \cos^{-1}\left(\frac{\rho^2 + r_{\text{col}}^2 - r_{\text{ill}}^2}{2\rho r_{\text{col}}}\right) + r_{\text{ill}}^2 \cos^{-1}\left(\frac{\rho^2 + r_{\text{ill}}^2 - r_{\text{col}}^2}{2\rho r_{\text{ill}}}\right) - \frac{1}{2}\sqrt{((r_{\text{ill}} + r_{\text{col}})^2 - \rho^2)(\rho^2 - (r_{\text{ill}} - r_{\text{col}})^2)} & \text{if } r_{\text{ill}} - r_{\text{col}} < \rho < r_{\text{ill}} + r_{\text{col}} \\ 0 & \text{if } \rho \geq r_{\text{ill}} + r_{\text{col}} \end{cases} \quad (4)$$

把半无限介质在间距 ρ 上连续波漫反射的真皮格林函数 $G_{\text{der}}(\rho, \lambda)$ [40]，与无散射薄层的表皮透射 $T_{\text{epi}}(\lambda)$ [18] 结合起来，测量孔径上出射的总漫反射率 $R_{\text{skin}}(\lambda)$ 为（注意这一表述里 $R_{\text{skin}}(\lambda)$ 无量纲，它已用进入边界的源功率谱密度归一）：

$$R_{\text{skin}}(\lambda) = T_{\text{epi}}(\lambda) \int_0^{r_{\text{ill}} + r_{\text{col}}} G_{\text{der}}(\rho, \lambda) \frac{\Lambda(\rho)}{\Lambda(0)} \times 2\pi\rho d\rho \quad (5)$$

其中 $G_{\text{der}}(\rho, \lambda)$ 取决于真皮吸收（式 2）与散射（式 3），而 $T_{\text{epi}}(\lambda)$ 取决于表皮吸收（式 1）与表皮有效光学厚度 L_{epi} ：

$$T_{\text{epi}}(\lambda) = e^{-2L_{\text{epi}}\mu_{a,\text{epi}}(\lambda)} \quad (6)$$

（ L_{epi} 乘 2 是为了计入往返路程。）最后，实测总漫反射率 $R_{\text{meas}}(\lambda)$ 还要加上前表面的 Saunderson 镜面反射项 K_{spec} ——即入射光中有比例 K_{spec} 在空气-皮肤界面被直接反射 [41], [42]：

$$R_{\text{meas}}(\lambda) = K_{\text{spec}} + (1 - K_{\text{spec}})R_{\text{skin}}(\lambda) \quad (7)$$

（同样， $R_{\text{meas}}(\lambda)$ 以源发射的功率谱密度归一，故无量纲。）该界面上的内部再反射已经由 $G_{\text{der}}(\rho, \lambda)$ 中的折射率失配考虑进去了。拟合过程最小化模型与实测 $R_{\text{meas}}(\lambda)$ 之差的平方。

光谱预处理与拟合

拟合只使用在手背（上面）、手掌（下面）、额头与上臂内侧四个部位采集的光谱 [38]。每条光谱在 400–700 nm 间每 10 nm 取一个样点，共 31 个波长。若一条光谱的 31 个反射率值中出现非正值，或其峰值反射率落在 [0.01, 0.90] 之外，该谱被剔除。四个部位的 9517 条单独光谱中，288 条不完整、1 条含非正值，余下 9228 条。把存活光谱按患者与部位分组，只有包含至少 3 次重复的组被保留：有 2 组只含 2 次重复而被排除，去掉 4 条，剩 9224 条、分属 810 组（即患者-部位组合）。若某次重复的水平偏离组中位数同时超过 5 倍伪标准差与 $\log_{10}$ 单位下的 0.25，该次重复被丢弃；组本身保留，并用存下的重复合并——这里的伪标准差又是该组各水平上的 $\frac{\text{median}(|X - \text{median}(X)|)}{\text{norminv}(0.75)}$ 。这一步丢掉了来自 5 组的 7 次重复，余下 9217 条光谱按波长逐点平均成每条“患者-部位”组合谱，得到 810 条平均光谱。

水体积分数 (0.65)、干组织折射率 (1.514)、约化散射幅值 ($\mu'_s(500 \text{ nm}) = 4.36 \text{ mm}^{-1}$) 与米氏散射幂次 ($b = 0.562$) 固定为真皮文献值 [20], [37]。其余每个光学属性参数都参与拟合，要么逐条光谱取独立值，要么在全部光谱间共享一个值。共享的参数有四个：真皮的 HbT、StO₂（式 2）与瑞利散射份额（式 3），以及前表面镜面反射因子（式 7）。目标参数 M （式 1）则对每条平均光谱取独立值。任何一条平均光谱，若其以自身均值参照的决定系数低于 0.50 就被剔除并重新拟合，直到剩下的光谱全部满足该阈值；810 条平均光谱中有 19 条被这一阈值剔除。

颜色量化

皮肤色素也用颜色来量化，即 ITA。ITA 由 CIE $L^*a^*b^*$ 坐标（ L^* 为明度、 a^* 为红/绿、 b^* 为黄/蓝）算出，而这些坐标由实测反射光谱在 D65 照明下对 CIE 1931 2° 颜色匹配函数积分得到 [42]：

$$\text{ITA} = \tan^{-1}\left(\frac{L^* - 50}{b^*}\right) \quad (8)$$

ITA 以度为单位，值越大表示皮肤越浅。这个比色学描述量并不直接代表黑色素，之所以保留，是因为它简单，并且能与数据库自带的比色结果直接对比。

肤色汇总

这一阶段总共处理了来自 221 名患者的 810 条光谱（图 1 紫集），每条对应一个唯一的患者-部位组合，部位取自四个拟合位置之一。其中 791 条满足拟合优度要求，并为 196 名患者恢复出了指部 M （图 1 棕集）。整个步骤见 GitHub 仓库 [32] 的 `c_extractM_openox.m` 脚本。

SaO₂ 对 RoR 的标定

一次采血的数据点（一个 SaO₂ 与 RoR 配对）要通过所有质量阈值、并配有 M 估计值才用于标定。满足这一判据的是 98 名患者的 2991 次采血（图 1 红色交集）。标定考虑三个 SaO₂ 对 RoR 的模型。第一种用常规的经验线性标定：

$$\text{SaO}_2(\text{RoR}) = a \times \text{RoR} + b \quad (9)$$

其中 a 与 b 是经验的斜率与截距自由参数。第二种考虑 mBLL 推导式 [18], [24], 并加一个经验偏移 o 以改善拟合质量、凑齐与线性情形相同的自由度:

$$\text{SaO}_2(\text{RoR}) = \frac{-\varepsilon_{\text{Hb},r} + \varepsilon_{\text{Hb},i} \times \Gamma \times \text{RoR}}{(\varepsilon_{(\text{HbO}_2),r} - \varepsilon_{\text{Hb},r}) + (\varepsilon_{\text{Hb},i} - \varepsilon_{(\text{HbO}_2),i}) \times \Gamma \times \text{RoR}} + o \quad (10)$$

式中 ε 是按下角标取 HbO_2 或 Hb 、并按下角标 r 与 i 取红光或红外波长的摩尔消光系数; Γ 是平均光程之比

$$\Gamma = \frac{\langle \ell \rangle_i}{\langle \ell \rangle_r} \quad (11)$$

即红外与红光波长上的平均值之比。第三种仍按式 10 的方式使用 mBLL, 但把光源当作多色的, 而式 10 假设的是单色光源。对半高全宽 (FWHM) 为 w 的多色光源, 用按被探测光谱加权的消光系数 ($\bar{\varepsilon}$) 与加权光程比 ($\bar{\Gamma}$) 来表述 [18]:

$$\text{SaO}_2(\text{RoR}, M, w) = \frac{-\bar{\varepsilon}_{\text{Hb},r} + \bar{\varepsilon}_{\text{Hb},i} \times \bar{\Gamma} \times \text{RoR}}{(\bar{\varepsilon}_{(\text{HbO}_2),r} - \bar{\varepsilon}_{\text{Hb},r}) + (\bar{\varepsilon}_{\text{Hb},i} - \bar{\varepsilon}_{(\text{HbO}_2),i}) \times \bar{\Gamma} \times \text{RoR}} + o \quad (12)$$

为紧凑起见, 上式右端各加权量 $\bar{\varepsilon}$ 与 $\bar{\Gamma}$ 都略去了共同的自变量 (M, w) ; 左端已写明, 它们一律由 M 与线宽 w 决定。加权消光系数定义为

$$\bar{\varepsilon}(M, w) = \frac{\int I(\lambda, M, w) \varepsilon(\lambda) d\lambda}{\int I(\lambda, M, w) d\lambda} \quad (13)$$

其中 $I(\lambda, M, w)$ 是被探测光的功率谱密度; 光源为多色时, 它因光谱着色而依赖于 M [18]。加权光程比定义为

$$\bar{\Gamma}(M, w) = \Gamma \times \gamma(M, w) \quad (14)$$

其中

$$\gamma(M, w) = \frac{\langle \ell \rangle_i(M, w)}{\langle \ell \rangle_r(M, w)} \quad (15)$$

而加权平均光程为

$$\langle \ell \rangle(M, w) = \frac{\int I(\lambda, M, w) \langle \ell \rangle(\lambda) d\lambda}{\int I(\lambda, M, w) d\lambda} \quad (16)$$

这里的 Γ_{mono} 与 $\langle \ell \rangle$ 都取自 [18] 给出的整块组织平板模型, Γ_{mono} 是该模型在名义单色波长下的值。引入 γ 是为了用一个解析模型把 Γ 随 M 的光谱着色依赖抓住, 而 Γ 本身 (式 14) 在情形三中仍作为拟合参数直接求解。这样一来, $\bar{\Gamma}$ 对 M 的依赖是模型决定的, 拟合参数 Γ 的幅度则不是。情形三 (式 12) 的要点在于: 被探测光谱取决于表皮黑色素体积分数 M , 于是 M 成了标定中的一个自变量。三种情形都含两个自由参数: 式 9 用 a 与 b ; 式 10 与式 12 用 Γ 与 o 。重要的是, Γ 有明确的物理含义 [24], 而经验参数 a 、 b 、 o 的解释就没那么清楚了。

式 10 中名义消光系数取红光与红外波长的 660 nm 与 910 nm 处的值 [24]。式 12、式 13 与式 16 中的被探测功率谱密度 I 建模为三者的乘积: 光源发射功率谱密度 P 、表皮透射 T_{epi} 、以及整块组织的透射格林函数 G_{bulk} [18]:

$$I(\lambda, M, w) = P(\lambda, w) \times T_{\text{epi}}(\lambda, M) \times G_{\text{bulk}}(\lambda) \times \Lambda_{\text{det}} \quad (17)$$

其中 Λ_{det} 是探测器面积; G_{bulk} 按 15 mm 厚的平板建模, 与 [18] 相同——式 16 里的 $\langle \ell \rangle$ 也正是从这一模型算出 (计算时取单位探测器面积)。本文把 P 建模为高斯型宽线宽光源:

$$P(\lambda, w) = P_0 \times e^{-4 \ln(2) \times \frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{w^2}} \quad (18)$$

其中 w 是 FWHM、 λ_0 是名义波长, 且表达式按 $P(\lambda_0) = P_0$ 归一, P_0 为峰值功率谱密度 (计算时取单位峰值)。本文结果假定红外光源 w_i 为 50 nm (即 $\lambda_{0,i} = 910$ nm), 红光源的 FWHM 取其一半 (即 w_r 为 25 nm、 $\lambda_{0,r} = 660$ nm) [15], [18]。当 FWHM 为零 (即单色情形) 时, 加权消光系数退化为名义值 (与式 10 相同) 且 $\gamma = 1$, 所以 $w_r = w_i = 0$ nm 时情形三严格退化为情形二。

具体标定时, 情形一 (式 9) 用普通最小二乘拟合。情形二与三 (式 10 与式 12) 用有界非线性最小二乘拟合—— Γ 限定在 0.1-10, o 限定在 -100% 到 100%。一次采血的残差定义为该点用标定模型恢复出的 SaO_2 减去其实测 SaO_2 , 标定精度用残差的均方根 A_{rms} 概括。为检验标定对肤色的依赖, 另做一次线性回归: 把患者均值残差对其色素量 (M 或 ITA) 回归, 每名患者按其均值残差标准误差的平方倒数加权。从这次拟合中取用的是斜率, 单位为每单位色素量对应的 SaO_2 百分点 (M 用每单位体积分数, ITA 用每度)。

标定流程先在对整个数据集做一次全局拟合，再在 200 个交叉验证折上重复。交叉验证的每一折抽一个满足 FDA 2013 年脉搏血氧仪上市前通知指南 [3] 的训练集。按该指南，训练集含 10 名两种登记性别的患者，其中 2 名为深肤色——由于指南没有定义“深肤色”，这里按其自报种族（“非裔美国人”或“其他/多族裔非裔美国人”）判定——并且合计贡献不少于 200 次落在 SaO_2 的 70 %–100 % 区间内的采血。患者随机抽取，不满足条件就重抽。其余 88 名患者构成留出集（标定共考虑 98 名患者），用来算留出 A_{rms} 与留出斜率（ SaO_2 残差对色素量的斜率），分别检验精度与肤色依赖（注意留出集包含 SaO_2 低于 70 % 的采血，训练集不包含）。这一步见 GitHub 仓库 [32] 的 `D_calibrate_openox.m` 脚本。

数据可用性

源数据集是 PhysioNet 上的 OpenOximetry 数据库 v1.1.1 [25]，使用受该数据库数据使用条款约束。本文不随文再分发任何 OpenOximetry 数据。

代码可用性

支撑本文的分析代码公开托管在 GitHub 仓库 [32]。

参考文献

- [1] T. Aoyagi, “Pulse Oximetry: Its Invention, Theory, and Future,” *Journal of Anesthesia*, vol. 17, no. 4, pp. 259–266, Nov. 2003, doi: 10.1007/s00540-003-0192-6.
- [2] P. H. Charlton, P. A. Kyriacou, J. Mant, V. Marozas, P. Chowienczyk, and J. Alastruey, “Wearable Photoplethysmography for Cardiovascular Monitoring,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 110, no. 3, pp. 355–381, Mar. 2022, doi: 10.1109/JPROC.2022.3149785.
- [3] FDA CDRH, “Pulse Oximeters - Premarket Notification Submissions [510(k)s]: Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff,” no. FDA-2007-D-0205. Mar. 2013.
- [4] Sjöding Michael W., Dickson Robert P., Iwashyna Theodore J., Gay Steven E., and Valley Thomas S., “Racial Bias in Pulse Oximetry Measurement,” *New England Journal of Medicine*, vol. 383, no. 25, pp. 2477–2478, Dec. 2020, doi: 10.1056/nejmc2029240.
- [5] C. Shi et al., “The Accuracy of Pulse Oximetry in Measuring Oxygen Saturation by Levels of Skin Pigmentation: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *BMC Medicine*, vol. 20, no. 1, p. 267, Aug. 2022, doi: 10.1186/s12916-022-02452-8.
- [6] P. Bickler and K. K. Tremper, “The Pulse Oximeter Is Amazing, but Not Perfect,” *Anesthesiology*, vol. 136, no. 5, pp. 670–671, May 2022, doi: 10.1097/ALN.0000000000004171.
- [7] A. M. Cabanas, M. Fuentes-Guajardo, K. Latorre, D. León, and P. Martín-Escudero, “Skin Pigmentation Influence on Pulse Oximetry Accuracy: A Systematic Review and Bibliometric Analysis,” *Sensors*, vol. 22, no. 9, p. 3402, 2022, doi: 10.3390/s22093402.
- [8] R. Al-Halawani, P. H. Charlton, M. Qassem, and P. A. Kyriacou, “A Review of the Effect of Skin Pigmentation on Pulse Oximeter Accuracy,” *Physiological Measurement*, vol. 44, p. 05TR01, 2023, doi: 10.1088/1361-6579/acd51a.
- [9] D. Martin et al., “Effect of Skin Tone on the Accuracy of the Estimation of Arterial Oxygen Saturation by Pulse Oximetry: A Systematic Review,” *British Journal of Anaesthesia*, vol. 132, no. 5, pp. 945–956, 2024, doi: 10.1016/j.bja.2024.01.023.
- [10] C. F. Chesley et al., “Racial Disparities in Occult Hypoxemia and Clinically Based Mitigation Strategies to Apply in Advance of Technological Advancements,” *Respiratory Care*, vol. 67, no. 12, pp. 1499–1507, Dec. 2022, doi: 10.4187/respcare.09769.
- [11] M. K. Gudelunas et al., “Low Perfusion and Missed Diagnosis of Hypoxemia by Pulse Oximetry in Darkly Pigmented Skin: A Prospective Study,” *Anesthesia & Analgesia*, vol. 138, no. 3, p. 552, Mar. 2024, doi: 10.1213/ANE.0000000000006755.
- [12] C. M. Hendrickson et al., “EquiOx: A Prospective Study of Pulse Oximeter Bias and Skin Pigmentation in Critically-Ill Adults with Stable Oxygenation,” *CHEST Critical Care*, p. 100305, Aug. 2026, doi: 10.1016/j.chstcc.2026.100305.
- [13] FDA ARTDP, “FDA Executive Summary: Performance Evaluation of Pulse Oximeters Taking into Consideration Skin Pigmentation, Race and Ethnicity,” Executive Summary, Feb. 2024.
- [14] M. S. Rea and A. Bierman, “Light Source Spectra Are the Likely Cause of Systematic Bias in Pulse Oximeter Readings for Individuals with Darker Skin Pigmentation,” *British Journal of Anaesthesia*, vol. 131, no. 4, pp. e101–e103, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.bja.2023.04.018.
- [15] A. Bierman, K. Benner, and M. S. Rea, “Melanin Bias in Pulse Oximetry Explained by Light Source Spectral Bandwidth,” *British Journal of Anaesthesia*, vol. 132, no. 5, pp. 957–963, May 2024, doi: 10.1016/j.bja.2024.01.037.
- [16] K. J. Benner, N. N. Goel, and M. S. Rea, “Cause, Effect, and Remediation of Melanin-Associated Bias in Pulse Oximetry,” *Journal of Biomedical Optics*, vol. 31, no. 2, p. 28002, Feb. 2026, doi: 10.1117/1.JBO.31.2.028002.

- [17] K. Benner, A. Bierman, and M. Rea, "Light Source Spectra and Higher Measurement Uncertainty in Pulse Oximeter Readings for Individuals with Darker Skin Pigmentation," *British Journal of Anaesthesia*, vol. 134, no. 3, pp. 856–858, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.bja.2024.11.034.
- [18] G. Blaney and S. Fantini, "Broad-Linewidth Sources Result in a Skin-Tone Bias in Noninvasive Optical Measurement of Oxygen Saturation," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 31, no. 7, p. 70501, Jul. 2026, doi: 10.1117/1.JBO.31.7.070501.
- [19] J. A. Pologe, N. K. You, M. Blumstein, K. L. Snyder, and W. W. Hay, "Laser-Based Pulse Oximetry Eliminates Pigmentation Effects on Oxygen Saturation Measurements: A Pilot Study," *PLOS ONE*, vol. 20, no. 10, p. e0333109, Oct. 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0333109.
- [20] G. Blaney, J. Frias, F. Tavakoli, A. Sassaroli, and S. Fantini, "Dual-Ratio Approach to Pulse Oximetry and the Effect of Skin Tone," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 29, no. S3, p. S33311, Oct. 2024, doi: 10.1117/1.JBO.29.S3.S33311.
- [21] R. Al-Halawani, M. Qassem, and P. A. Kyriacou, "Monte Carlo Simulation of the Effect of Melanin Concentration on Light-Tissue Interactions for Transmittance Pulse Oximetry Measurement," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 29, no. S3, p. S33305, Aug. 2024, doi: 10.1117/1.JBO.29.S3.S33305.
- [22] N. Stubán and N. Masatsugu, "Non-Invasive Calibration Method for Pulse Oximeters," *Periodica Polytechnica Electrical Engineering (Archives)*, vol. 52, no. 1–2, pp. 91–94, 2008, doi: 10.3311/pp.ee.2008-1-2.11.
- [23] E. D. Chan, M. M. Chan, and M. M. Chan, "Pulse Oximetry: Understanding Its Basic Principles Facilitates Appreciation of Its Limitations," *Respiratory Medicine*, vol. 107, no. 6, pp. 789–799, Jun. 2013, doi: 10.1016/j.rmed.2013.02.004.
- [24] G. Blaney, A. Sassaroli, and S. Fantini, "Critical Analysis of the Relationship between Arterial Saturation and the Ratio-of-Ratios Used in Pulse Oximetry," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 29, no. S3, p. S33313, Nov. 2024, doi: 10.1117/1.JBO.29.S3.S33313.
- [25] N. Fong, M. Lipnick, J. Feiner, and T. Law, "OpenOximetry Repository." *PhysioNet*, Jul. 2024. doi: 10.13026/2g7z-t345.
- [26] J. Wu, J. C. McKnight, E.-M. S. Bønnelycke, G. Bosco, T. A. Giacon, and J. M. Kainerstorfer, "Self-Calibrated Pulse Oximetry Algorithm Based on Photon Pathlength Change and the Application in Human Freedivers," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 28, no. 11, p. 115002, Nov. 2023, doi: 10.1117/1.jbo.28.11.115002.
- [27] J. R. Feiner, J. W. Severinghaus, and P. E. Bickler, "Dark Skin Decreases the Accuracy of Pulse Oximeters at Low Oxygen Saturation: The Effects of Oximeter Probe Type and Gender," *Anesthesia & Analgesia*, vol. 105, no. 6, p. S18, Dec. 2007, doi: 10.1213/01.ane.0000285988.35174.d9.
- [28] G. Blaney, J. Frias, F. Tavakoli, A. Sassaroli, and S. Fantini, "Preliminary Investigation of Partial Optical Path-Lengths in Pulse Oximetry," in *Proc SPIE, SPIE*, Mar. 2025, pp. 82–86. doi: 10.1117/12.3042282.
- [29] Z. D. Walton, P. A. Kyriacou, D. G. Silverman, and K. H. Shelley, "Measuring Venous Oxygenation Using the Photoplethysmograph Waveform," *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, vol. 24, no. 4, pp. 295–303, Aug. 2010, doi: 10.1007/s10877-010-9248-y.
- [30] J. M. Kainerstorfer, A. Sassaroli, and S. Fantini, "Optical Oximetry of Volume-Oscillating Vascular Compartments: Contributions from Oscillatory Blood Flow," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 21, no. 10, p. 101408, Mar. 2016, doi: 10.1117/1.jbo.21.10.101408.
- [31] J. ao Matos et al., "BOLD: Blood-gas and Oximetry Linked Dataset," *Scientific Data*, vol. 11, no. 1, p. 535, May 2024, doi: 10.1038/s41597-024-03225-z.
- [32] G. Blaney and J. Frias, "Melanin- and Linewidth-Corrected Pulse-Ox on the Open Oximetry Dataset." 2026.
- [33] I. Silva and G. Moody, "An Open-source Toolbox for Analysing and Processing PhysioNet Databases in MATLAB and Octave," *Journal of Open Research Software*, vol. 2, no. 1, Sep. 2014, doi: 10.5334/jors.bi.
- [34] S. Vasudevan, W. C. Vogt, S. Weininger, and T. J. Pfefer, "Melanometry for Objective Evaluation of Skin Pigmentation in Pulse Oximetry Studies," *Communications Medicine*, vol. 4, no. 1, pp. 1–19, Jul. 2024, doi: 10.1038/s43856-024-00550-7.
- [35] N. Kollias, "The Physical Basis of Skin Color and Its Evaluation," *Clinics in Dermatology*, vol. 13, no. 4, pp. 361–367, Jul. 1995, doi: 10.1016/0738-081x(95)00075-q.
- [36] D. Yudovsky and L. Pilon, "Retrieving Skin Properties from in Vivo Spectral Reflectance Measurements," *Journal of Biophotonics*, vol. 4, no. 5, pp. 305–314, 2011, doi: 10.1002/jbio.201000069.
- [37] S. L. Jacques, "Optical Properties of Biological Tissues: A Review," *Physics in Medicine and Biology*, vol. 58, no. 11, pp. R37–R61, May 2013, doi: 10.1088/0031-9155/58/11/r37.
- [38] UCSF Hypoxia Lab, "Protocol for Skin Color Assessment for Pulse Oximeter Performance Studies." San Francisco, CA USA, Apr. 2025.
- [39] Konica Minolta, "Spectrophotometer CM-700d/600d Instruction Manual." Tokyo, Japan, 2018.
- [40] G. Blaney, A. Sassaroli, and S. Fantini, "Spatial Sensitivity to Absorption Changes for Various Near-Infrared Spectroscopy Methods: A Compendium Review," *Journal of Innovative Optical Health Sciences*, vol. 17, no. 04, p. 2430001, Feb. 2024, doi: 10.1142/s1793545824300015.

- [41] A. García-Valenzuela, F. L. S. Cuppo, and J. A. Olivares, “An Assessment of Saunderson Corrections to the Diffuse Reflectance of Paint Films,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 274, no. 1, p. 12125, 2011, doi: 10.1088/1742-6596/274/1/012125.
- [42] R. S. Berns, Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 4th ed. Hoboken, NJ USA: John Wiley & Sons, 2019.

致谢

G. B. 受美国国立卫生研究院 K99-HL181290 课题资助。文中内容责任完全由作者承担，不一定代表资助机构的官方观点。

作者贡献声明

G. B. 与 V. K. 提出研究构想。G. B.、J. F. 与 S. F. 建立理论。G. B. 与 R. D. 整理数据集。G. B. 编写分析代码、执行分析、撰写初稿并获得资助。S. F. 与 V. K. 指导研究。全体作者审阅了稿件。

附加信息

作者声明不存在竞争利益。