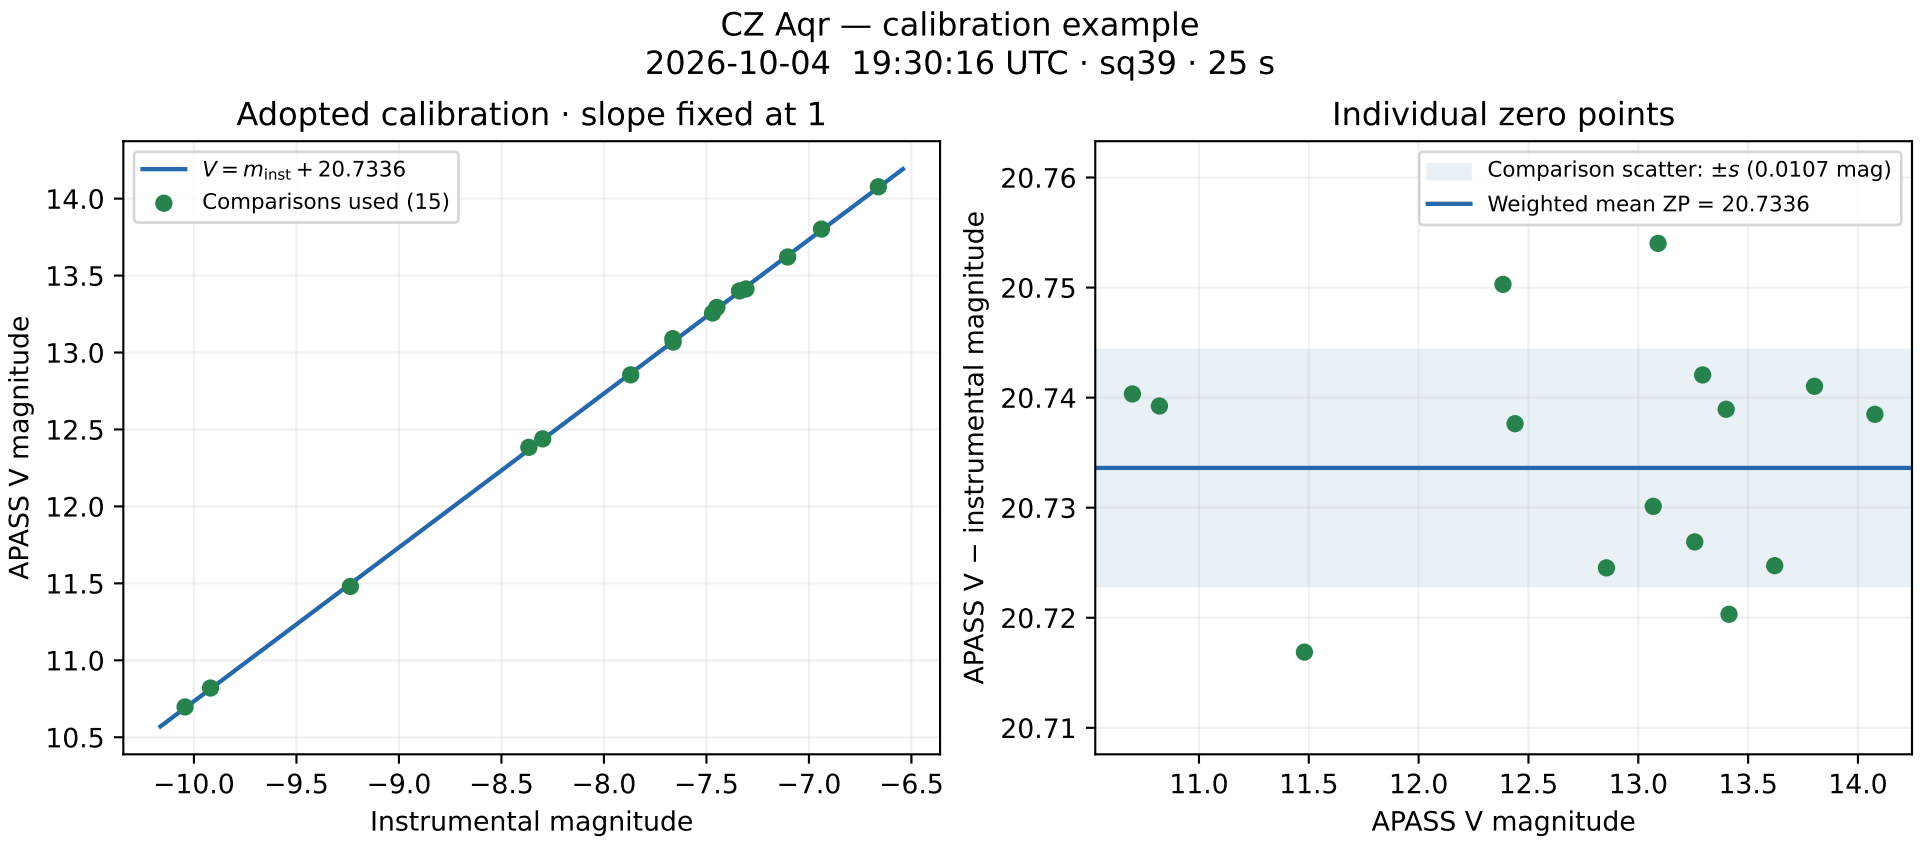
CZ Aqr — calibration example
2026-10-04 19:30:16 UTC · sq39 · 25 s
Adopted calibration · slope fixed at 1
$V = m_{inst} + 20.7336$
Comparisons used (15)
APASS V magnitude
Instrumental magnitude
Individual zero points
Comparison scatter: ±s (0.0107 mag)
Weighted mean ZP = 20.7336
APASS V − instrumental magnitude
APASS V magnitude