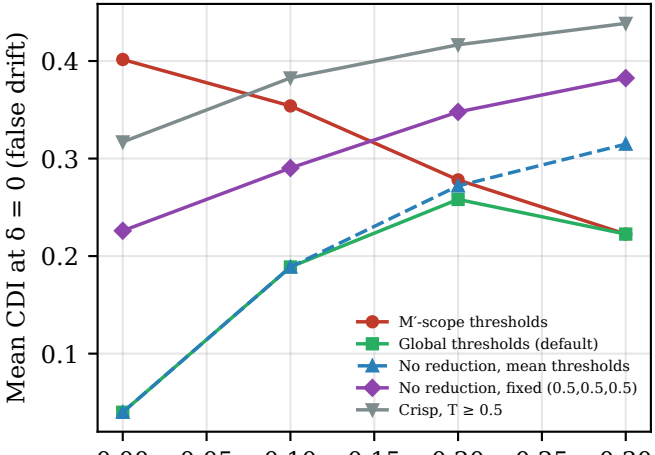
Mean CDI at δ = 0 (false drift)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Cell noise rate
M′-scope thresholds
Global thresholds (default)
No reduction, mean thresholds
No reduction, fixed (0.5,0.5,0.5)
Crisp, T ≥ 0.5

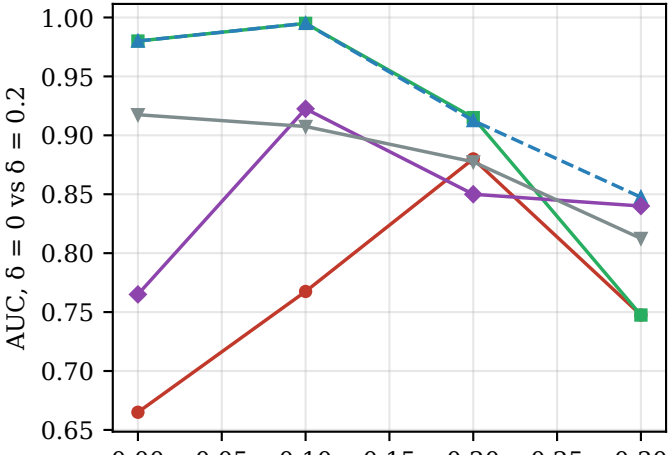
AUC, δ = 0 vs δ = 0.2
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Cell noise rate