


VISTA DESDE LA PIEL 2:1

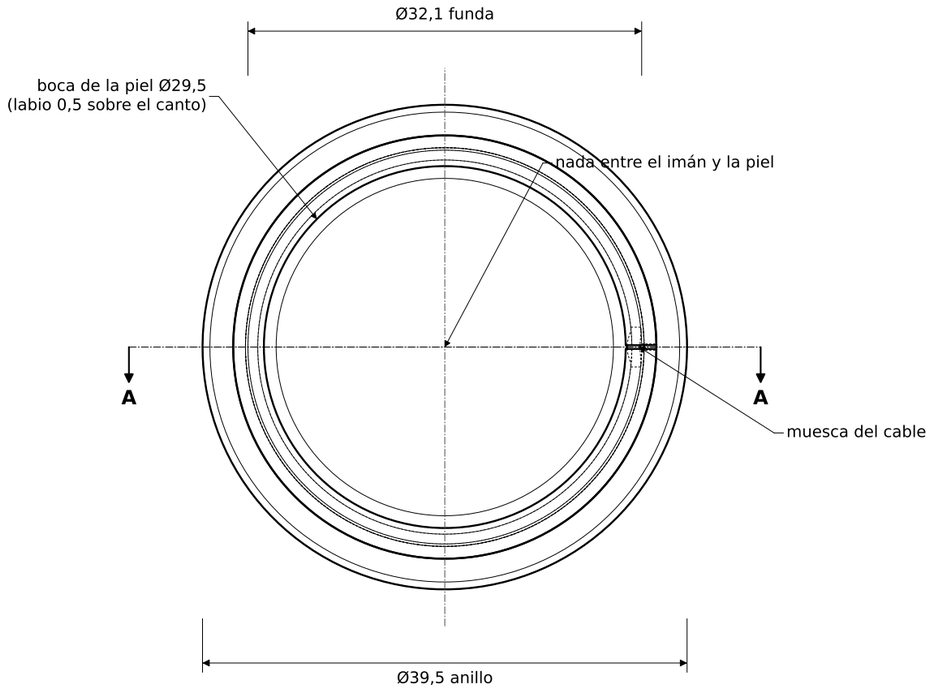


DETALLE B: LABIO DE LA PIEL, CANALETA Y ANILLO 6:1

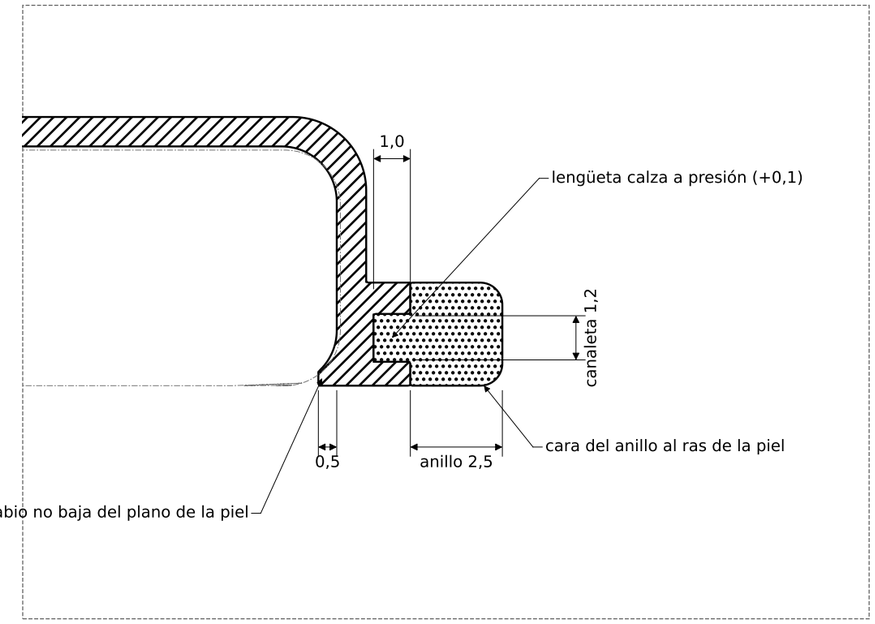

CORTE A-A (por la muesca) 2:1

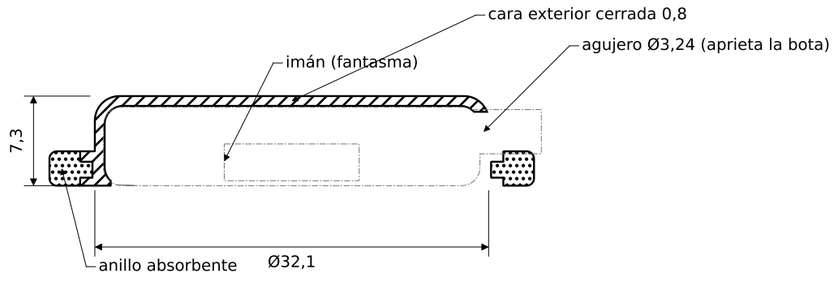

DETALLE C: SALIDA DEL CABLE (corte por la pared del canto) 4:1

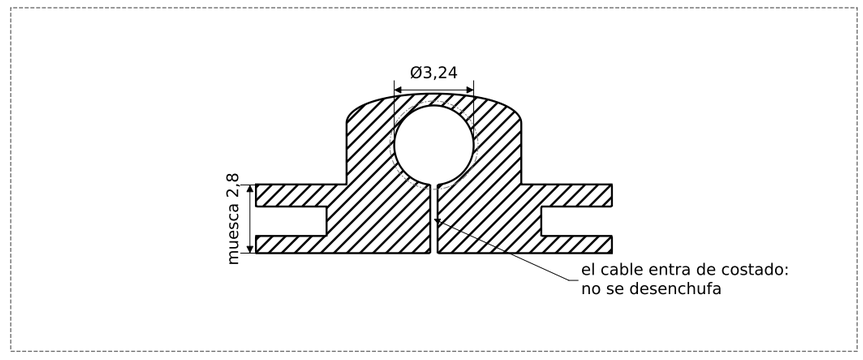

NOTAS

1. Funda: silicona LSR de grado médico, Shore A 20–30. Anillo: malla 3D de poliéster, lavable y reemplazable.
2. Cara de la piel abierta: entre el imán y la piel no hay material (requisito < 0,5). La fuerza no cambia.
3. La bobina entra por la boca de la piel; el canto calza con 0,1 de apriete por lado.
4. Bobina de referencia: Nucleus 8 Slimline, Ø30,7 x 6,4 (ficha FUN4812).
5. Imán, bota y diámetro del cable supuestos (ver README). Tolerancia general ±0,1.
6. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501).
7. Muesca: corte a cuchilla con plantilla, del agujero del cable a la boca de la piel (dibujada con 0,3).
8. La bobina ya es parte del sistema IP68 del procesador: la funda la cubre del lado expuesto (lluvia, arena, golpes) y el anillo junta el sudor del borde. No es para nadar.

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

MÓDULO 2 · FUNDA DE BOBINA + ANILLO

Bobina de referencia: Cochlear Nucleus 8 Slimline	Masa: 1,58 g + anillo 0,11 g
LSR Shore A 20–30 · anillo de malla 3D de poliéster	Fecha: 02/11/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 5 de 5