


VISTA FRONTAL 2:1

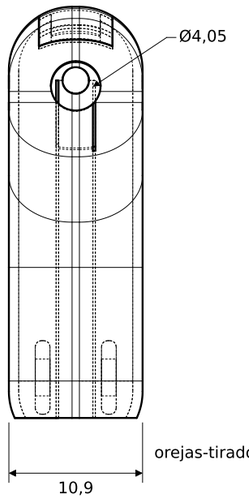


VISTA LATERAL (principal) 2:1

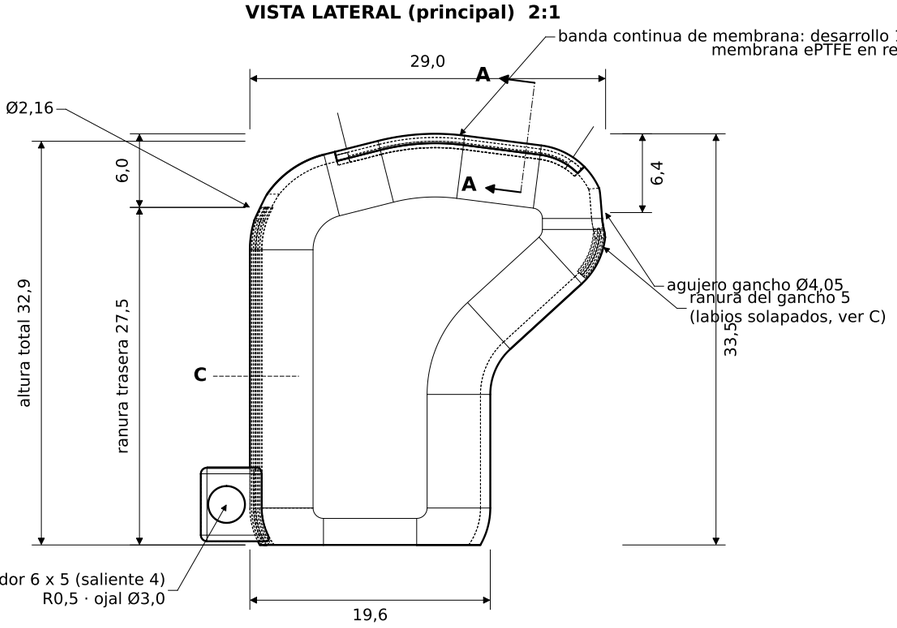

CORTE B-B (plano medio) 2:1

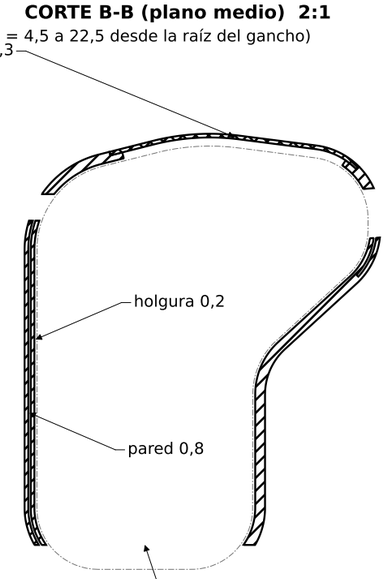


CORTE A-A (micrófono delantero) 5:1

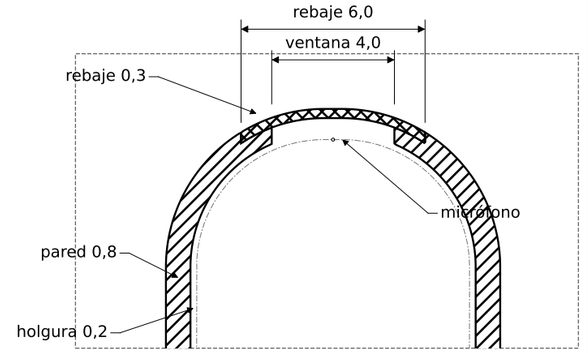


(se muestra sólo la parte superior)

DETALLE C: RANURA CON LABIOS SOLAPADOS 8:1

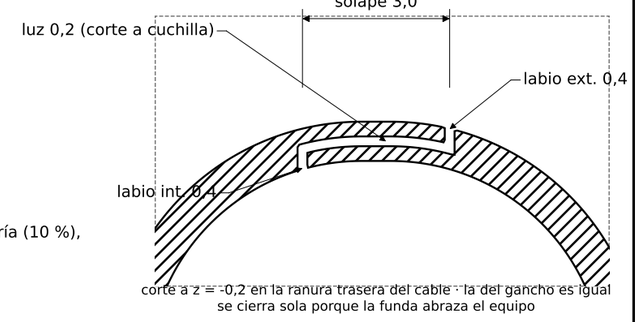

corte a z = -0,2 en la ranura trasera del cable · la del gancho es igual
se cierra sola porque la funda abraza el equipo

VISTA SUPERIOR 2:1

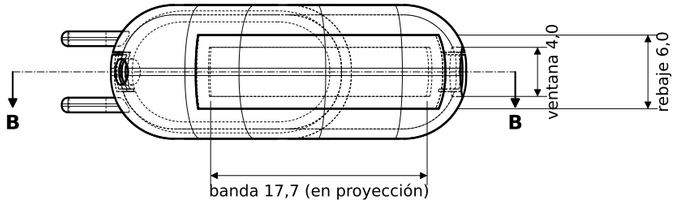

TALLES Y EQUIPOS COMPATIBLES

Talle	Equipos compatibles (el primero da la forma de la funda)
XS	Phonak Audéo I-R · Phonak Audéo I-Sphere
S/M	**Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · Cochlear Nucleus 7 (CP1000)**
M/L Naída	Advanced Bionics Naída CI M90
M/L Sonnet	MED-EL SONNET 2

NOTAS

1. Material: silicona LSR de grado médico, Shore A 30–35, hipoalergénica, lavable. Densidad 1,15 g/cm³.
2. Pared 0,8 · holgura 0,2 · banda continua: membrana de ePTFE en rebaje 0,3.
3. Interior texturizado: puntos semiesféricos de 0,2 de alto, Ø0,6, paso 1,5, en las dos caras laterales (262 puntos).
4. Largo: cubre hasta la batería más corta del talle; las más largas asoman por la boca.
   Asoma por la boca (mm) · Cochlear Nucleus 8: Compact 2,0, Power Compact 6,9, Power Extend 10,9, Descartable 2x675 15,0
   Asoma por la boca (mm) · Cochlear Nucleus 7: Compact 4,1, Estándar 10,9, Descartable 2x675 11,3
5. Colocación tipo media, con gancho y cable puestos: se pasa el gancho por su agujero (ranura corta) y se
   baja la boca sobre el procesador; el cable de la bobina entra por la ranura trasera. Se saca tirando de la boca.
6. Medidas del procesador supuestas donde no hay ficha (ver README). Tolerancia general ±0,1.
7. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501). Trazo y punto gris: procesador (fantasma).

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

FUNDA AURA · MEMBRANA HIDROFÓBICA · TALLE S/M

Referencia: Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · también Nucleus 7 (CP1000)	Masa: 1,74 g (silicona)
Silicona LSR grado médico Shore A 30–35 + membrana ePTFE	Fecha: 05/11/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 2 de 4