


VISTA FRONTAL (cara exterior) 2:1

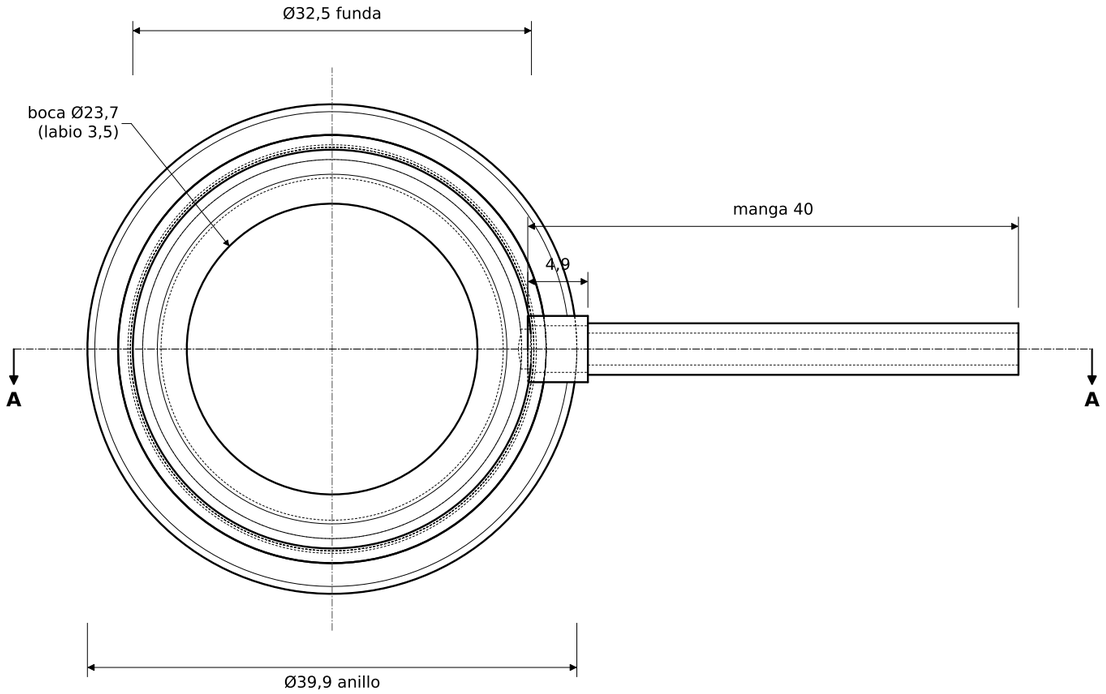


DETALLE B: CANALETA Y ANILLO (borde opuesto al cable) 6:1

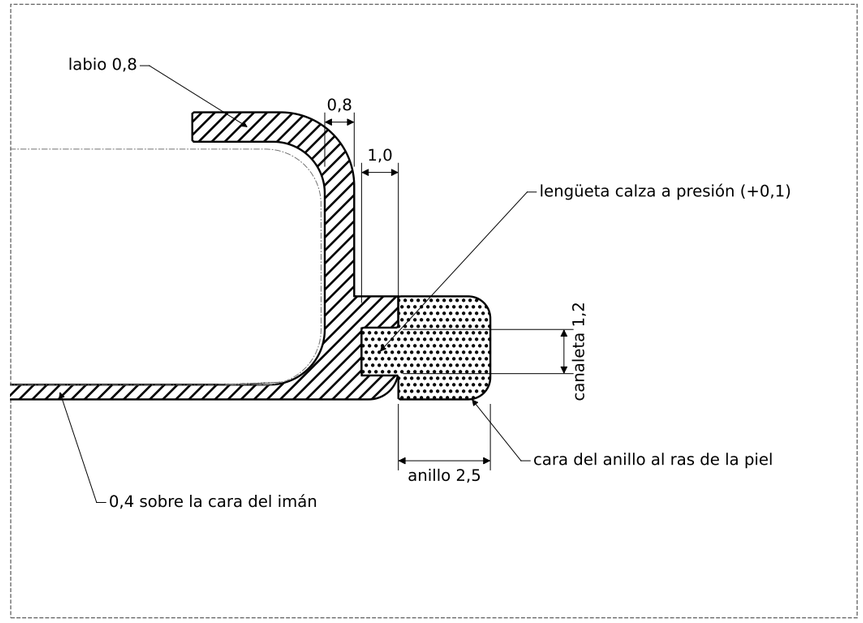

CORTE A-A 2:1

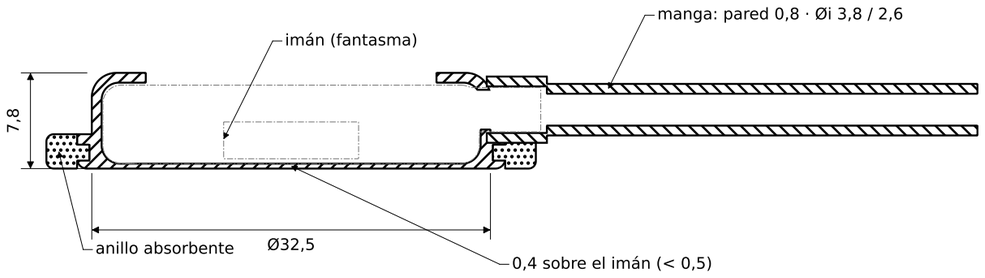

MANGA DEL CABLE (inicio, corte A-A) 4:1

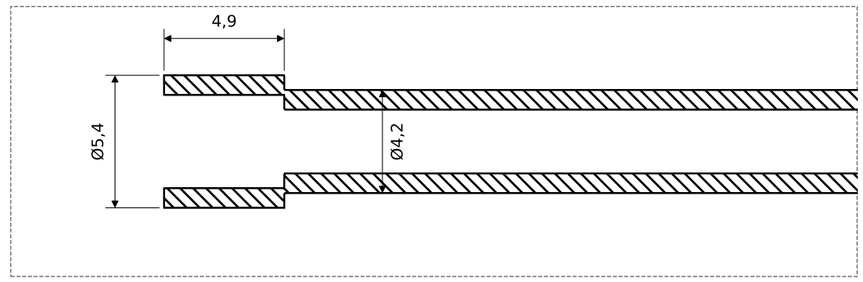

sigue hasta 40 con Øi 2,6

NOTAS

1. Funda: silicona LSR de grado médico, Shore A 20–30. Manga: misma silicona.
2. Espesor sobre la cara del imán 0,4 (< 0,5) para no reducir la fuerza magnética.
3. Anillo absorbente desmontable: espuma de PU hidrófila de celda abierta o malla 3D de bambú.
4. Bobina de referencia: Nucleus 8 Slimline, Ø30,7 x 6,4 (ficha FUN4812).
5. Imán, bota y diámetro del cable supuestos (ver README). Tolerancia general ±0,1.
6. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501).
7. La cara exterior de la bobina queda abierta a propósito: es la boca por donde entra la bobina (el labio de 3,5 la retiene), no suma espesor ni peso, deja salir humedad y calor y deja el imán accesible. El sudor viene de la cabeza: por eso la cara cerrada es la de la piel, con 0,4 sobre el imán.

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

MÓDULO 2 · FUNDA DE BOBINA + ANILLO + MANGA

Bobina de referencia: Cochlear Nucleus 8 Slimline	Masa: 1,99 g + anillo 0,08 g
LSR Shore A 20–30 · anillo de espuma PU hidrófila	Fecha: 16/10/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 5 de 5