



Controllo indipendente in doppia precisione

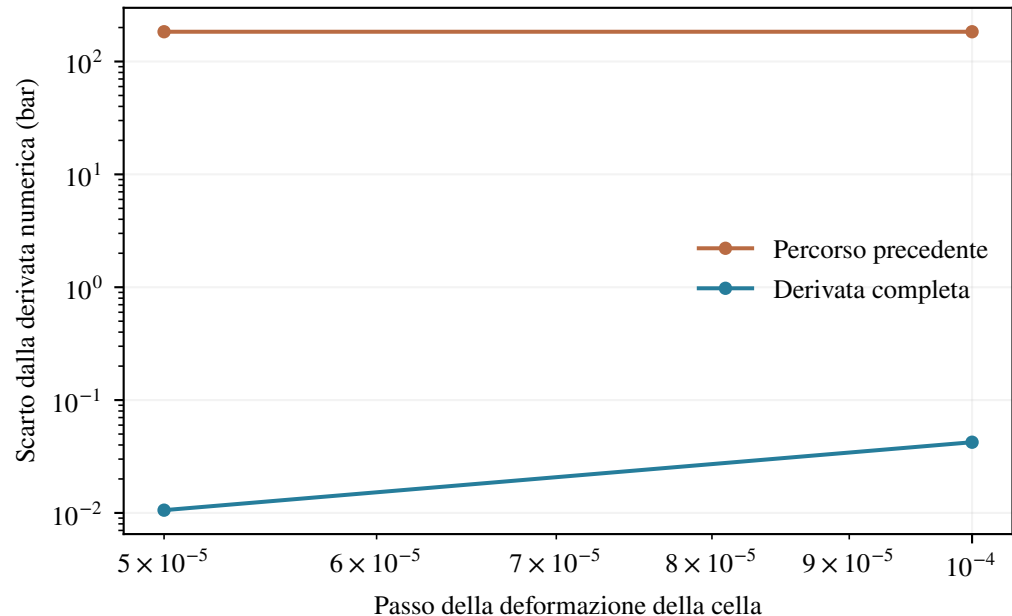

Stessa partenza, controllo a pressione imposta

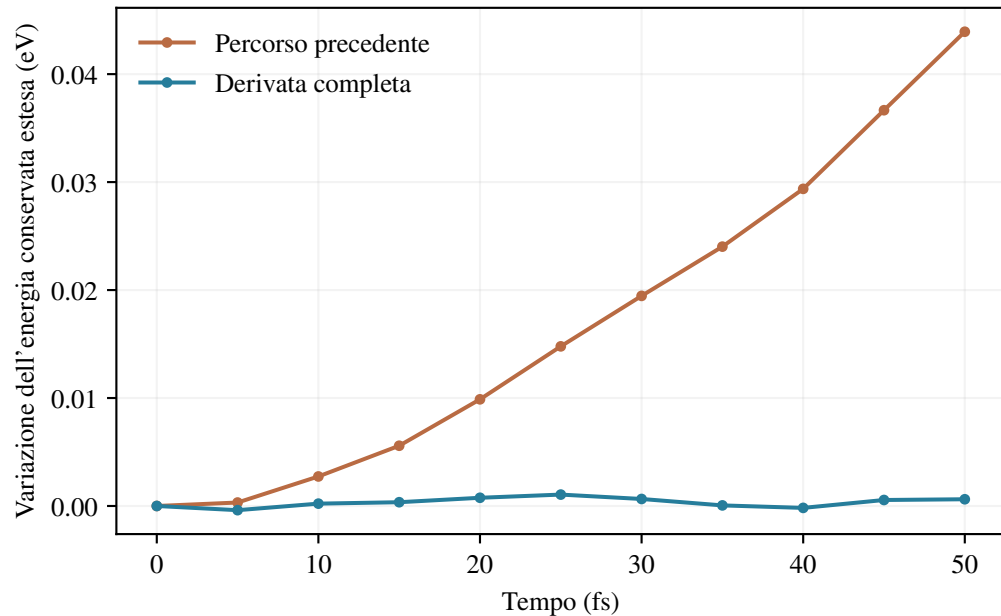

HFIP, 16 molecole. Energia e forze preservate; controllo del metodo, senza qualificazione della pulizia o del liquido di equilibrio.