

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 15-12-2015

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 07:34

Perdas de Fixação: 0/11

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 25

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 02:21

Fóvea: 36 dB

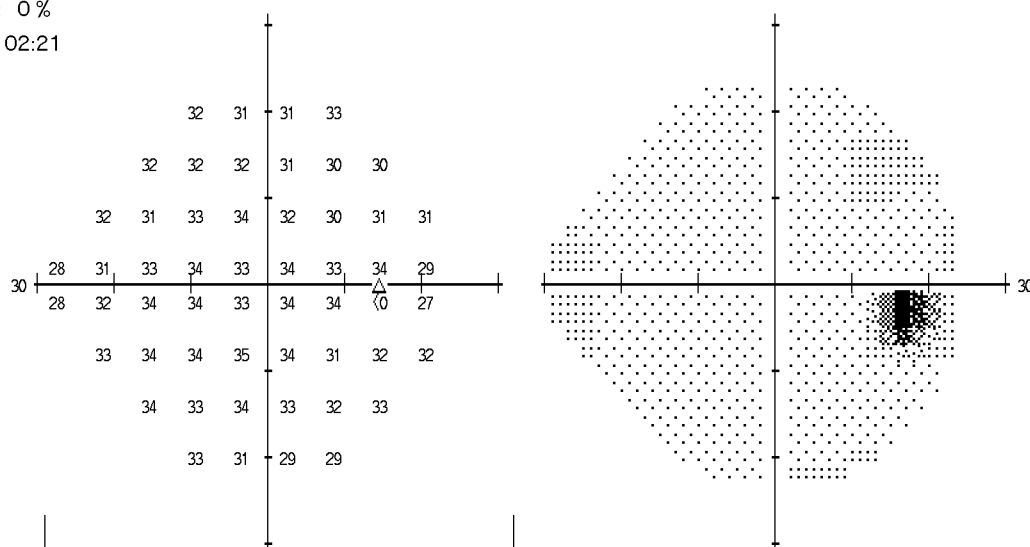

2	2	2	4
0	0	1	0 -1 -1
0	-2	0	0 -1 -3 -1 0
-2	0	0	0 -1 0 -1 -3
-2	0	1	-1 -1 0 0 -5
1	1	0	1 0 -2 -1 0
2	1	1	0 0 1
2	0	-3	-2

0	0	0	2
-1	-2	-1	-2 -2 -2
-1	-3	-2	-1 -2 -4 -3 -1
-3	-2	-1	-2 -3 -2 -2 -4
-3	-1	-1	-2 -3 -1 -2 -6
0	0	-1	-1 -2 -3 -2 -1
1	-1	0	-2 -2 -1
1	-2	-4	-4

GHT


Dentro dos limites normais

VFI 99%


MD -0.24 dB

PSD 1.42 dB

Desvio Total

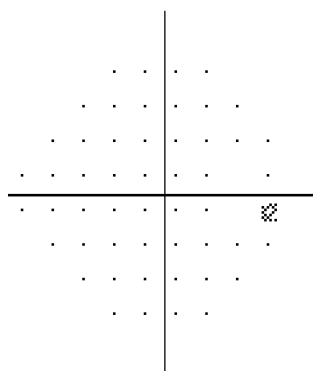

Modelo de Desvio

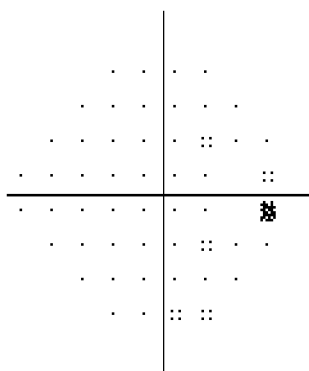

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%