

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 26-02-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:56

Perdas de Fixação: 3/13 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X



Idade: 23

Erros Falsos POS: 2 %

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 03:06

Fóvea: 38 dB

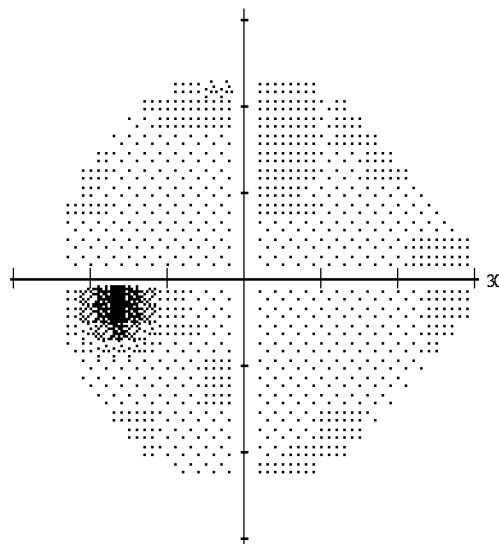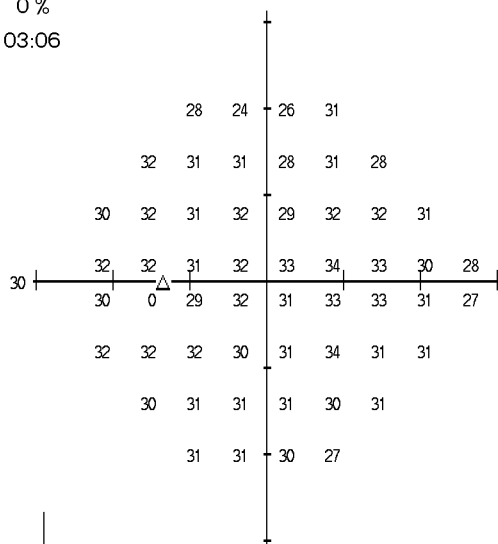

-1	-5	-3	1
1	0	0	-4
-1	0	-2	-1
1	-3	-3	-2
-2	-5	-3	-3
0	-1	-2	-4
-3	-2	-2	-1
-1	-1	-2	-3

-1	-5	-3	1
1	0	0	-4
-1	0	-1	-1
1	-3	-2	-2
-2	-5	-3	-3
0	0	-2	-4
-3	-1	-2	-1
-1	-1	-1	-3

\*\*\* Low Test Reliability \*\*\*

GHT


Dentro dos limites normais

VFI 98%


MD -1.66 dB P &lt; 10%

PSD 1.49 dB

Desvio Total

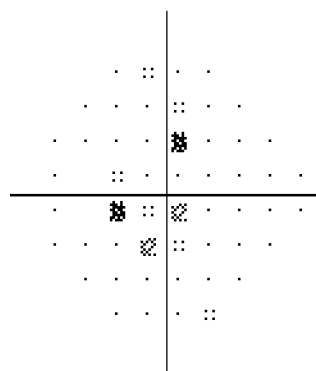

Modelo de Desvio

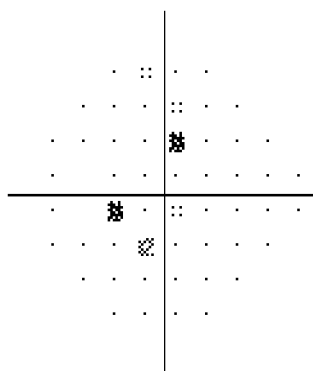

:: &lt; 5%

⊗ &lt; 2%

⊠ &lt; 1%

■ &lt; 0.5%

