

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 08-12-2015

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:34

Perdas de Fixação: 0/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 65

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 02:25

Fóvea: OFF

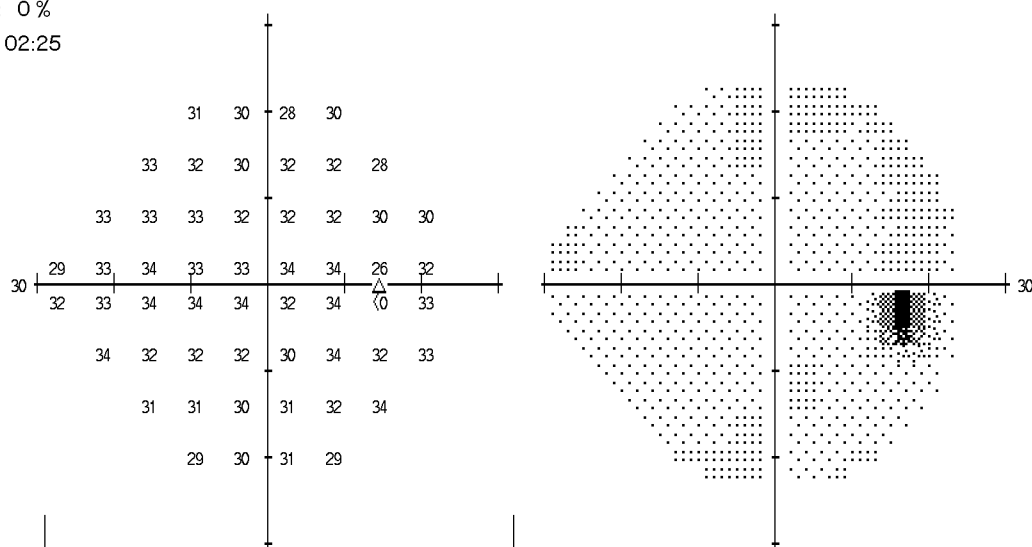

4	3	2	4
4	3	1	3
4	3	2	1
2	3	3	1
5	3	2	2
5	1	1	0
1	0	-1	0
0	1	1	0

1	0	-2	0
1	-1	-2	-1
1	0	-1	-2
-1	0	0	-2
2	0	-1	-2
2	-2	-3	-3
-2	-3	-5	-3
-3	-3	-2	-4

GHT

Dentro dos limites normais



VFI 100%

MD +1.84 dB

PSD 1.50 dB

Desvio Total

Modelo de Desvio

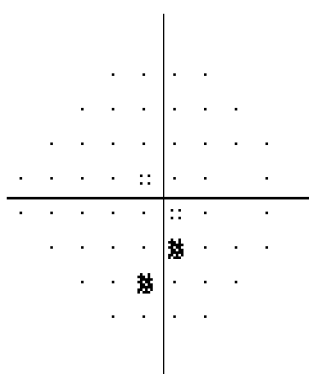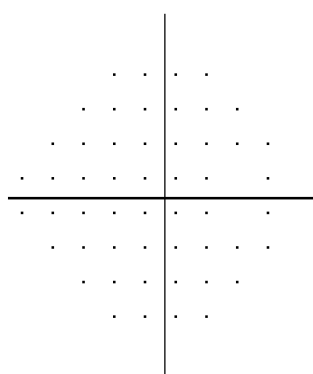

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%