

Nome: UFRGS A7 60

DDN: 28-03-1956

ID: UFRGS A7 60

## Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:52

Perdas de Fixação: 0/12

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 60

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 13 %

Duração do Teste: 04:11

Fóvea: OFF

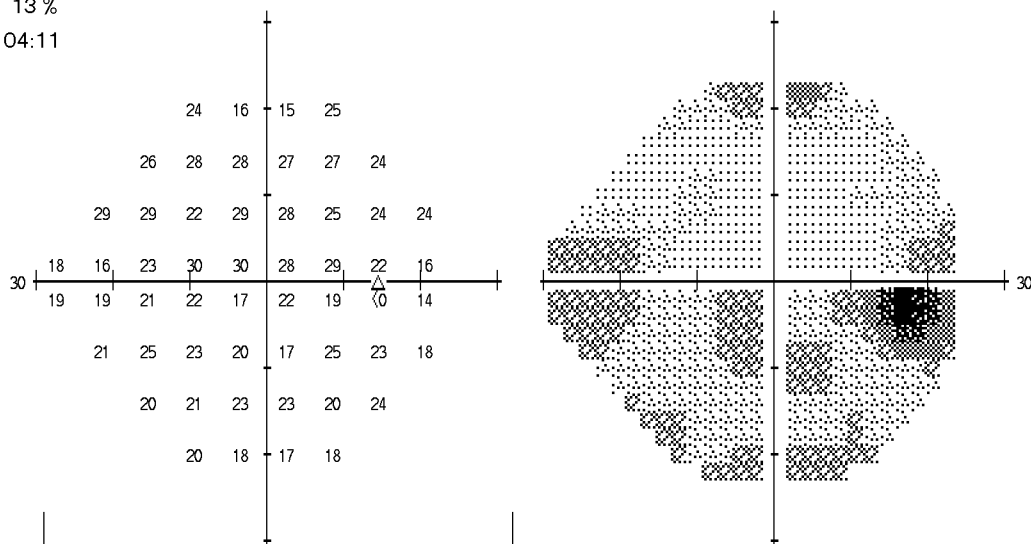

			-3	-12	-12	-1			
			-2	-2	-2	-2	-2	-4	
		0	-1	-9	-2		-3	-5	-5
-9	-13	-9	-2	-3			-4	-3	-14
-8	-11	-11	-10	-16	-11	-13			-16
	-8	-6	-9	-13	-15	-7	-8		-13
		-9	-10	-8		-9	-11	-6	
			-9	-12	-13	-11			

		-1	-10	-10	1		
		0	0	0	0	0	-2
	2	1	-7	0	-1	-3	-3
-7	-12	-7	0	-1	-2	-1	-12
-6	-9	-9	-8	-14	-9	-11	-14
	-6	-4	-7	-11	-13	-5	-6
		-8	-8	-6	-7	-9	-4
			-7	-10	-11	-9	

GHT


Fora dos limites normais

VFI 79%


MD -7.80 dB P &lt; 0.5%

PSD 4.70 dB P &lt; 0.5%

Desvio Total

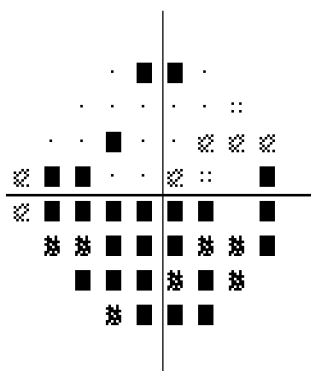

Modelo de Desvio

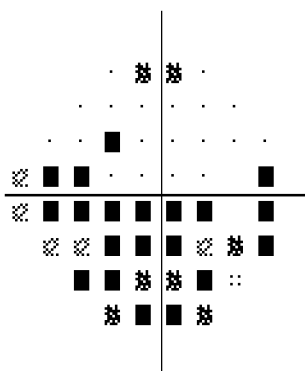

:: &lt; 5%

⊗ &lt; 2%

⊠ &lt; 1%

■ &lt; 0.5%