

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 28-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 15:50

Perdas de Fixação: 5/11 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 25

Erros Falsos POS: 28 % xx

Erros Falsos NEG: 0 %


Duração do Teste: 02:48

Fóvea: OFF

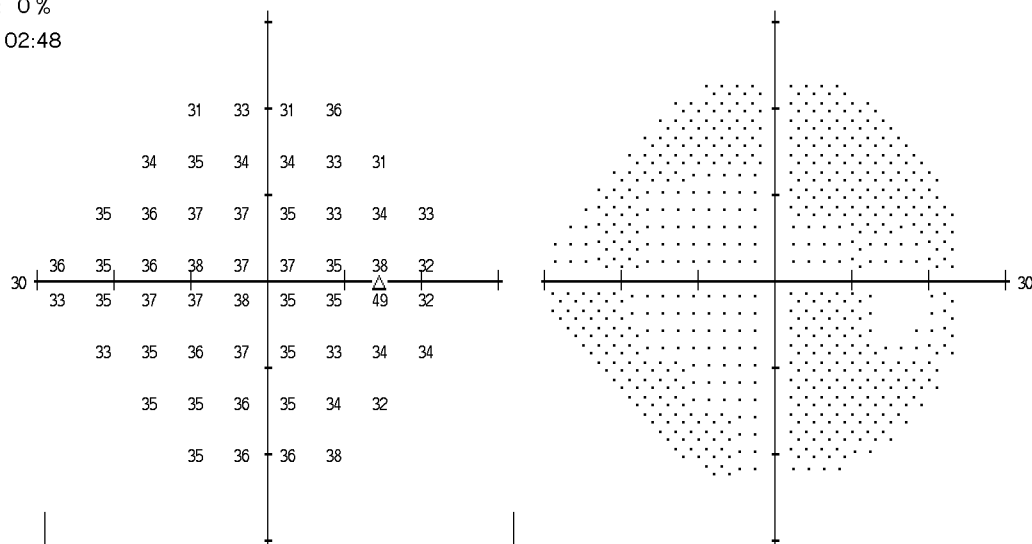


| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 2 2 0 |
| 4 | 3 | 4 | 4 2 1 2 2 |
| 6 | 3 | 3 | 4 3 2 2 0 |
| 4 | 3 | 4 | 3 3 0 1 0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 1 0 1 2 |
| 4 | 2 | 3 | 2 1 0 |
| 4 | 4 | 4 | 6 |

Desvio Total

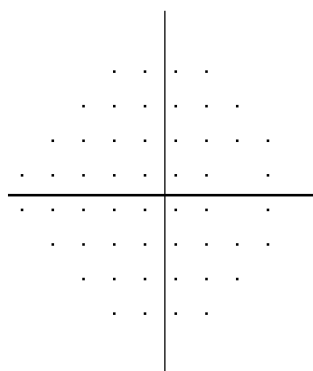

| | | | |
|----|----|----|----------------|
| -3 | -1 | -3 | 2 |
| -1 | -1 | -2 | -2 -2 -4 |
| 0 | -1 | -1 | 0 -2 -4 -2 -2 |
| 2 | -1 | -1 | 0 -1 -2 -2 -4 |
| -1 | -1 | -1 | -1 -1 -4 -3 -4 |
| -2 | -2 | -2 | -1 -3 -4 -3 -2 |
| 0 | -2 | -1 | -2 -3 -4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 |

Modelo de Desvio

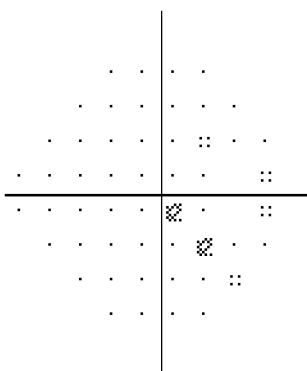

*** Excessive High False Positives ***

GHT

Alta Sensibilidade Anormal

VFI 100%

MD +2.59 dB

PSD 1.44 dB

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%