

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 14-01-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 16:12

Perdas de Fixação: 0/10

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 22

Erros Falsos POS: 5 %

Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 02:30

Fóvea: 36 dB

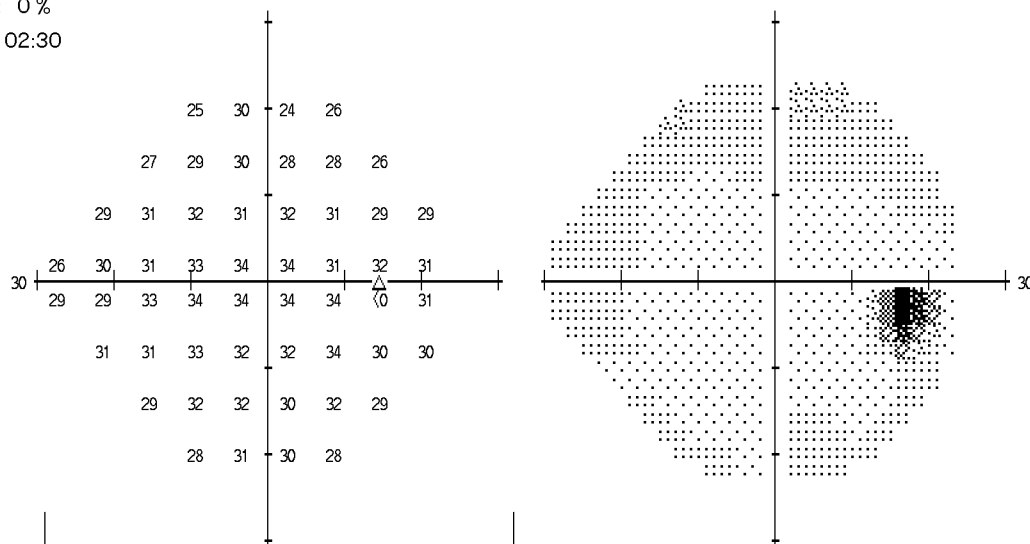

-5	0	-5	-3
-4	-3	-2	-4
-2	-2	-2	-3
-3	-2	-2	-1
-1	-3	-1	0
-1	-2	-1	-2
-3	0	-1	-3
-3	0	-2	-4

-5	0	-5	-3
-4	-3	-2	-4
-2	-1	-1	-3
-3	-2	-2	-1
-1	-2	0	0
0	-2	0	-2
-3	0	0	-2
-3	0	-1	-4

GHT

Dentro dos limites normais



VFI 100%

MD -1.83 dB P < 10%

PSD 1.31 dB

Desvio Total

Modelo de Desvio

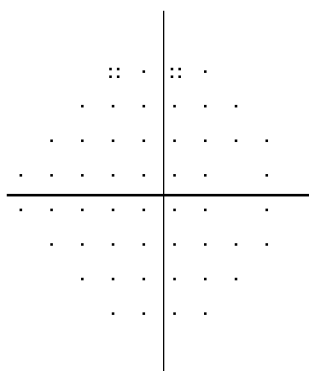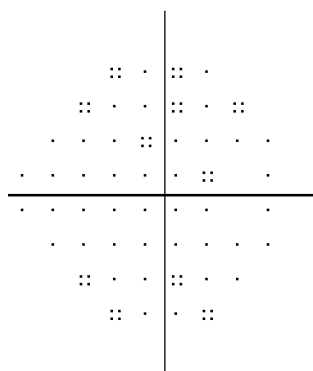

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%