

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 23-03-2016

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:44

Perdas de Fixação: 4/14 xx

Estratégia: SITA-Fast

RX: DS DC X


Idade: 50

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 44 %

Duração do Teste: 04:08

Fóvea: OFF

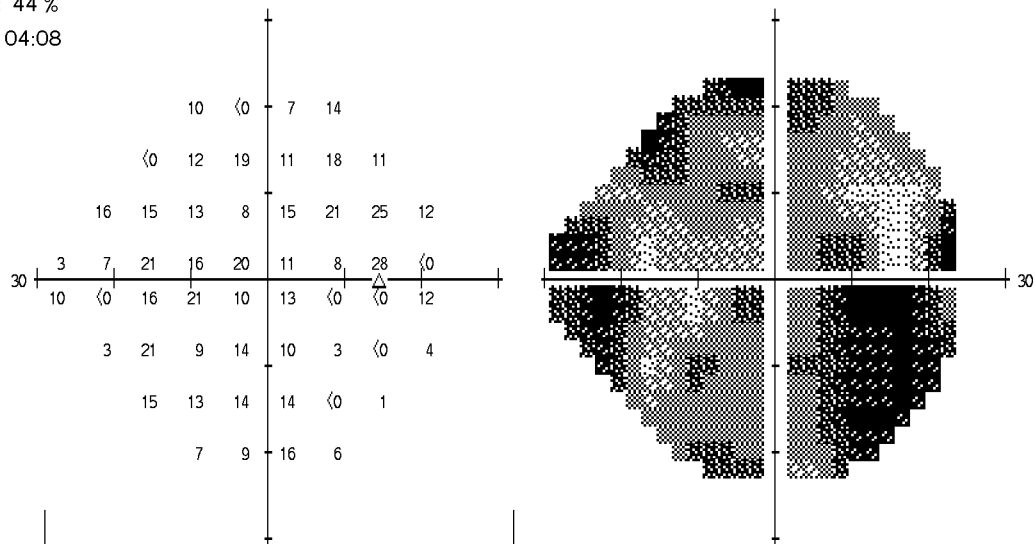

-18 -30 -21 -14
 -31 -18 -12 -18 -12 -18
 -14 -16 -19 -24 -17 -10 -5 -18
 -25 -23 -10 -16 -13 -22 -24 -32
 -18 -32 -16 -12 -23 -20 -34 -19
 -27 -11 -24 -19 -23 -29 -33 -27
 -15 -18 -18 -17 -33 -30
 -23 -21 -14 -24

-6 -18 -9 -2
 -20 -6 0 -7 0 -6
 -2 -4 -7 -13 -5 2 6 -6
 -13 -11 1 -5 -1 -10 -12 -21
 -6 -21 -5 0 -12 -8 -23 -7
 -15 1 -12 -7 -11 -18 -22 -15
 -3 -6 -6 -5 -22 -18
 -11 -9 -2 -12

*** Low Test Reliability ***

GHT


Fora dos limites normais

VFI 45%


MD -19.82 dB P < 0.5%

PSD 7.06 dB P < 0.5%

Desvio Total

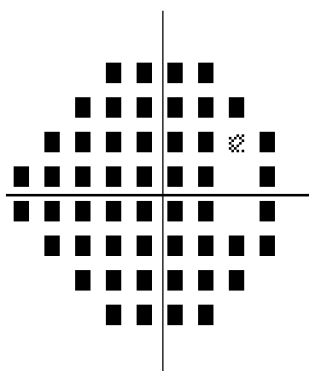

Modelo de Desvio

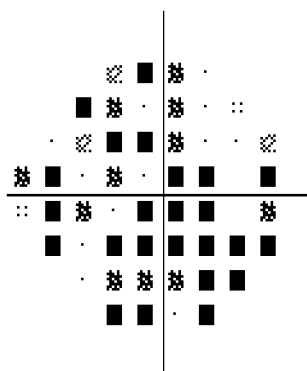

:: < 5%

⊗ < 2%

⊗ < 1%

■ < 0.5%