

Nome: MARCELO OLIVEIRA

DDN: 06-10-1990

ID: MATA2

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego

Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 16-10-2015

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 17:26

Perdas de Fixação: 0/14

Estratégia: SITA-Standard

RX: DS DC X



Idade: 25

Erros Falsos POS: 0 %


Erros Falsos NEG: 0 %

Duração do Teste: 03:58

Fóvea: 37 dB

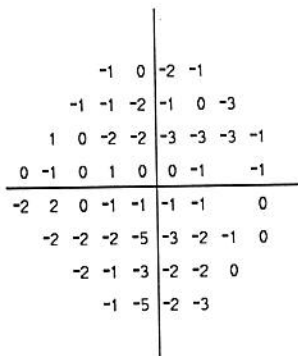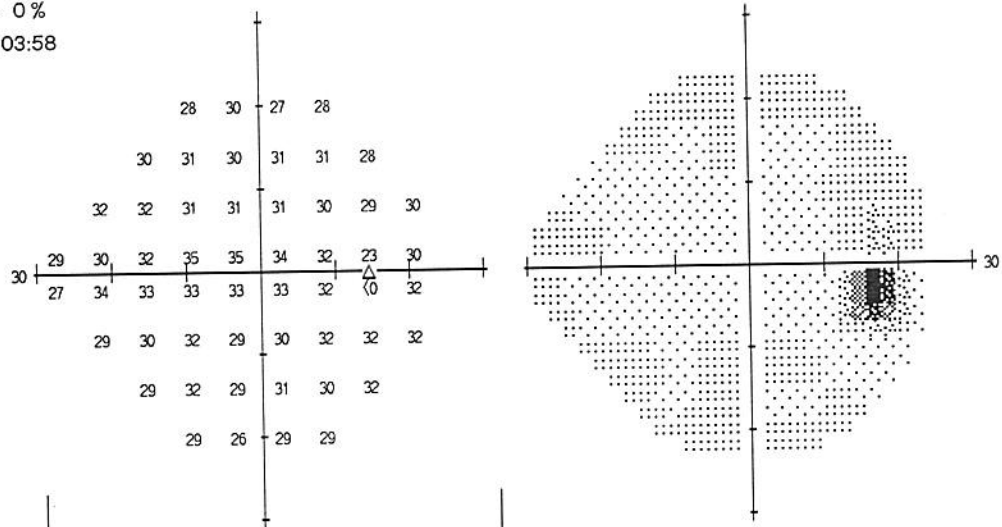

Desvio Total

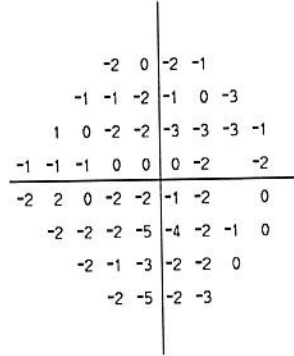

Modelo de Desvio


GHT

Dentro dos limites normais

VFI 99%

MD -1.32 dB

PSD 1.47 dB

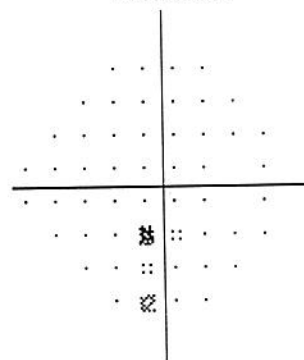

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%

