UCS-P-0007-26
2026-02-11

UNITED
CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)* : **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: Av. 3H Entre Calle 68 y 70, Edif. Macame, Piso PB Of 69-61, Sector Bellas Arte, Maracaibo, Zulia

Nota de Recepción (NDR): *Receipt note* 0032-26 **Fecha de Recepción:** *Date of Reception* 2026-02-06

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: *Instrument to calibrate*	Manómetro Digital
Marca: *Manufacturer*	Fluke
Modelo: *Model*	700RG29 3K
Serial: *Serial number*	6185365
Código: *Code*	S/C
Ubicación: *Location*	No aplica
Rango: *Range*	(0 a 3 000) psi
Valor de División: *Scale interval*	0,1 psi
Clase: *Class*	± (0,05 % de la full escala)
Fecha de Calibración: *Date of calibration*	2026-02-11
Próxima Calibración: *Date of re-calibration*	2027-02-11
Lugar de Calibración: *Place of calibration*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizandose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

UNITED
CALIBRATION SERVICES
RIF: J410799889

Sello
Seal

2026-02-12
Fecha de Emisión
Date

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-P-0007-26
2026-02-11

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método: *Procedure/Method*
DKD-R 6-1, Sec. B, Edición 03:2014 Rev 3
Método I

Temperatura Ambiental: *Ambient Temperature* (23,4 ± 1 °C)

Humedad Relativa: *Relative Humidity* (43,3 ± 5 %HR)

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Manómetro Digital	UCS-1032	N25040440	2026-04-04

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: *Item condition*
Se constató que el sensor del instrumento se encuentra doblado, condición que impide la aplicación de ajustes. No obstante, la calibración se llevó a cabo con la autorización del cliente, quien fue informado de esta situación.

Datos suministrados por el cliente: *Data provided by the customer:*
No aplica

Declaración de conformidad según: *Comformity declaration according to*
Especificaciones del fabricante

Opiniones e Interpretaciones: *Opinions and Interpretations*
No aplica

Desviaciones de las condiciones especificadas: *Deviations from specified conditions:*
No aplica

Otros: *others*
Sin comentarios

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-P-0007-26
2026-02-11

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Medidas del Patrón	Medidas del Instrumento		
	Ciclo #1		Ciclo#2
	Ascendente 1	Descendente 1	Ascendente 2
psi	psi	psi	psi
0,00	0,0	0,0	0,0
300,00	299,9	300,0	299,9
600,00	599,7	599,8	599,8
900,00	899,6	899,7	899,6
1200,00	1199,6	1199,7	1199,7
1500,00	1499,4	1499,6	1499,6
1800,00	1682,7	1683,0	1682,8
2100,00	1866,6	1866,5	1866,6
2400,00	1898,7	1898,7	1898,6
2700,00	1923,6	1923,6	1923,9
3000,00	1948,2	1948,2	1948,2

Notas:

a) El error de medición viene dado por: E=Li-Lp

b) La lectura real del instrumento viene dada por: Lr=Li-E

Li= Lectura del Instrumento

Lp= Lectura del Patrón


Lr= Lectura real del instrumento

E= Error de medición

Nota: El factor de conversión utilizado es de 1 MPa = 145,0377377 psi

Medidas del patrón		Valor medio del Instrumento	Error de Medición	Histéresis	Repetibilidad	U (k=2)	Conformidad
MPa	psi	psi	psi	psi	psi	psi	
0,000	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,11	cumple
2,068	300,00	300,0	0,0	0,1	0,0	0,12	cumple
4,137	600,00	599,8	-0,2	0,1	0,1	0,14	cumple
6,205	900,00	899,7	-0,3	0,1	0,0	0,17	cumple
8,274	1200,00	1199,7	-0,3	0,1	0,1	0,18	cumple
10,342	1500,00	1499,6	-0,4	0,2	0,2	0,23	cumple
12,411	1800,00	1682,9	-117,1	0,3	0,1	0,30	no cumple
14,479	2100,00	1866,6	-233,4	0,1	0,0	0,24	no cumple
16,547	2400,00	1898,7	-501,3	0,0	0,1	0,31	no cumple
18,616	2700,00	1923,7	-776,3	0,0	0,3	0,35	no cumple
20,684	3000,00	1948,2	-1051,8	0,0	0,0	0,31	no cumple

Representación gráfica

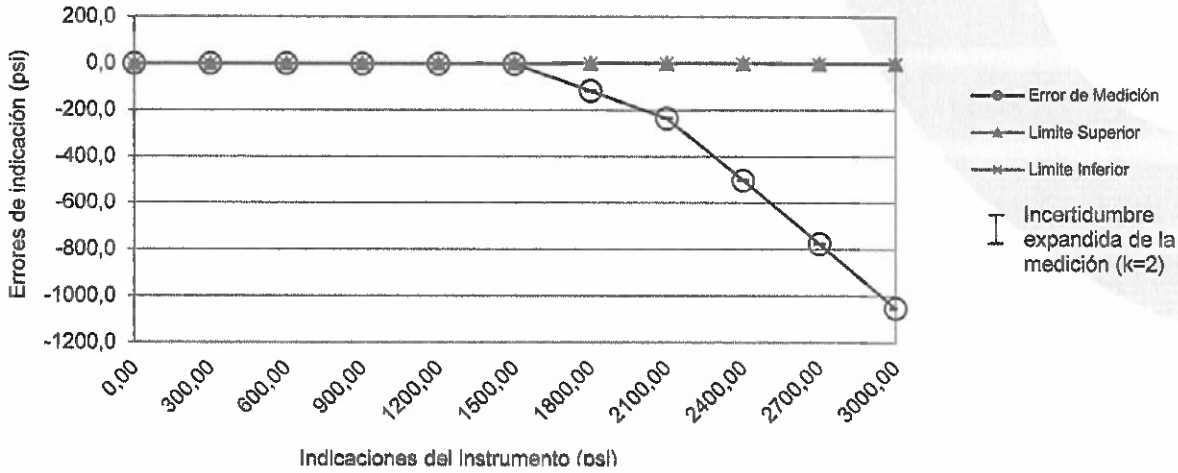

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.