UCS-P-0524-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Código CISS/SENCAMER: CA25UC797A

Cliente *(Customer)*: **SAMPIERI Y FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: AV. 3H ENTRE CALLE 68 Y 70 EDIF. MACAME, PISO PB OF 69-61, SECTOR BELLA ARTE, MARACAIBO. ZULIA

Nota de Recepción (NDR): 0237-25 *Receipt note*

Fecha de Recepción: 2025-09-03 *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: *Instrument to calibrate*	Manómetro Deformación Elástica
Marca: *Manufacturer*	Baker
Modelo: *Model*	B1600
Serial: *Serial number*	B09JDP6K1
Código: *Code*	S/C
Ubicación: *Location*	No Aplica
Rango: *Range*	(0 a 160) in H_2O
Valor de División: *Scale interval*	1 in H_2O
Clase: *Class*	± (1,5 % de la full escala)
Fecha de Calibración: *Date of calibration*	2025-09-10
Próxima Calibración: *Date of re-calibration*	No Aplica
Lugar de Calibración: *Place of calibration*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizandose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

UNITED CALIBRATION SERVICES RIF: J41079988-6

2025-09-11

Sello *Seal* | Fecha de Emisión *Date*

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-P-0524-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.46

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método:
Procedure/Method
DKD-R 6-1, Sec. B, Edición 03:2014 Rev 3
Método II

Temperatura Ambiental: (26,8 ± 1 °C)
Ambient Temperature

Humedad Relativa: (31,1 ± 5 %HR)
Relative Humidity

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Manómetro Digital	UCS-1001	TLM-P-6947	2026-05-31

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: Buenas condiciones para ser calibrado
Item condition

Datos suministrados por el cliente: No aplica
Data provided by the customer:

Declaración de conformidad según: Según norma ASME B4.100
Comformity declaration according to

Opiniones e Interpretaciones: No aplica
Opinions and Interpretations

Desviaciones de las condiciones especificadas: No aplica
Deviations from specified conditions:

Otros: Sin comentarios
others

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-P-0524-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Medidas del Instrumento	Medidas del Patrón		
	Ciclo #1		Ciclo#2
	Ascendente 1	Descendente 1	Ascendente 2
in H_2O	in H_2O	in H_2O	in H_2O
0	0,00	0,00	0,00
16	16,20	15,72	16,22
32	32,58	31,89	32,46
48	49,09	48,12	49,02
64	64,81	64,52	64,67
80	80,84	80,21	80,74
96	96,48	96,26	96,52
112	112,47	111,82	112,49
128	128,62	128,42	128,57
144	144,22	144,09	144,29
160	161,32	161,32	161,15

Notas:

a) El error de medición viene dado por: **E=Li-Lp**

b) La lectura real del instrumento viene dada por: **Lr=Li-E**

Li= Lectura del Instrumento

Lp= Lectura del Patrón


Lr= Lectura real del instrumento

E= Error de medición

Nota: El factor de conversión utilizado es de 1 kPa = 4,01864652 in H_2O

Medidas del Instrumento		Valor medio del Patrón	Error de Medición	Histéresis	Repetibilidad	U (k=2)	Conformidad
kPa	in H_2O	in H_2O	in H_2O	in H_2O	in H_2O	in H_2O	
0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	cumple
3,981	16	15,97	0,03	0,48	0,02	0,40	cumple
7,963	32	32,21	-0,21	0,69	0,12	0,50	cumple
11,944	48	48,59	-0,59	0,97	0,07	0,63	cumple
15,926	64	64,63	-0,63	0,29	0,14	0,34	cumple
19,907	80	80,50	-0,50	0,63	0,10	0,47	cumple
23,889	96	96,38	-0,38	0,22	0,04	0,32	cumple
27,870	112	112,15	-0,15	0,65	0,02	0,47	cumple
31,852	128	128,51	-0,51	0,20	0,05	0,31	cumple
35,833	144	144,17	-0,17	0,13	0,07	0,30	cumple
39,814	160	161,28	-1,28	0,00	0,17	0,31	cumple

Representación gráfica

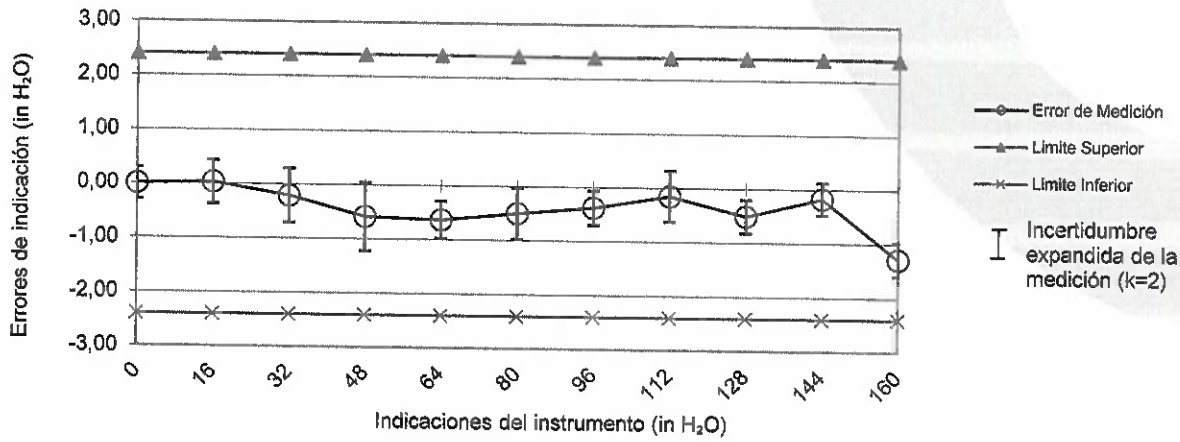

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.