SISMECA
LABORATORIO C.A.

INFORME DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

informe Nº LP-2603-603

Fecha de Calibración / Emisión:	18 de marzo de 2026
Solicitante:	**SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Dirección del Solicitante:	Av. 3h entre calles 68 y 70 Edif. Macame piso pb of 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia zona postal 4002
Número de cotización:	03-001
Fecha de Recepción de Ítem:	2026-marzo-06
Objeto de Calibración:	**MÓDULO DE PRESIÓN**
Código del Instrumento:	SF-MED-029
Marca:	FLUKE
Serial / Identificación:	6269278
Modelo / Tipo:	750P30
Ubicación del Instrumento:	Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración:	Presión.
Rango del Equipo:	0,0 psi a 5 000,0 psi
Error Máximo Permitido:	± 0,045 % FS
Resolución:	0,1 psi
Clase:	N/A
Lugar de Calibración:	Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A., ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia
Procedimiento de Calibración:	Los Resultados y la calibración son realizados conforme al CEM (2019) "Procedimiento ME-003 para la calibración de Manómetros, Vacuómetros y Manovacuómetros". Calibración realizada por el método de comparación directa con un patrón. Modo de visualización a través de Calibrador de Proceso, modelo 743B, marca FLUKE. Conforme a la EURAMET (2019) "Directrices para la calibración de manómetros mecánicos y electromecánicos". Guía de calibración No. 17 Versión 4.0". **Fluido Utilizado:** Alcohol **Medio generador de presión:** Bomba hidraulica, Codigo SI-LM-P15

Condiciones ambientales: (Durante la calibración)			
	Temp. Inicial: 20,6 °C	Temp. Final: 20,1 °C	Variación: 0,5 °C
	Hum. Inicial: 51 %HR	Hum. Final: 50 %HR	Variación: 1 %HR

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este informe cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este informe de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD
SISMECA
LABORATORIO, C.A.
DOCUMENTO ORIGINAL

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

SISMECA
LABORATORIO C.A.

INFORME DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

informe Nº LP-2603-603

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	informe	Ente Emisor
MANÓMETRO PATRÓN	KELLER	LEO RECORD	9312 / SI-LM-P01	MET-LP-CC 11181	Metrolabor
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celsius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:


Requisito	Conforme	Observaciones
Estado de la carcasa y cable de conexión	Si	Sin observaciones


B. Resultados de la calibración: (en unidades del equipo)

Datos técnicos del Instrumento:

Rango de trabajo: 0,0 psi a 4 500,0 psi **Resolución:** 0,1 psi **Error máximo permitido:** ± 0,045 % FS **Código:** SF-MED-029

Medida en el instrumento	Medida en el patrón		Corrección de Calibración (Cc)		Incertidumbre Expandida U=kUc (K=2)	Criterio de Cumplimiento Cumple = (Cc + Uc) ≤ EMP	UNIDADES DEL SI				
	Media del ciclo de subida	Media del ciclo de bajada	Ciclo de subida	Ciclo de bajada			Lectura Patrón (Lp)	Lectura Instrumento (LI)	(Cc) ciclo de subida	(Cc) ciclo de bajada	Incertidumbre Expandida
psi	psi	psi	psi	psi	psi		Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,540 0	Cumple	0,00000 0	0,00000 0	0,00000 0	0,00000 0	0,00372 3
500,0	500,17	500,17	0,17	0,17	0,540 8	Cumple	3,44864 9	3,44750 0	0,00114 9	0,00114 9	0,00372 9
1 000,0	1 000,13	1 000,13	0,13	0,13	0,540 3	Cumple	6,89591 9	6,89500 0	0,00091 9	0,00091 9	0,00372 6
2 000,0	2 000,10	2 000,17	0,10	0,17	0,540 3	Cumple	13,79091 9	13,79000 0	0,00068 9	0,00114 9	0,00372 6
3 000,0	3 000,10	3 000,13	0,10	0,13	0,540 2	Cumple	20,68580 4	20,68500 0	0,00068 9	0,00091 9	0,00372 5
4 500,0	4 500,10	4 500,20	0,10	0,20	0,540 4	Cumple	31,02853 4	31,02750 0	0,00069 0	0,00137 9	0,00372 6

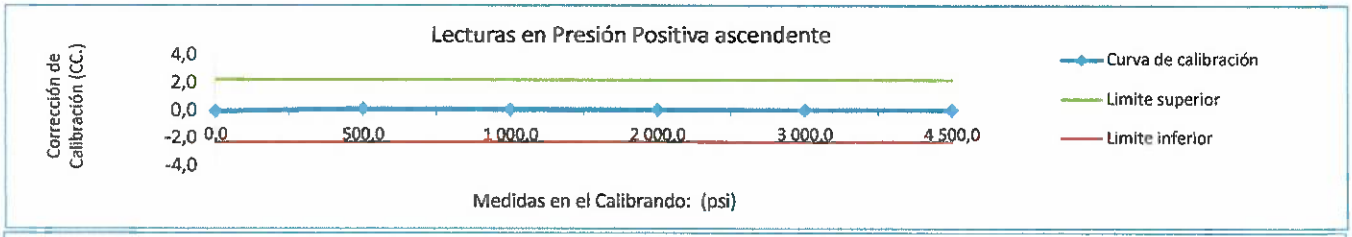

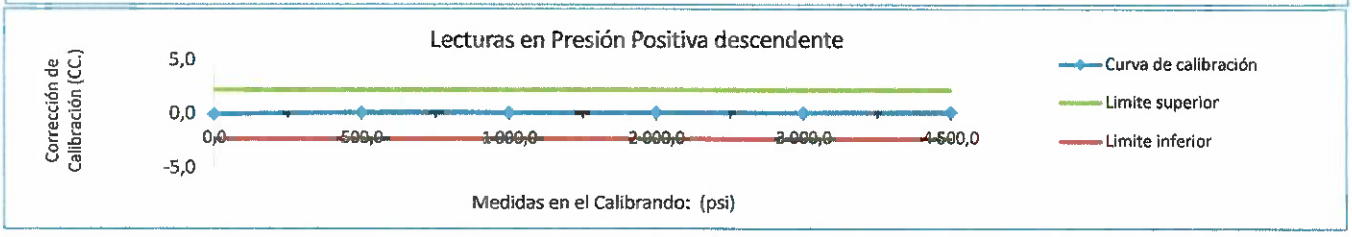

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si (Cc + Uc) ≤ EMP , caso contrario No Cumple, basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".

[3] Condición "Indefinido", Cuando la opción elegida no exceda un 0,1% del Intervalo de aceptación definido se plante la condición de "Indefinido", el usuario está en la potestad de la aceptación del criterio dependiendo del uso que de al instrumento; la exactitud o precisión según sea su requerimiento.

[4] Factor de Conversión: 1 psi = 0,006 895 Mpa

[5] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

Realizado por: Tec. Kristhian Rodriguez
Técnico de Laboratorio

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este informe