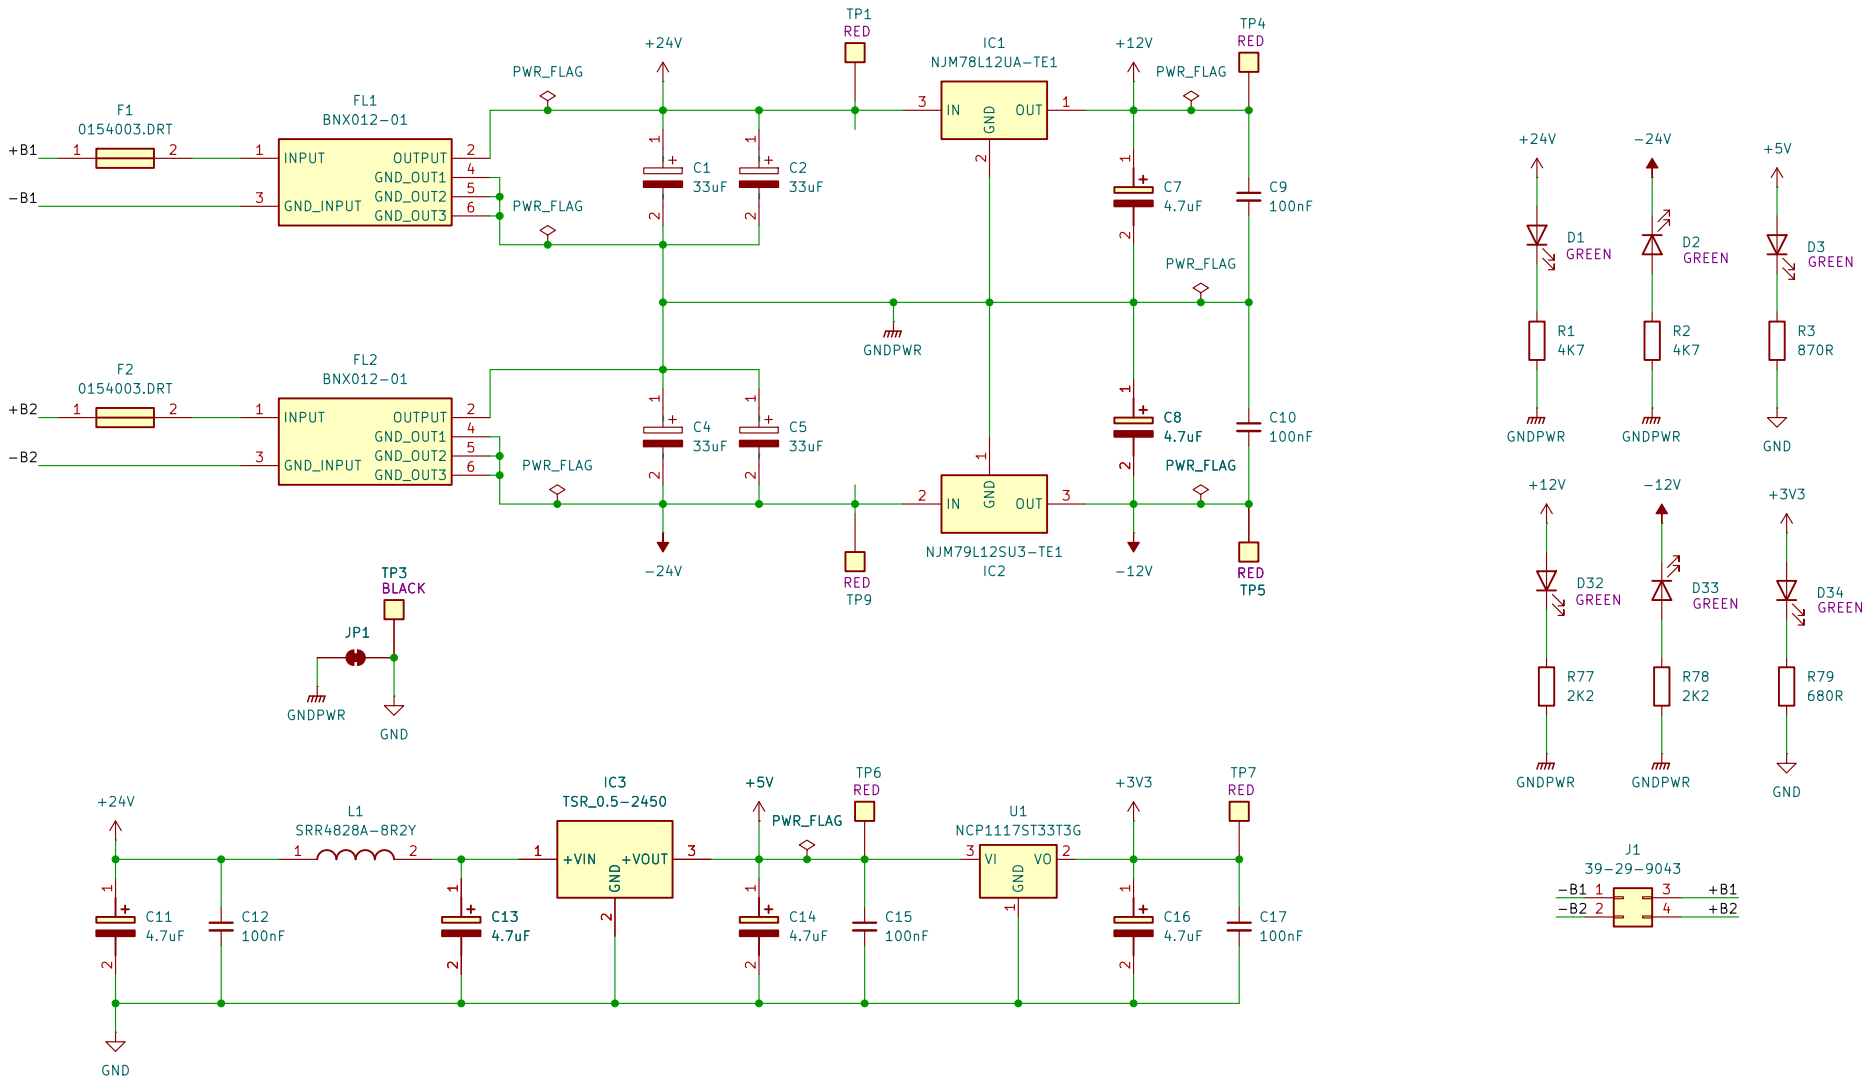



METALTRONICA	
Sheet: /POWER/	
File: power.kicad_sch	
Title: PCB/25-336-1	
Size: A4	Date: 2026-09-01
KiCad E.D.A. 10.0.5	Id: 1/8
	Rev:

METALTRONICA

Sheet: /Principale/
File: PCB336.kicad_sch

Title: PCB/25-336-1

Size: A4	Date: 2026-09-01	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/8

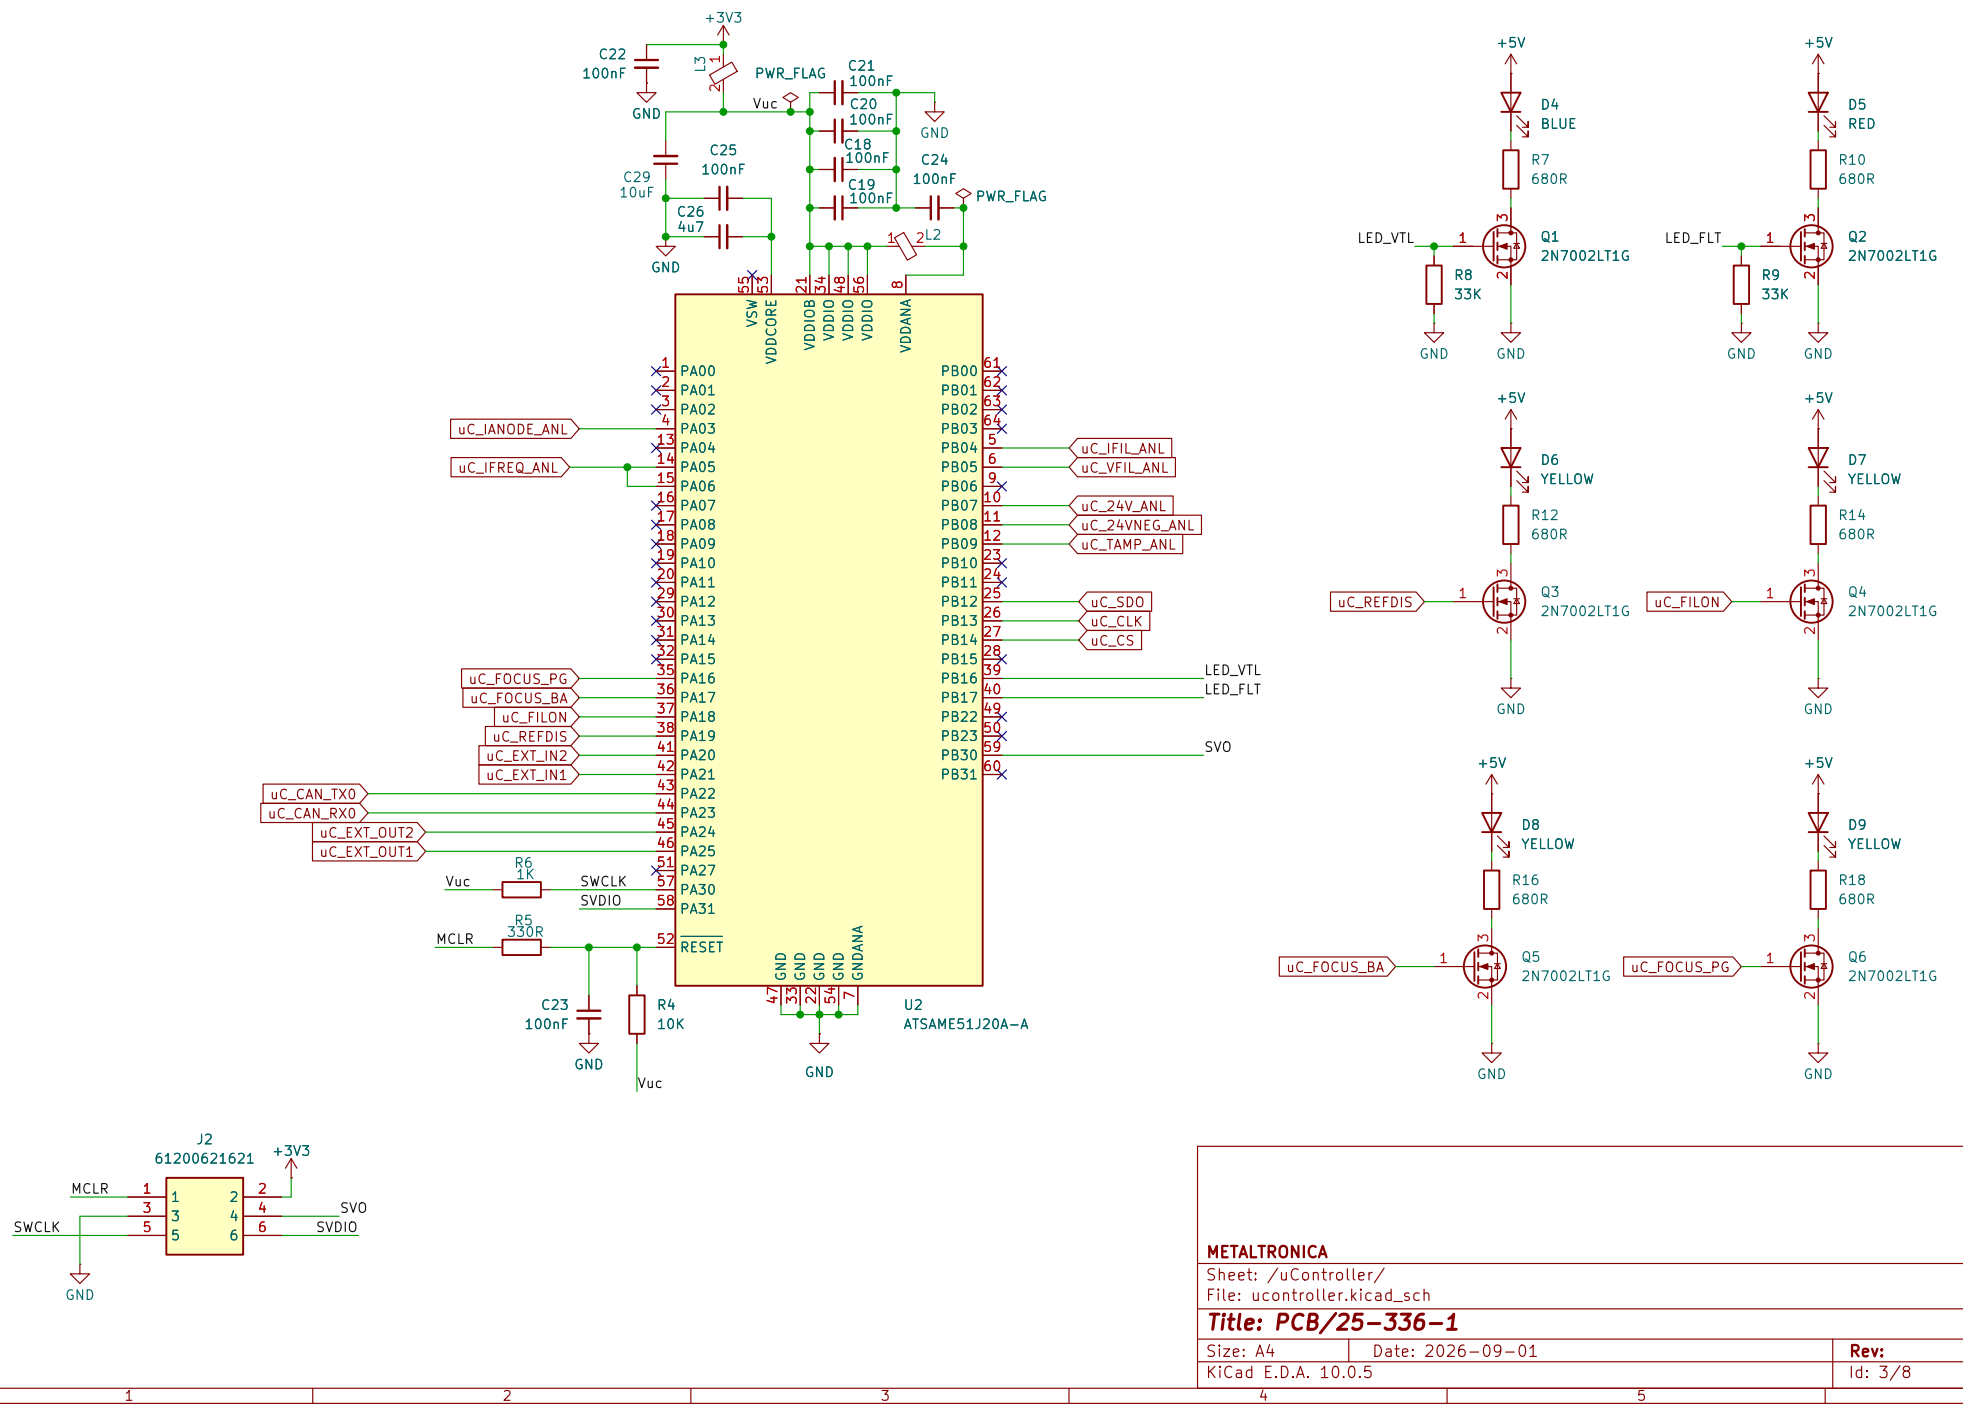


METALTRONICA


Sheet: /uController/
File: ucontroller.kicad_sch

Title: PCB/25-336-1


Size: A4	Date: 2026-09-01	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 3/8

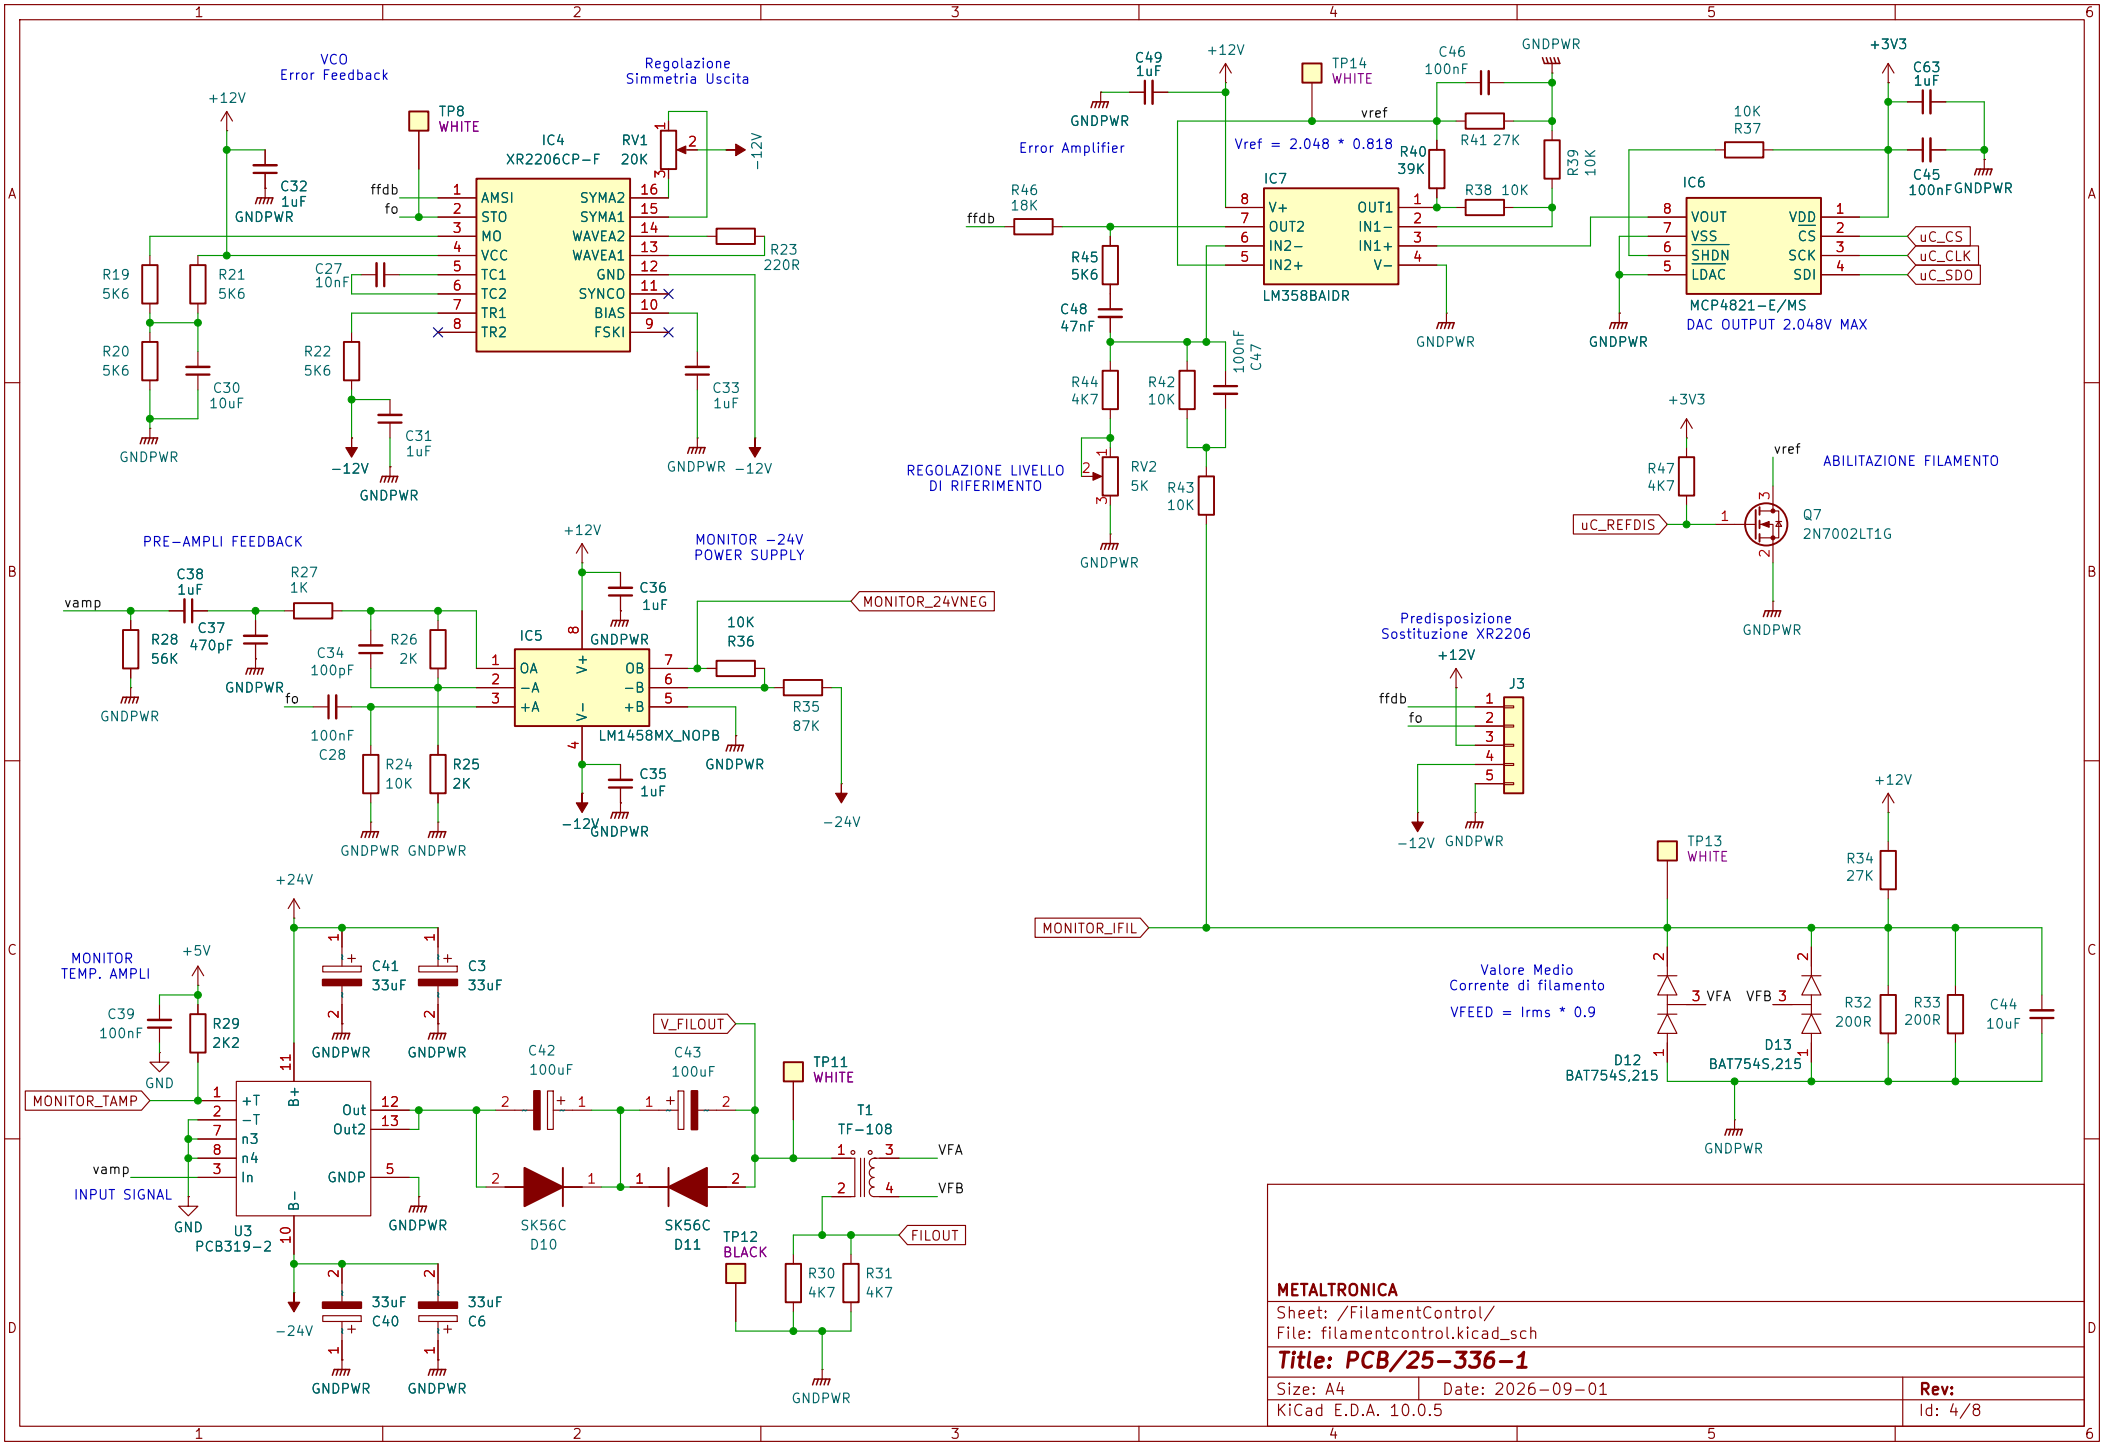
VCO
Error Feedback
Regolazione
Simmetria Uscita
IC4
XR2206CP-F
TP8
WHITE
RV1
20K
C32
1uF
GNDPWR
+12V
-12V
ffdb
fo
AMSI
STO
MO
VCC
TC1
TC2
TR1
TR2
SYMA2
SYMA1
WAVEA2
WAVEA1
GND
SYNCO
BIAS
FSKI
R19
5K6
R21
5K6
R20
5K6
C30
10uF
C27
10nF
R22
5K6
C31
1uF
R23
220R
C33
1uF
Error Amplifier
Vref = 2.048 * 0.818
IC7
LM358BAIDR
TP14
WHITE
C49
1uF
C46
100nF
R40
39K
R41 27K
R38 10K
R39
10K
vref
R46
18K
R45
5K6
C48
47nF
R44
4K7
R42
10K
C47
100nF
R43
10K
REGOLAZIONE LIVELLO
DI RIFERIMENTO
RV2
5K
IC6
MCP4821-E/MS
DAC OUTPUT 2.048V MAX
VOUT
VSS
SHDN
LDAC
VDD
CS
SCK
SDI
uC_CS
uC_CLK
uC_SDO
10K
R37
C63
1uF
C45
100nF
+3V3
ABILITAZIONE FILAMENTO
R47
4K7
uC_REFDIS
Q7
2N7002LT1G
PRE-AMPLI FEEDBACK
vamp
C38
1uF
C37
470pF
R27
1K
R28
56K
C34
100pF
R26
2K
C28
100nF
R24
10K
R25
2K
IC5
LM1458MX_NOPB
OA
-A
+A
V+
V-
OB
-B
+B
C36
1uF
C35
1uF
MONITOR -24V
POWER SUPPLY
MONITOR_24VNEG
10K
R36
R35
87K
-24V
Predisposizione
Sostituzione XR2206
J3
MONITOR_IFIL
MONITOR
TEMP. AMPLI
+5V
C39
100nF
R29
2K2
MONITOR_TAMP
vamp
INPUT SIGNAL
U3
PCB319-2
+T
-T
n3
n4
In
B+
B-
Out
Out2
GNDP
+24V
C41
33uF
C3
33uF
C42
100uF
C43
100uF
V_FILOUT
SK56C
D10
SK56C
D11
TP11
WHITE
T1
TF-108
VFA
VFB
FILOUT
TP12
BLACK
R30
4K7
R31
4K7
C40
33uF
C6
33uF
TP13
WHITE
R34
27K
Valore Medio
Corrente di filamento
VFEED = Irms * 0.9
D12
BAT754S,215
D13
BAT754S,215
R32
200R
R33
200R
C44
10uF
GNDPWR
METALTRONICA
Sheet: /FilamentControl/
File: filamentcontrol.kicad_sch
Title: PCB/25-336-1
Size: A4
Date: 2026-09-01
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 4/8


MONITOR TENSIONE −24VDC

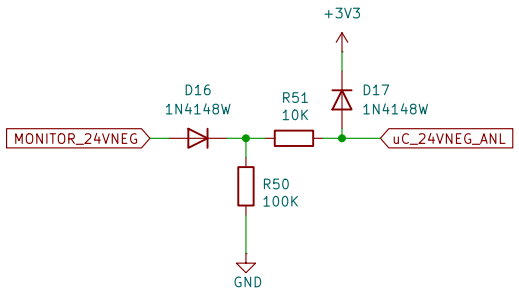


MONITOR TENSIONE +24VDC

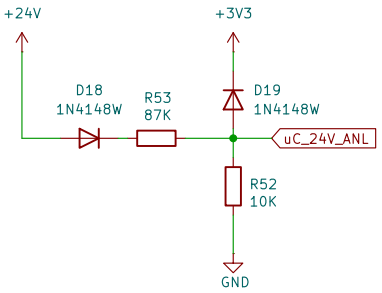


MONITOR CORRENTE DI FILAMENTO

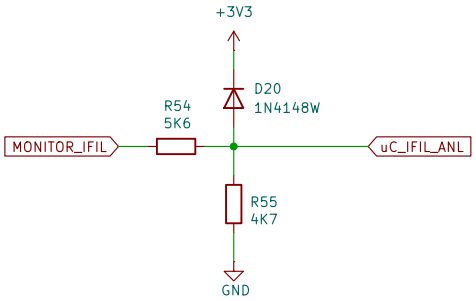


MONITOR TENSIONE DI FILAMENTO

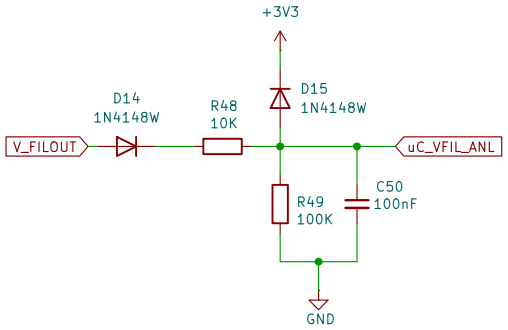

MONITOR FREQ. DI FILAMENTO

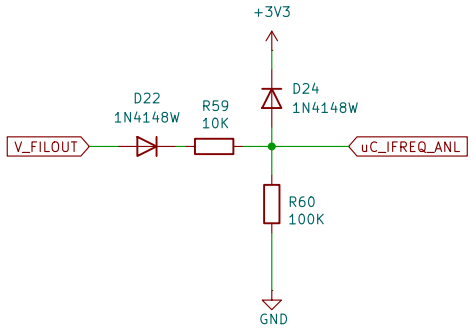

MONITOR TEMPERATURA AMPLIFICATORE

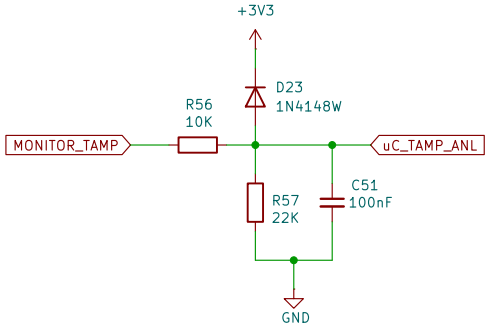


METALTRONICA

Sheet: /Monitor/
File: monitor.kicad_sch


Title: PCB/25-336-1

Size: A4	Date: 2026-09-01	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 5/8


ATTIVAZIONE FILAMENTO

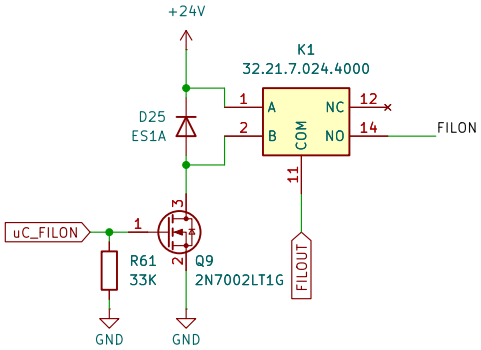


SELEZIONE GRUPPO FUOCHI (A–B)
EQUIVALENTE A Es. Gruppo W e Gruppo Mo

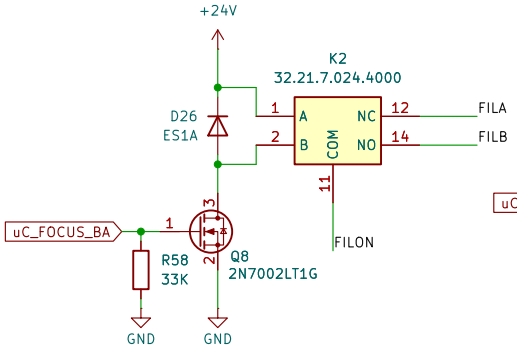


SELEZIONE FUOCO GRANDE/PICCOLO
GRUPPO A

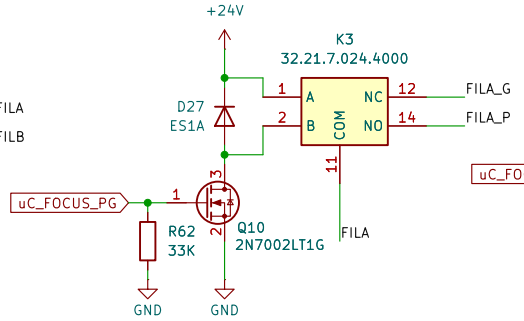


SELEZIONE FUOCO GRANDE/PICCOLO
GRUPPO B

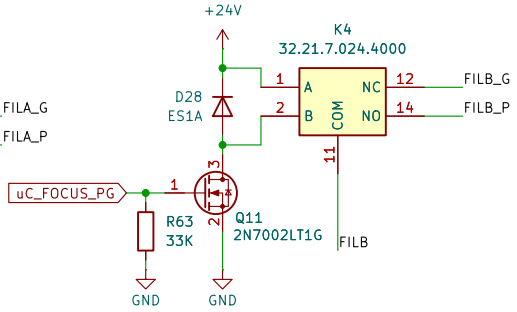


LETTURA ISOLATA DELLA CORRENTE ANODICA
ISOLAMENTO DI TIPO FUNZIONALE
ISO > 500V

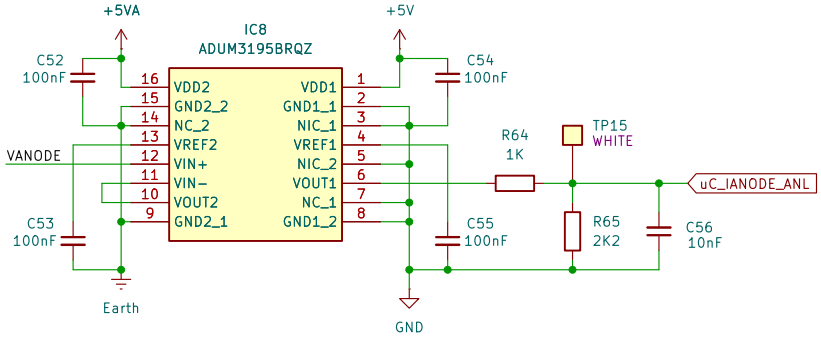

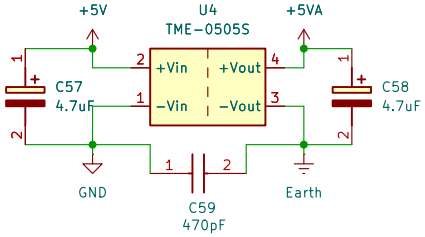

LETTURA CORRENTE ANODICA
CON CHIUSURA A TERRA

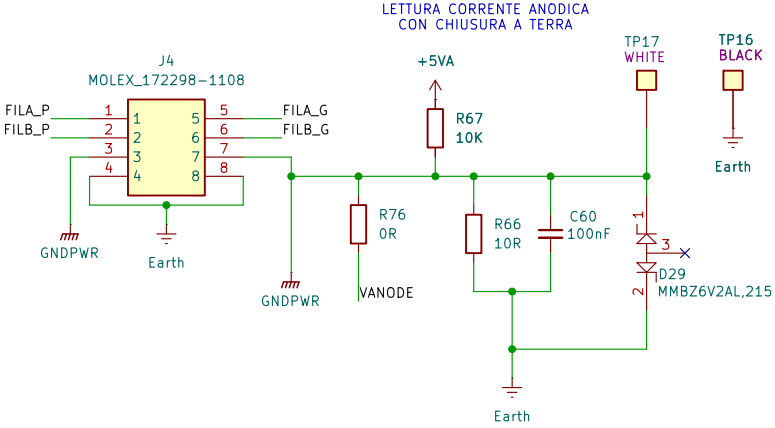


METALTRONICA


Sheet: /Load/
File: load.kicad_sch


Title: PCB/25–336–1


Size: A4	Date: 2026–09–01	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 6/8


1 MOOP ISOLAMENTO

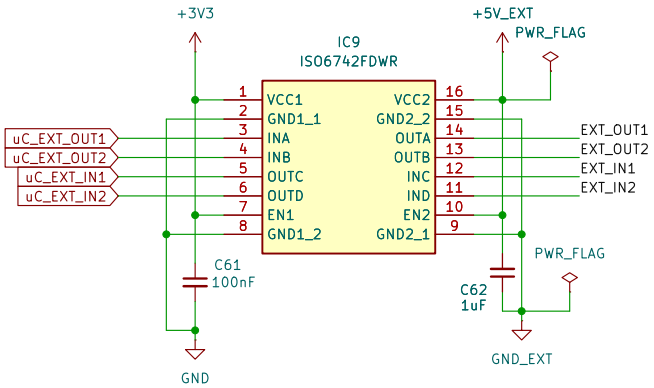

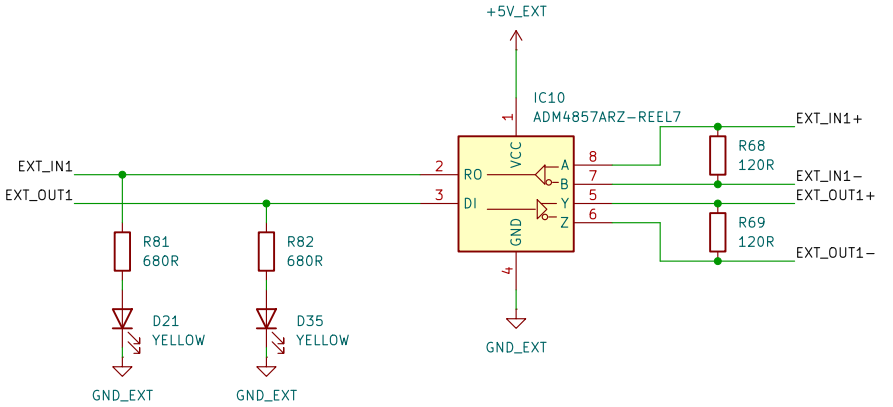


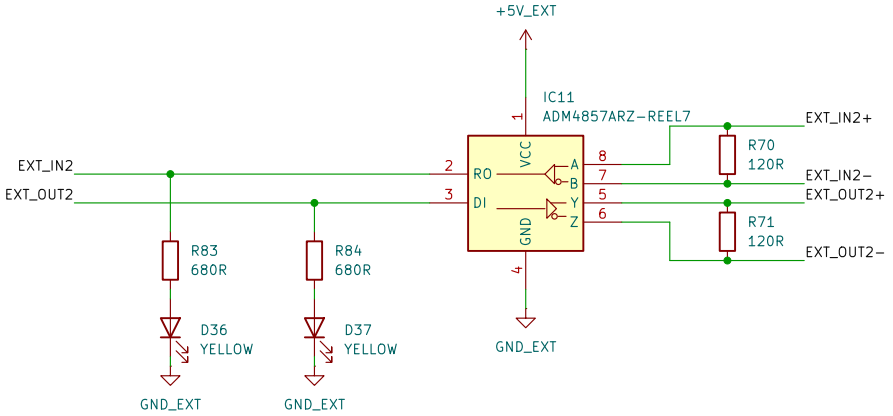


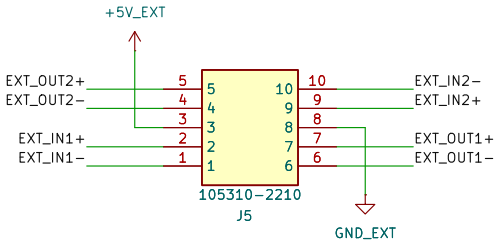


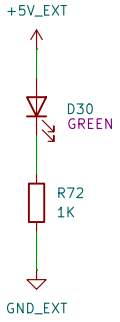

METALTRONICA		
Sheet: /ExternalSynch/		
File: externalsynch.kicad_sch		
Title: PCB/25-336-1		
Size: A4	Date: 2026-09-01	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 7/8

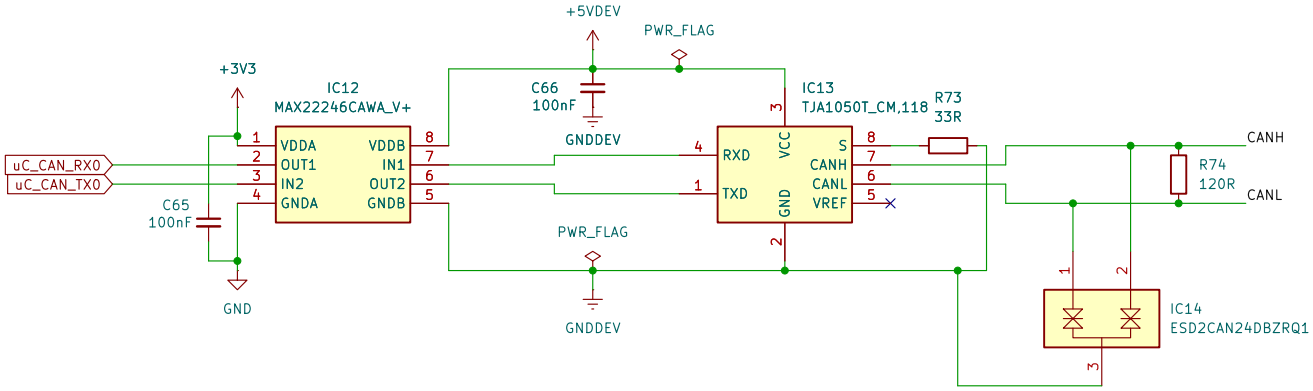

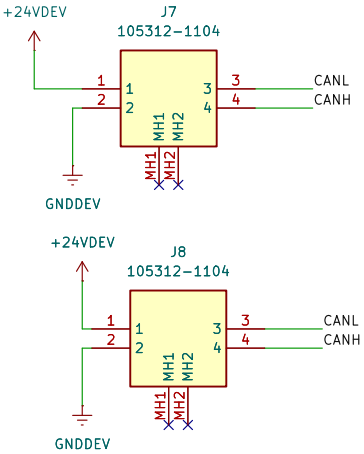

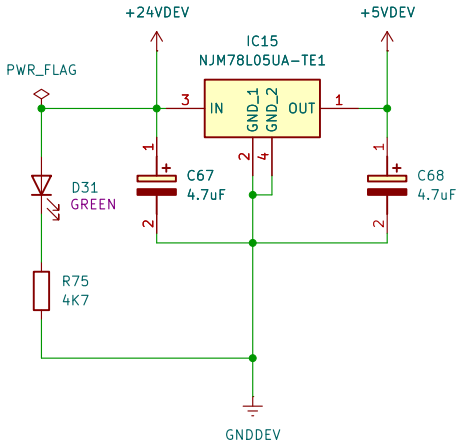

METALTRONICA		
Sheet: /CAN BUS/		
File: can_bus.kicad_sch		
Title: PCB/25-336-1		
Size: A4	Date: 2026-09-01	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 8/8