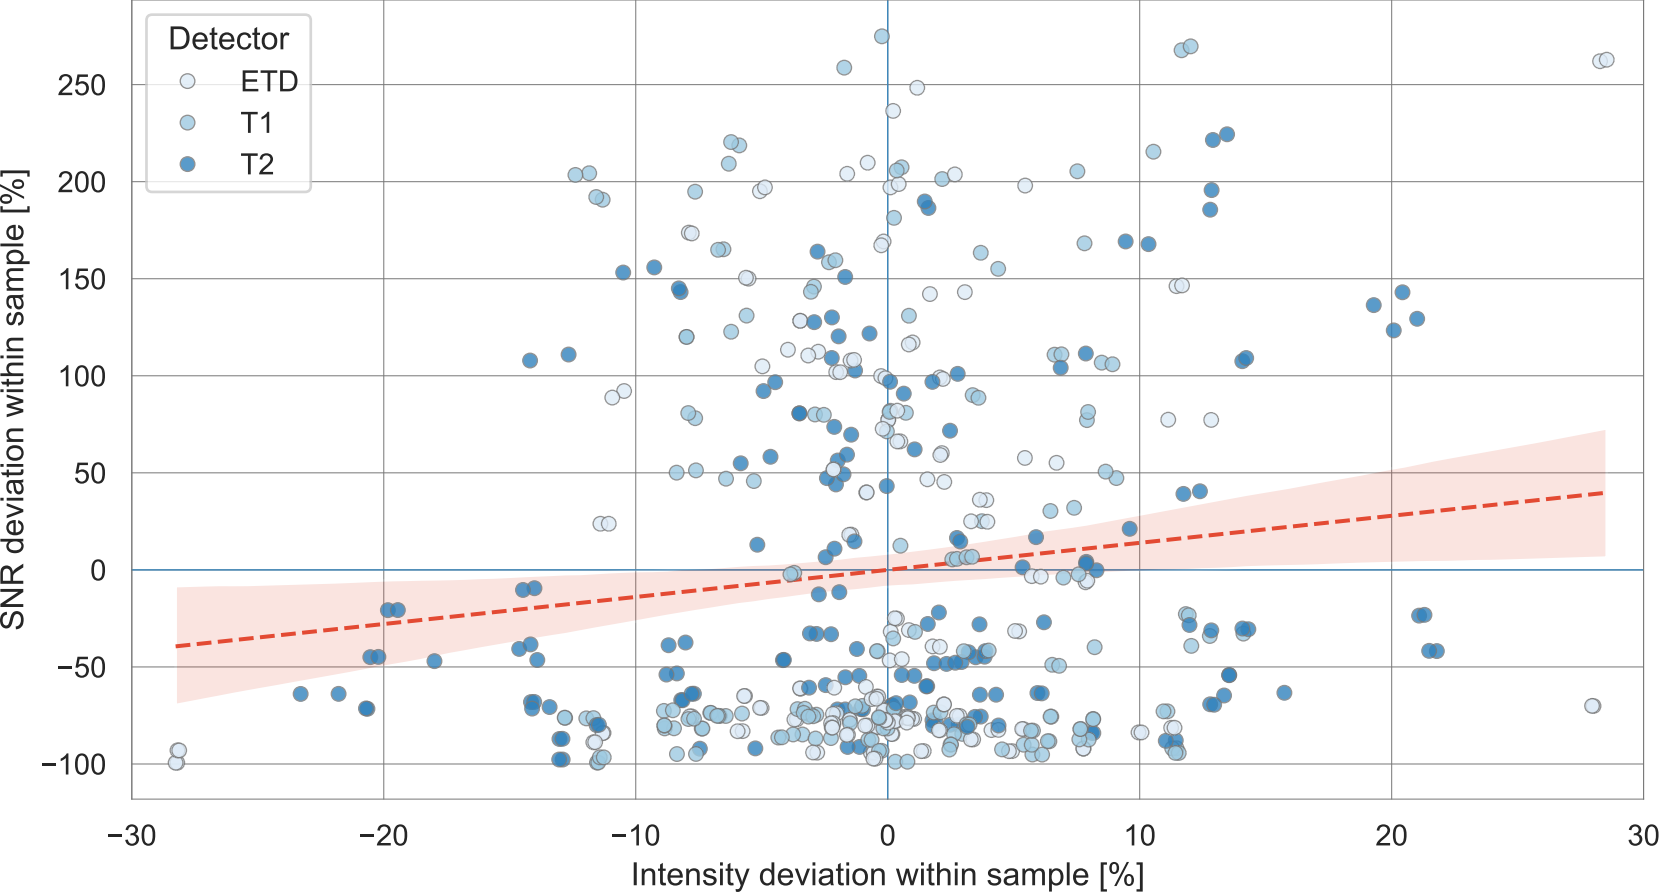
Detector
ETD
T1
T2
250
200
150
100
50
0
−50
−100
SNR deviation within sample [%]
−30
−20
−10
0
10
20
30
Intensity deviation within sample [%]