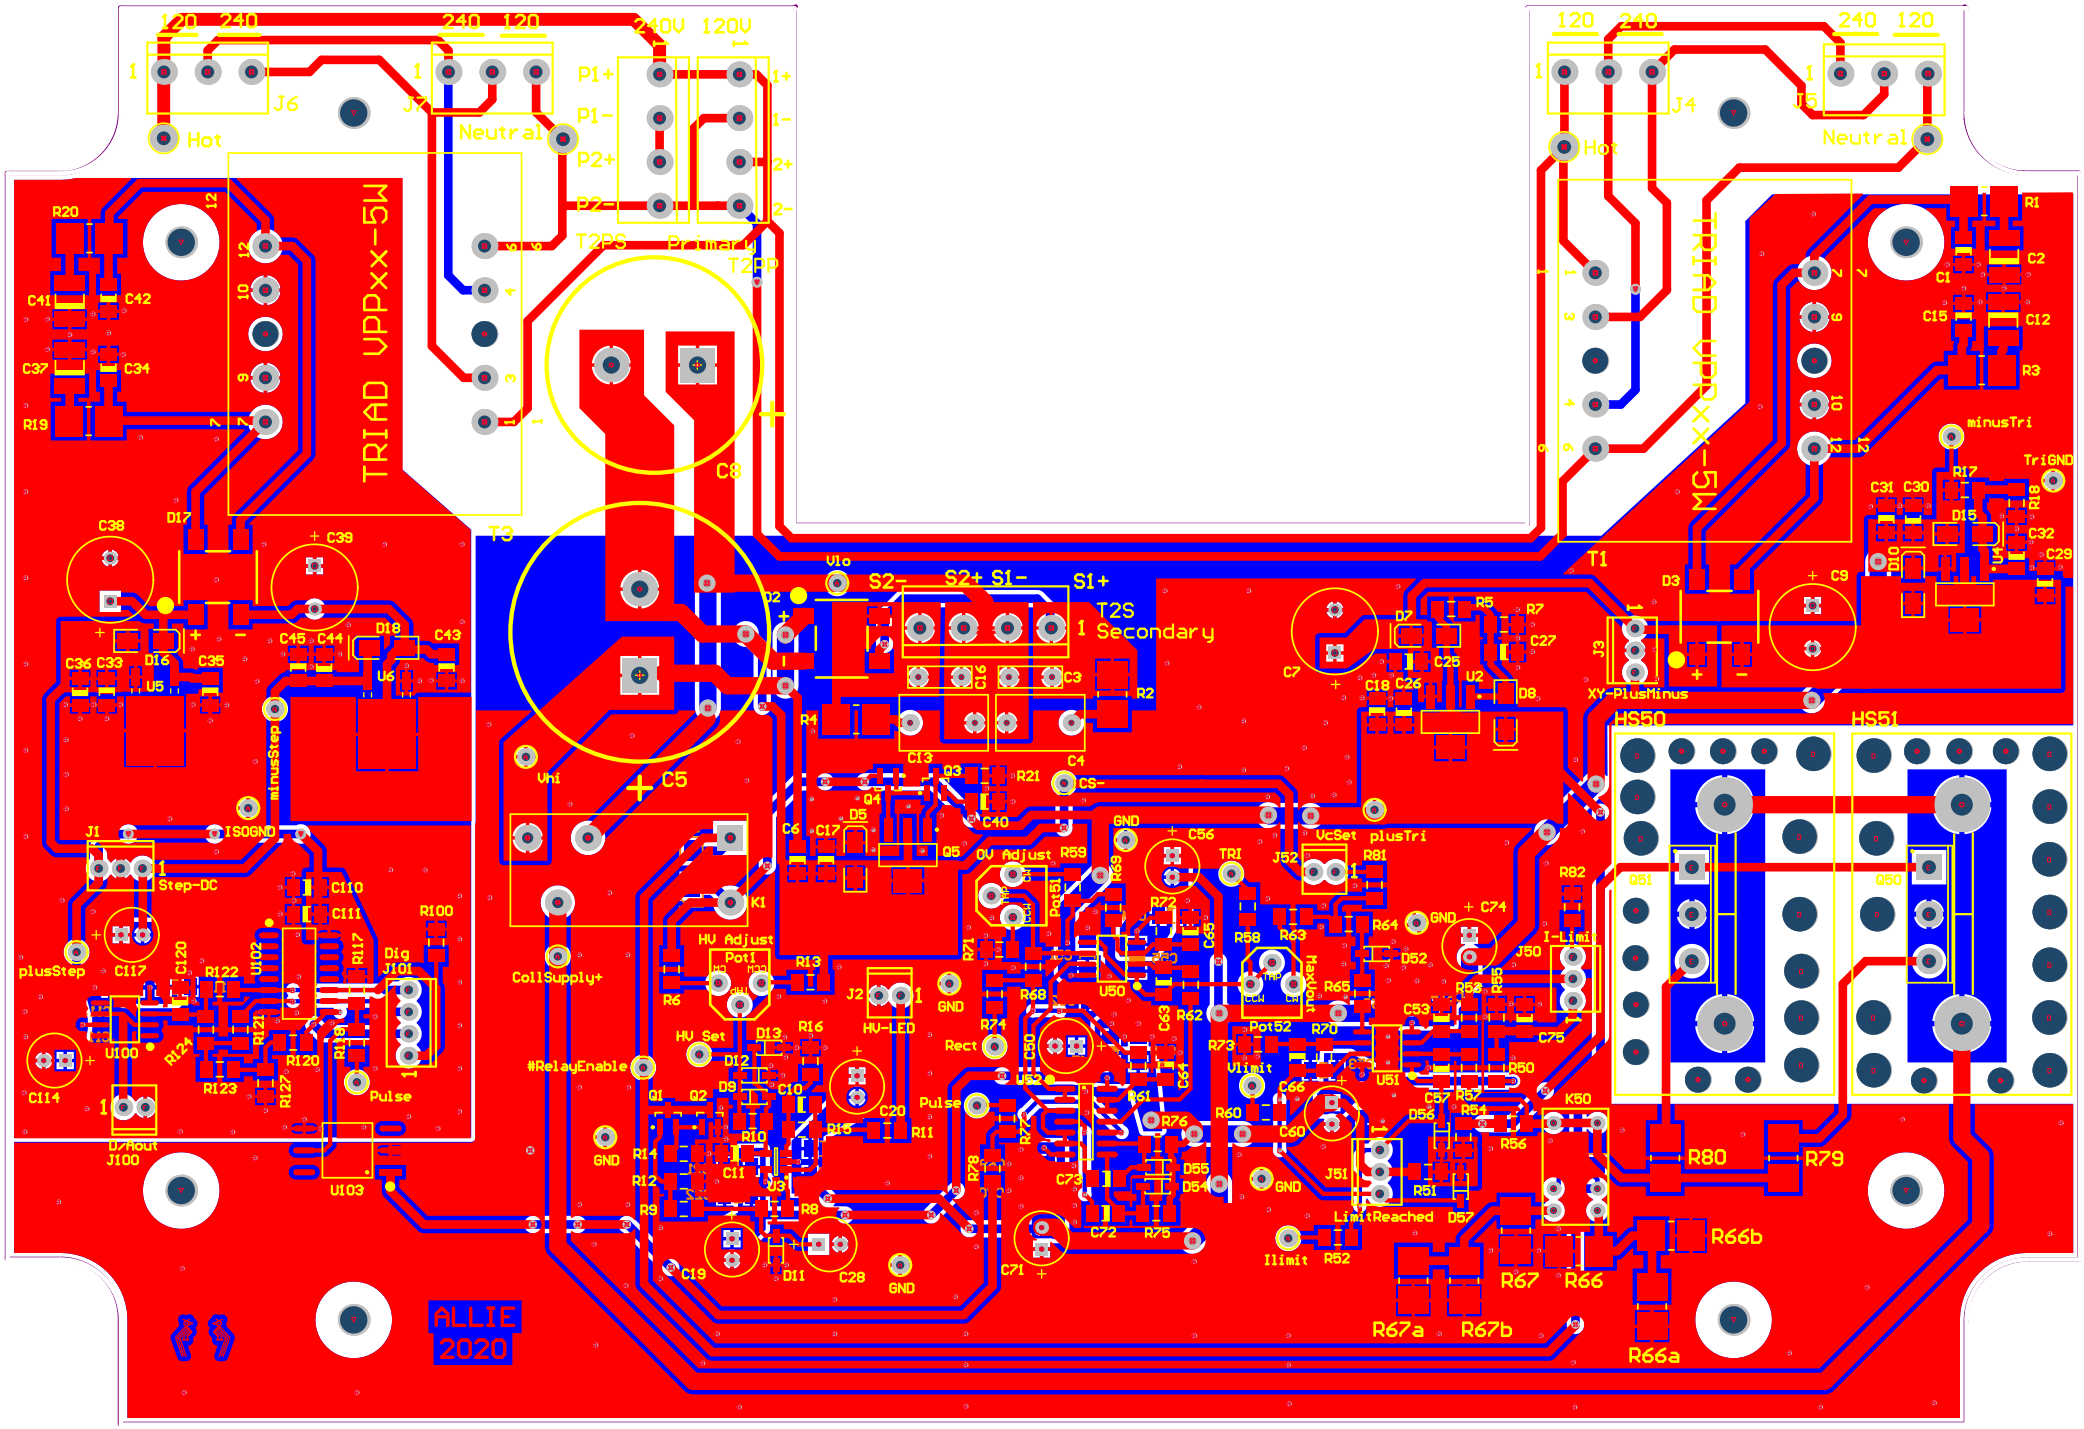
120 240
240 120
240V 120V
J6
J7
J4
J5
Hot
Neutral
P1+
P1-
P2+
P2-
T2PS
Primary
T2PP
TRIAD VPPxx-5W
TRIAD VPPxx-5W
T3
C8
T1
S2-
S2+
S1-
S1+
T2S
Secondary
C5
C9
C38
C39
D17
D18
C43
C45
C44
C36
C33
D16
C35
U5
U6
minusStep
ISOGND
J1
Step-DC
plusStep
C117
C114
U100
R122
R124
R123
R121
R120
R127
R126
U102
C110
C111
R117
R100
Dig
J101
Pulse
D/Hout
J100
U103
Vhi
Vlo
K1
CollSupply+
#RelayEnable
HV Adjust
Pot1
HV Set
HV-LED
J2
GND
Rect
Pulse
UV Adjust
Pot51
TRI
VcSet
plusTri
J52
Pot52
Maxlout
Vlimit
Ilimit
LimitReached
J51
I-Limit
J50
K50
XY-PlusMinus
J3
HS50
HS51
Q50
Q51
R80
R79
R66b
R67
R66
R67a
R67b
R66a
minusTri
TriGND
ALLIE
2020