


锅次报告

设备 3号灭菌器
锅次 7169
程序 P1
程序名称 WRAPP. GOODS 134

开始时间 2018/10/16 14:55:25
结束时间 2018/10/16 15:58:33
错误代码 0
报错信息

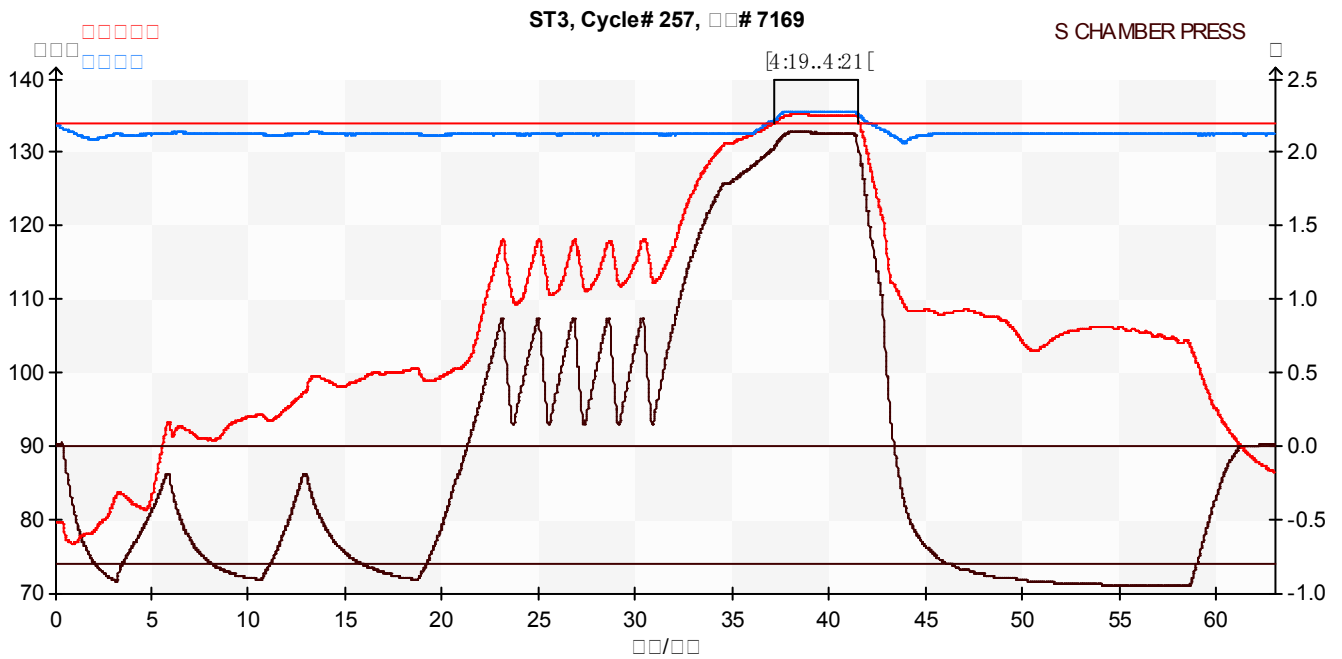

灭菌员签名 _____

锅次报告

S CHAMBER PRESS (巴)

排放口温度 (摄氏度)

夹套温度 (摄氏度)

巴 摄氏度 摄氏度

START

0:00:02 0.010 79.6 133.7

负脉冲

0:00:16 0.015 79.6 133.4

0:00:22 0.018 79.6 133.3

0:00:50 -0.349 76.7 132.7

0:02:00 -0.794 78.4 131.6

0:03:11 -0.921 83.2 132.5

0:03:16 -0.878 83.6 132.5

0:04:00 -0.685 82.3 132.3

0:04:37 -0.542 81.3 132.5

0:05:48 -0.190 92.9 132.5

0:05:49 -0.191 93.2 132.5

0:06:00 -0.282 91.6 132.6

0:08:00 -0.796 90.9 132.5

0:08:05 -0.804 90.7 132.5

0:10:00 -0.897 93.9 132.5

0:10:35 -0.910 94.4 132.5

0:12:00 -0.530 95.2 132.4

0:12:53 -0.188 97.3 132.5

0:14:00 -0.564 98.9 132.6

0:16:00 -0.815 99.4 132.5

0:18:00 -0.896 100.1 132.5

0:18:39 -0.911 100.5 132.5

0:20:00 -0.535 99.5 132.4

正脉冲

0:20:48 -0.188 100.5 132.6

0:22:00 0.319 107.3 132.5

0:23:04 0.861 117.9 132.5

0:23:09 0.851 118.1 132.5

0:23:38 0.147 109.9 132.5

0:23:48 0.207 109.3 132.5

0:24:00 0.337 109.6 132.5

0:24:56 0.862 117.6 132.5

0:25:00 0.859 118.1 132.5

0:25:30 0.149 110.9 132.6

0:25:34 0.154 110.6 132.6

0:26:00 0.431 111.4 132.5

0:26:46 0.862 117.7 132.5

0:26:49 0.860 118.1 132.6

0:27:19 0.149 111.6 132.5

0:27:22 0.153 111.2 132.5

0:28:00 0.550 113.2 132.5

0:28:34 0.861 117.7 132.5

0:28:37 0.859 118.0 132.5

0:29:06 0.149 111.9 132.5

0:29:11 0.158 111.7 132.6

0:30:00 0.685 115.0 132.5

0:30:20 0.863 117.8 132.5

0:30:24 0.859 118.1 132.6

加热

0:30:52 0.147 112.3 132.5

0:30:52 0.146 112.6 132.6

0:30:55 0.161 112.2 132.6

0:32:00 0.851 117.5 132.5

0:34:00 1.655 129.4 132.6

0:36:00 1.905 132.4 132.5

灭菌

0:37:14 2.054 134.1 134.5

0:38:00 2.137 135.1 135.5

0:38:02 2.138 135.2 135.6

0:38:08 2.142 135.2 135.6

0:40:00 2.129 135.1 135.5

灭菌后处理

0:41:16 2.124 135.0 135.5

干燥

0:41:22 2.117 135.0 135.4

0:42:00 1.594 129.1 134.0

0:44:00 -0.440 108.6 131.5

0:46:00 -0.797 108.0 132.5

0:48:00 -0.876 107.7 132.5

0:50:00 -0.914 104.1 132.5

0:50:25 -0.921 103.0 132.5

0:52:00 -0.936 105.2 132.5

0:53:38 -0.945 106.2 132.5

0:54:00 -0.945 106.1 132.5

0:56:00 -0.951 105.5 132.5

0:58:00 -0.955 104.2 132.5

平衡

0:58:24 -0.956 104.3 132.5

0:58:36 -0.956 104.0 132.5

1:00:00 -0.339 94.9 132.5

程序结束

1:01:21 0.000 89.6 132.5

1:02:00 0.000 88.0 132.5

1:02:58 0.009 86.5 132.5