


鍋次報告

设备	3号灭菌器
锅次	7176
程序	P1
程序名称	WRAPP. GOODS 134

开始时间	2018/10/16 16:16:01
结束时间	2018/10/16 17:02:23
错误代码	0
报错信息	

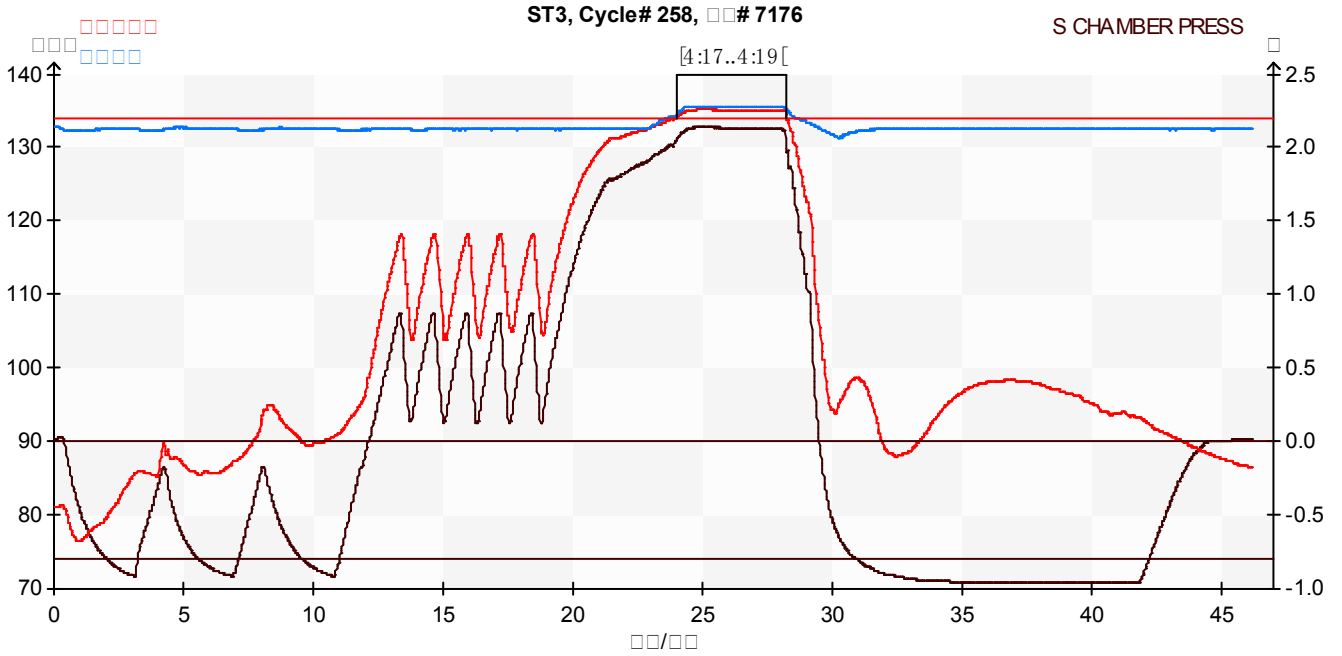

灭菌员签名 _____

锅次报告

S CHAMBER PRESS (巴)

排放口温度 (摄氏度)

夹套温度 (摄氏度)

巴 摄氏度 摄氏度

START

0:00:02 0.010 81.1 132.9

负脉冲

0:00:17 0.021 81.2 132.6

0:00:20 0.023 81.2 132.5

0:00:56 -0.412 76.4 132.2

0:02:00 -0.795 79.3 132.6

0:03:09 -0.921 85.7 132.5

0:04:00 -0.335 85.1 132.4

0:04:14 -0.180 89.8 132.4

0:05:35 -0.802 85.4 132.6

0:06:00 -0.859 85.7 132.5

0:06:53 -0.920 86.8 132.5

0:08:00 -0.221 92.1 132.4

0:08:05 -0.178 93.5 132.5

0:08:21 -0.341 94.9 132.6

0:09:42 -0.822 89.5 132.5

0:10:00 -0.860 89.5 132.5

0:10:48 -0.921 90.6 132.5

正脉冲

0:11:52 -0.178 95.2 132.4

0:12:00 -0.123 95.8 132.5

0:13:21 0.870 117.6 132.5

0:13:24 0.865 118.1 132.6

0:13:45 0.134 105.2 132.5

0:13:47 0.143 103.7 132.5

0:14:00 0.319 106.4 132.4

0:14:38 0.868 117.5 132.5

0:14:41 0.865 118.1 132.5

0:15:01 0.124 105.6 132.5

0:15:08 0.141 103.7 132.6

0:15:55 0.871 117.6 132.5

0:16:00 0.851 118.2 132.5

0:16:00 0.851 118.2 132.5

0:16:19 0.122 105.3 132.6

0:16:25 0.155 104.0 132.5

0:17:11 0.871 117.9 132.5

0:17:15 0.864 118.2 132.6

0:17:34 0.121 106.0 132.6

0:17:40 0.151 104.8 132.6

0:18:00 0.520 110.6 132.5

0:18:25 0.868 117.5 132.6

0:18:28 0.863 118.1 132.5

加热

0:18:48 0.114 106.3 132.6

0:18:51 0.128 104.5 132.6

0:18:53 0.171 104.4 132.5

0:20:00 1.167 122.3 132.5

0:22:00 1.820 131.4 132.5

0:24:00 2.050 134.0 134.4

灭菌

0:24:02 2.063 134.2 134.4

0:24:48 2.135 135.2 135.5

0:24:55 2.142 135.2 135.6

0:26:00 2.130 135.1 135.5

0:28:00 2.122 135.0 135.5

灭菌后处理

0:28:03 2.125 135.0 135.5

干燥

0:28:07 2.119 135.0 135.4

0:30:00 -0.523 94.4 131.7

0:30:08 -0.587 93.7 131.5

0:30:54 -0.796 98.5 132.1

0:32:00 -0.905 89.3 132.5

0:32:27 -0.920 87.9 132.5

0:34:00 -0.956 92.9 132.5

0:36:00 -0.965 98.0 132.5

0:36:05 -0.966 98.1 132.5

0:36:40 -0.966 98.3 132.5

0:38:00 -0.965 97.7 132.5

0:40:00 -0.961 95.0 132.5

平衡

0:41:53 -0.961 93.2 132.6

0:42:00 -0.916 92.8 132.5

0:44:00 -0.088 89.1 132.5

程序结束

0:44:38 0.000 88.1 132.5

0:46:00 0.009 86.6 132.5

0:46:13 0.009 86.4 132.5