
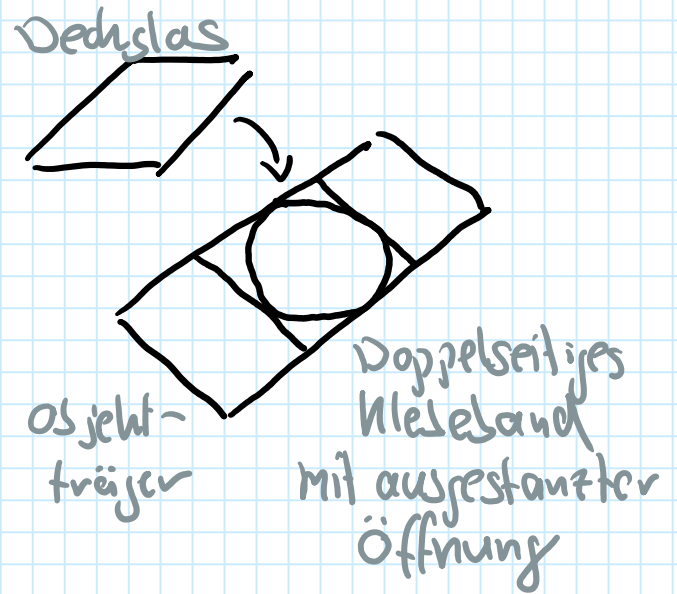


Messprotokoll 223

Marius Pfeiffer
Robert Grosch

10.12.2024

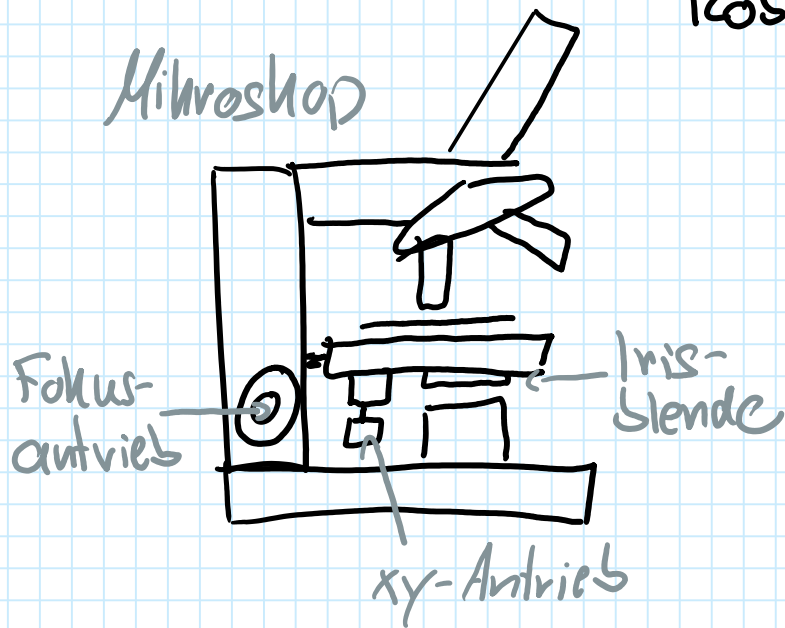

Durchmesser Teilchen: $(755 \pm 30) \text{ nm}$ Fehlerangabe auf Flasche
Zimmertemperatur: $(22.2 \pm 0.1) ^\circ \text{C}$ Skalenfehler
Kalibrationsmaßstab: $0.09434 \mu\text{m} / \text{px}$

Bräunle

