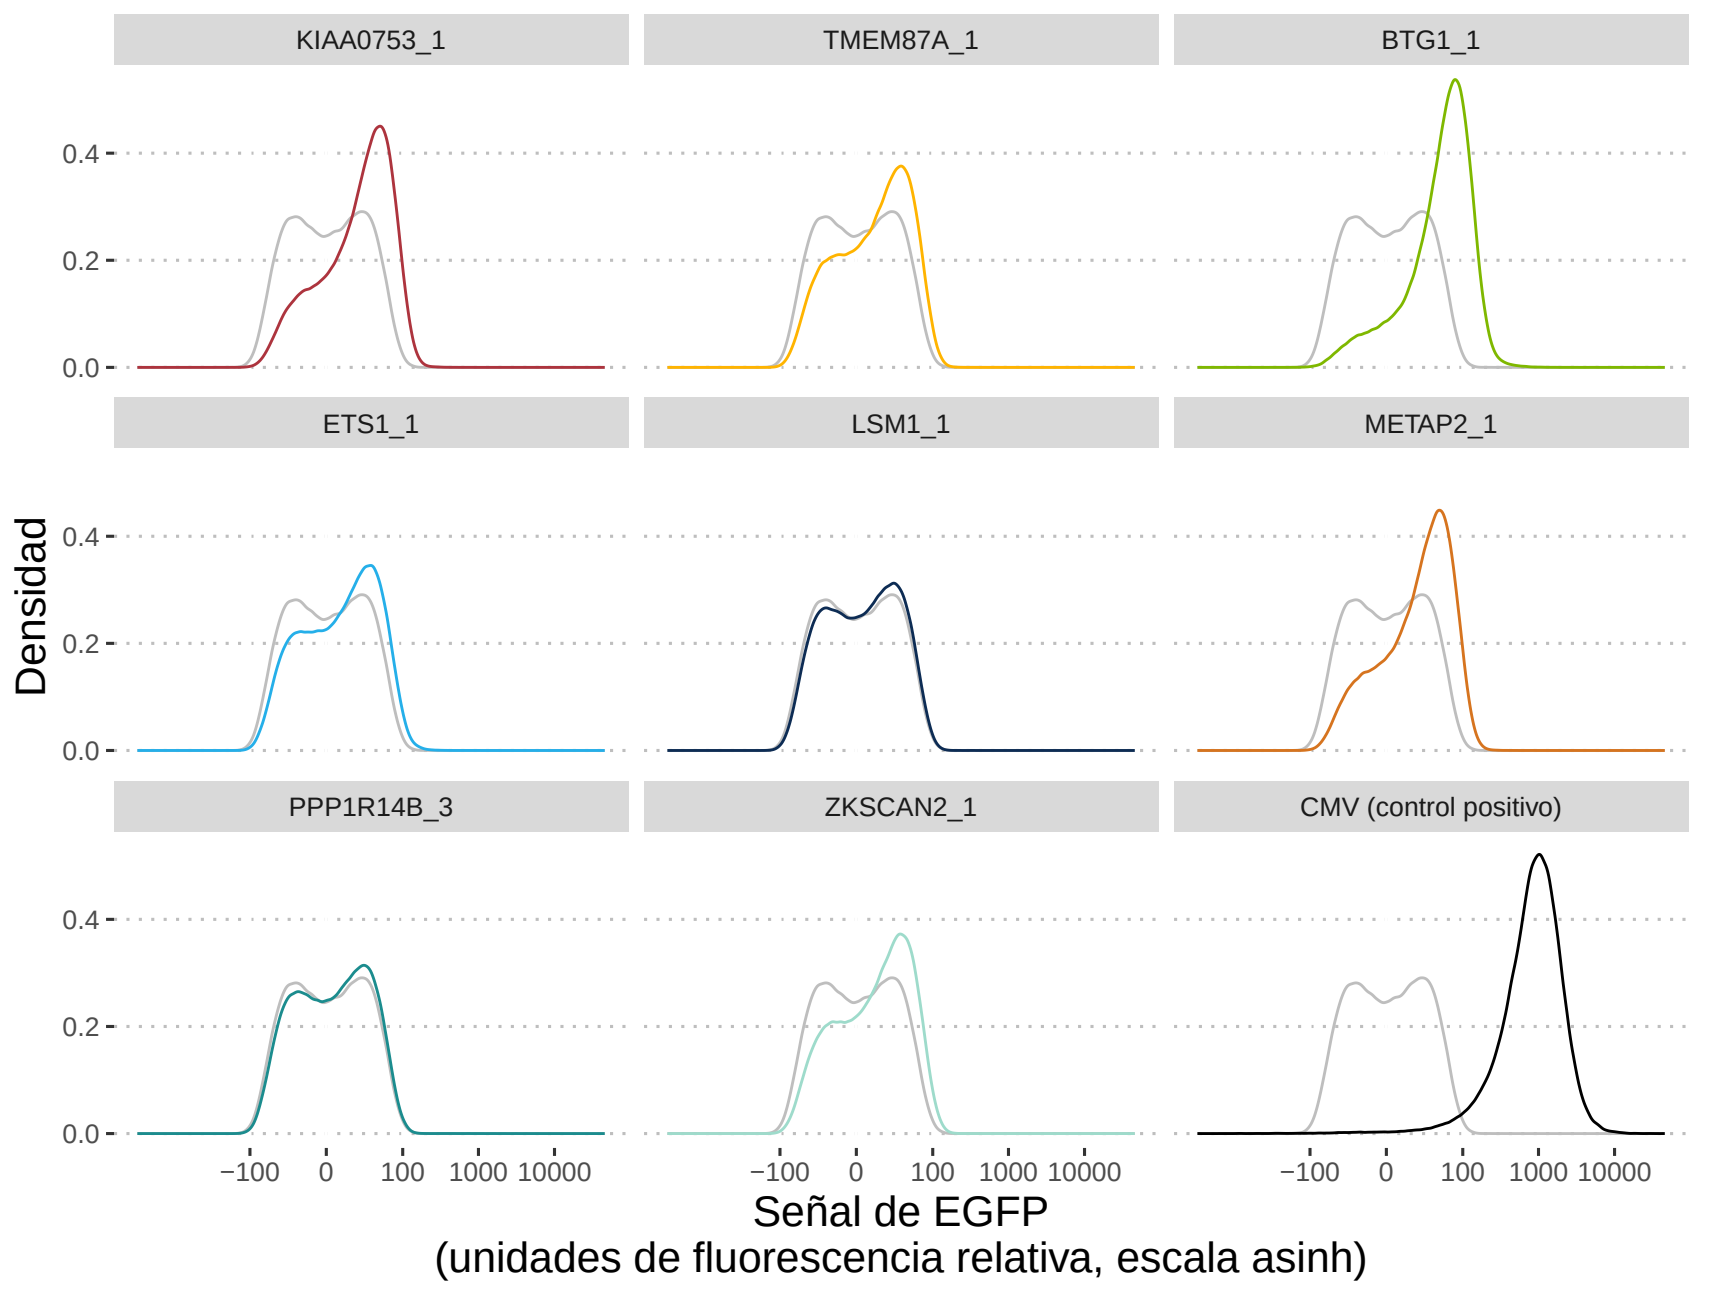
KIAA0753_1
TMEM87A_1
BTG1_1
ETS1_1
LSM1_1
METAP2_1
PPP1R14B_3
ZKSCAN2_1
CMV (control positivo)
Densidad
0.0
0.2
0.4
−100
0
100
1000
10000
Señal de EGFP
(unidades de fluorescencia relativa, escala asinh)