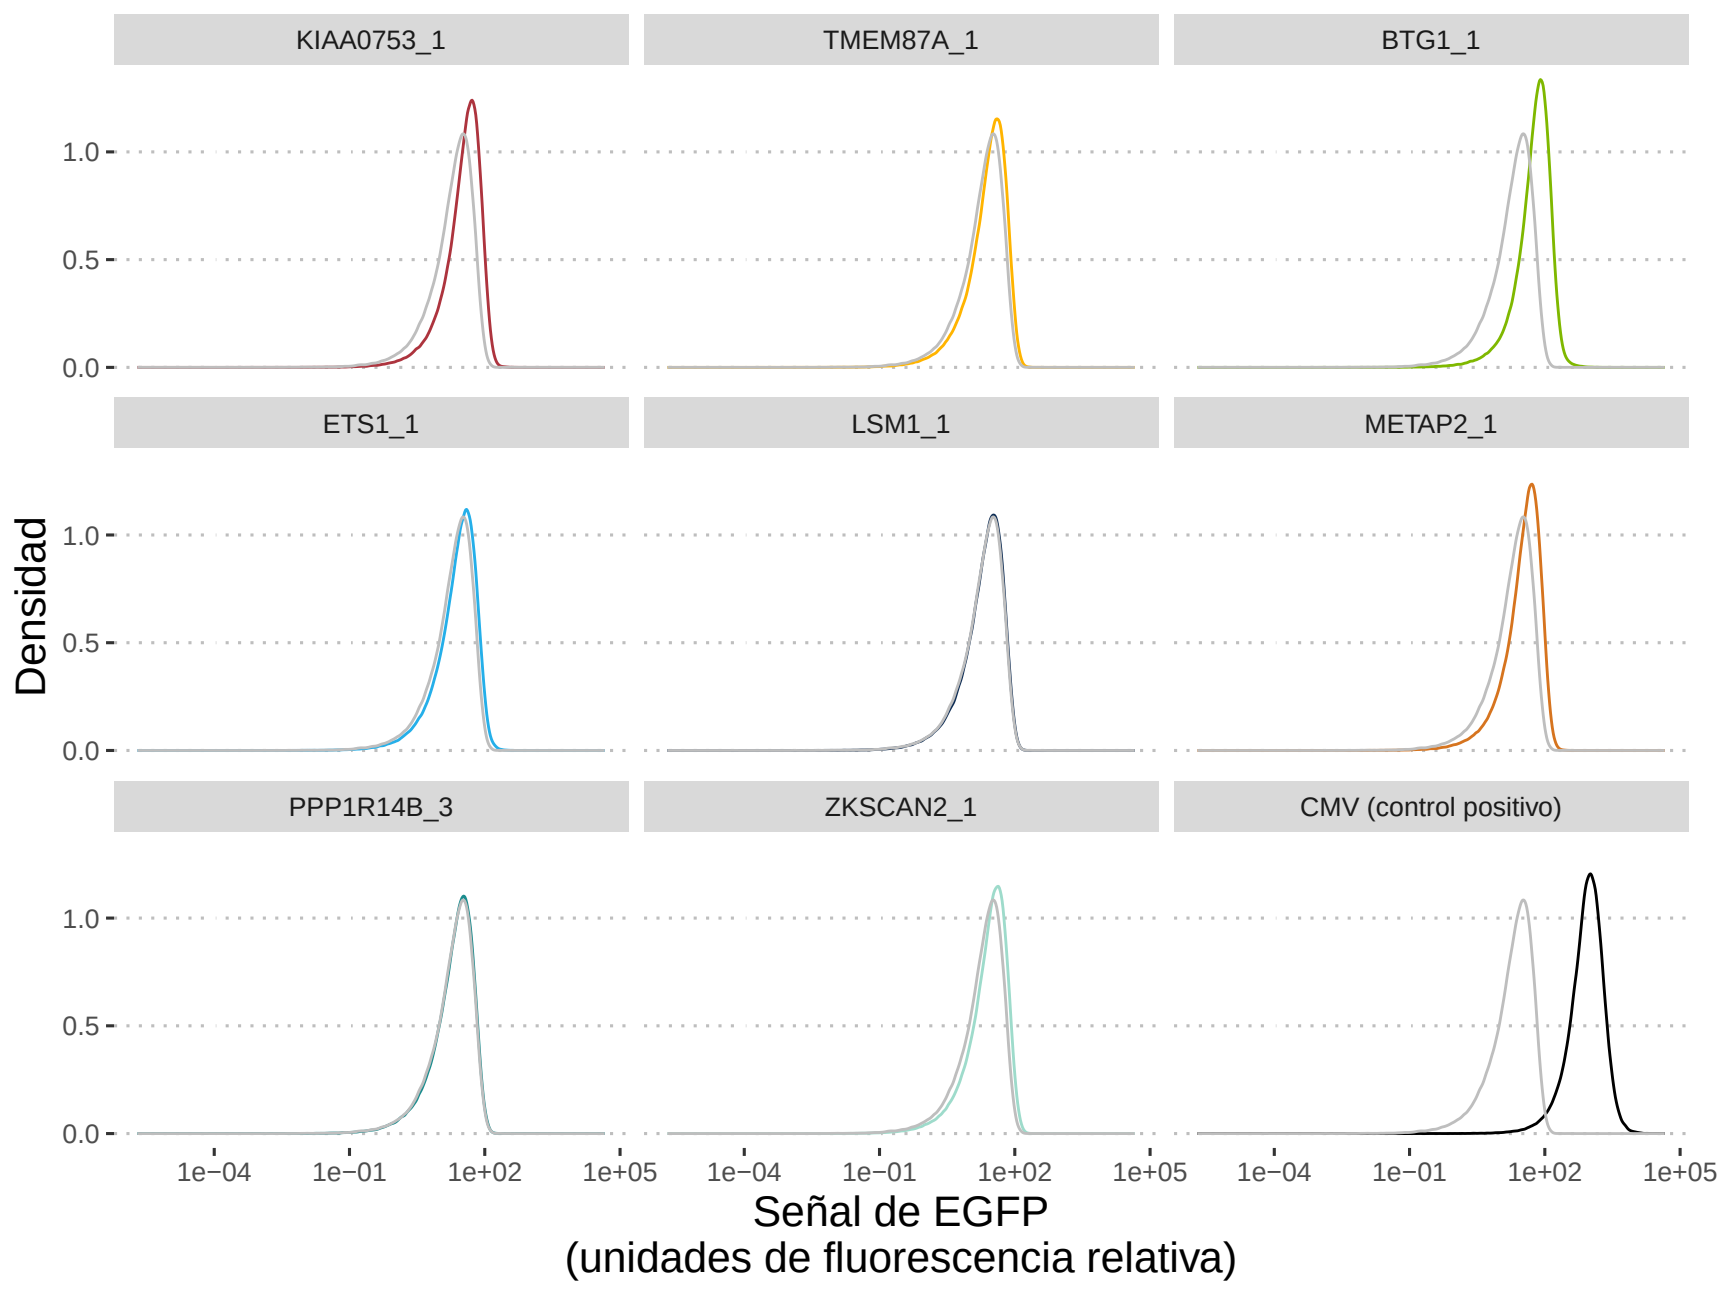
KIAA0753_1
TMEM87A_1
BTG1_1
ETS1_1
LSM1_1
METAP2_1
PPP1R14B_3
ZKSCAN2_1
CMV (control positivo)
Densidad
1.0
0.5
0.0
1e−04
1e−01
1e+02
1e+05
Señal de EGFP
(unidades de fluorescencia relativa)