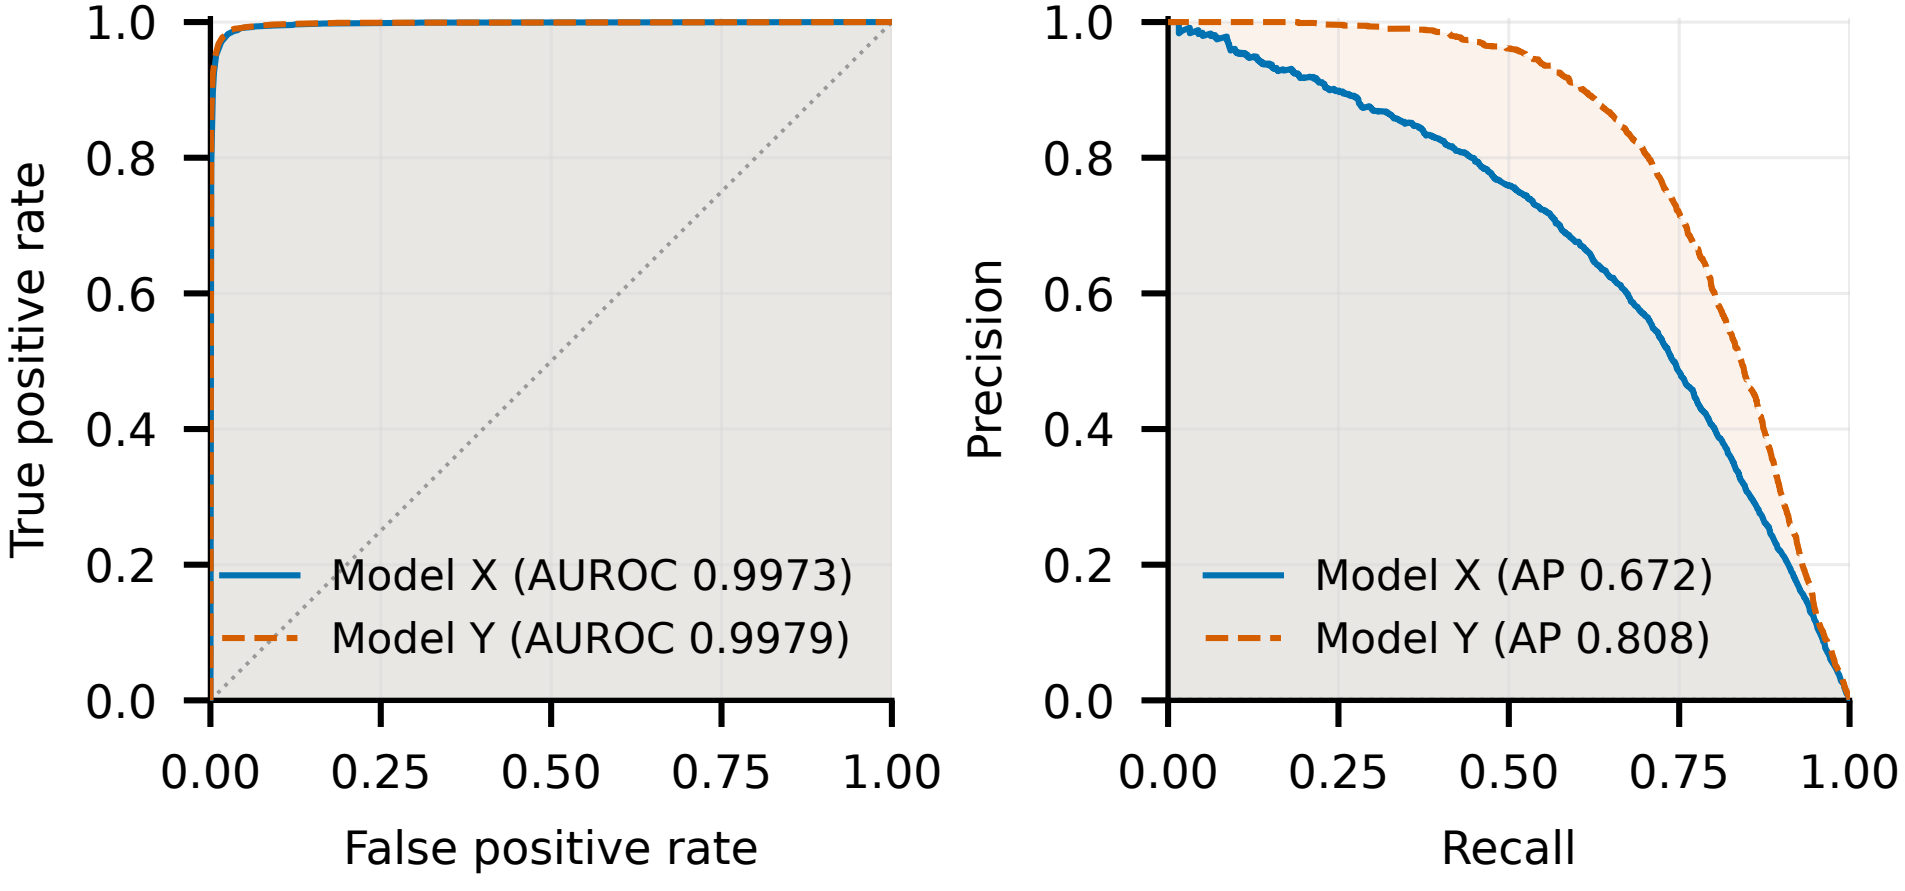

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
True positive rate
Model X (AUROC 0.9973)
Model Y (AUROC 0.9979)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
False positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Precision
Model X (AP 0.672)
Model Y (AP 0.808)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Recall