

# Pipeline de microscopía pticográfica de Fourier multiespectral asistido por agentes

Resumen del trabajo, septiembre de 2026. Lucas Costilla. Repositorio [reproducible-research-template](#).

## 1. El objetivo y dónde quedamos

Un microscopio no distingue detalles más chicos que cierto límite, que depende de la apertura numérica (NA) del objetivo y del color de la luz. Con nuestro objetivo de NA 0,07, ese límite es de unos 3,8  $\mu\text{m}$  en luz verde <sup>1</sup>.

La **microscopía pticográfica de Fourier (FPM)** busca superarlo sin cambiar el objetivo. Una matriz de LEDs ilumina la muestra desde muchos ángulos, uno por foto, y un programa combina las fotos en una imagen de mayor resolución. De paso recupera la **fase**, es decir, cuánto se retrasa la luz al atravesar la muestra, algo que ninguna foto registra.


El proyecto se proponía tres cosas: (1) reconstruir con FPM cada color; (2) combinar los tres colores (rojo 630 nm, verde 530 nm, azul 470 nm) en una reconstrucción **multiespectral**; y (3) que **agentes de IA** asistan tanto dentro del pipeline (decidir, controlar la calidad, reportar) como en su desarrollo.

| pieza                                        | estado                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FPM por color, en simulación                 | <b>logrado</b>                                                                                           |
| FPM por color, con datos reales              | <b>parcial</b> : se recupera la fase, pero no hay evidencia de ganancia de resolución                    |
| Combinación multiespectral, en simulación    | <b>parcial</b> : funciona en el caso para el que fue diseñada, no en general                             |
| Combinación multiespectral, con datos reales | <b>no logrado</b> : primera comparación real el 28/09; el detalle reconstruido no coincide entre colores |
| Agentes dentro del pipeline                  | <b>construidos y probados en simulación</b> ; con datos reales su juicio no fue confiable                |
| Agentes en el desarrollo                     | <b>logrado</b> : encontraron los errores que invalidaban los resultados reales                           |


## 2. El montaje y las capturas

El montaje tiene una matriz de LEDs RGB con paso de 6 mm a unos 74 mm de la muestra, un objetivo 2,5x de NA 0,07 y una cámara de 12 bits con píxel de 3,2  $\mu\text{m}$  (1,28  $\mu\text{m}$  en la muestra). Se usan  $13 \times 13 = 169$  LEDs, uno por foto y por color. La muestra son partículas de unos 5  $\mu\text{m}$  (tamaño nominal; en la práctica, de tamaños variados) en DMSO.

| captura    | qué tenía                                                                                           | para qué sirvió                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2025 | RGB, objetivo 2x NA 0,10                                                                            | primeras reconstrucciones, incluida una multiespectral; ahí aparecieron los errores de la sección 4 |
| 08/07/2026 | RGB, 1 ms para todos los LEDs                                                                       | muy poca luz: solo 12 de 182 LEDs llegaban al 10 % del brillo del más brillante <sup>2</sup>        |
| 24/09/2026 | RGB, 1/10/100 ms por LED, fotos a oscuras                                                           | <b>receta nueva de exposición</b> : 131 de 169 LEDs con señal/ruido mayor que 3 <sup>3</sup>        |
| 25/09/2026 | solo rojo, dos zonas (sets 1 y 3), fotos a oscuras y <b>sin muestra</b> (flats)                     | la reconstrucción real más confiable (set 3) y el diagnóstico de por qué falla (set 1)              |
| 28/09/2026 | RGB del <b>mismo campo</b> , foco fijo en verde, flats (oscuros saturados: se usaron los del 25/09) | la primera comparación multiespectral real (sección 5)                                              |

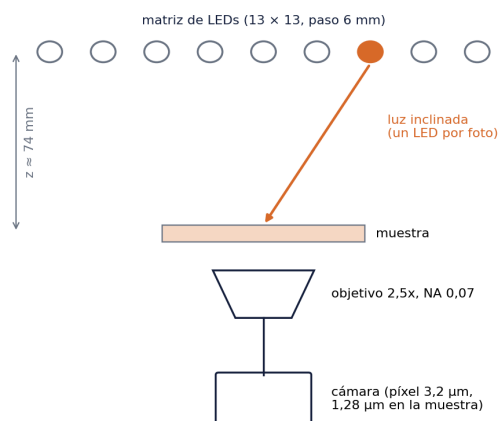

Esquema del montaje con los valores de la captura del 25/09.

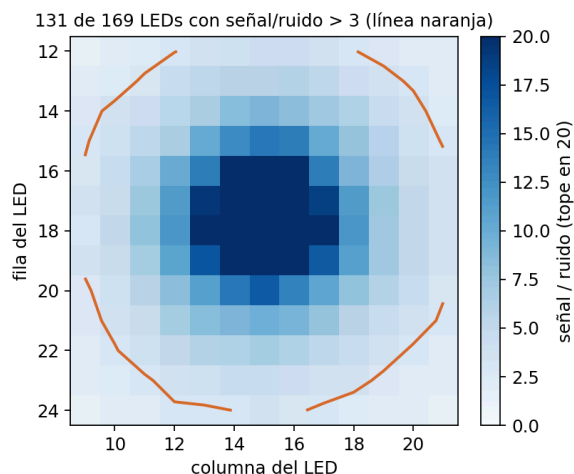

Señal útil por LED en la captura del 24/09 (verde, 100 ms). El centro es luz directa (campo claro); los bordes son ángulos grandes (campo oscuro), con poca señal pero con la información del detalle fino.

Desde las imágenes se puede medir dónde cae el eje óptico respecto de la matriz: en diciembre, el ajuste del brillo por LED dio fila 17,45 y columna 14,65<sup>4</sup>; en septiembre, el eje cae entre los LEDs (17,15) y (18,15). La altura  $z$ , en cambio, no se puede fijar desde las imágenes (sección 5); se usó la medida a mano, 74 mm.

### 3. La cadena multispectral, en simulación

El repositorio tiene un **simulador** del microscopio y un **programa de reconstrucción** por color (ePIE y Wirtinger flow). Además tiene una **cadena multispectral**: lleva los tres colores a una grilla común, los reconstruye y los acopla desenvolviendo la fase con una longitud de onda sintética. Después ajusta la dispersión del material (cómo cambia el índice de refracción con el color) para obtener el **espesor** de la muestra.

- **Un color, con la geometría real y sin ruido:** el brillo reconstruido coincide con la muestra inventada en 0,995 (1 = perfecto)<sup>5</sup> y la fase en 0,87<sup>6</sup>. Con la matriz a 100 mm, que da más solapamiento entre LEDs vecinos, la fase sube a 0,97<sup>7</sup>.
- **Tres colores acoplados:** en un objeto diseñado para necesitar el acople, el espesor recuperado correlaciona 0,88 con el verdadero<sup>8</sup>, y el error es 183 veces menor que sin acoplar<sup>9</sup>.
- **El límite:** un barrido con el solver real sobre la magnitud de la fase (roadmap, milestone 20) muestra que acoplar **empeora** cuando no hace falta desenvolver, y solo rescata en parte cuando sí hace falta. La cadena funciona, pero no mejora en general sobre reconstruir cada color por separado.

### 4. Los agentes

Dentro del pipeline (agents/) hay tres agentes, contruidos y probados en simulación. Los tres usan el propio Claude Code con respuestas de formato fijo:

- un **orquestador** que lee la convergencia de una reconstrucción y decide aceptar, reintentar con otro paso o declararla estancada;
- un agente de **control de calidad** que, sin la muestra verdadera, juzga si los tres colores son consistentes y si el resultado es confiable;
- un agente de **reporte**, que redacta cada hallazgo con sus números citados.

Con datos reales, el control de calidad (en modo de prueba, con una regla fija en vez del modelo) dio "confianza alta" a una reconstrucción de diciembre que en realidad estaba congelada. Los colores coincidían porque la fase casi no se había movido, no porque el acople funcionara. Sin buenas reconstrucciones, el juicio automático no distingue "bien" de "vacío".

En el desarrollo, los agentes trabajaron en tres modos:

- sesiones directas con una persona;
- agentes en paralelo para auditar;
- equipos con un **verificador** que rehace cada número con su propio código antes de aceptarlo.

Con eso aparecieron varios errores que daban resultados equivocados **sin avisar**:

| error                                                                                                                                                                                                                                 | consecuencia                                                                                                                          | cómo se encontró                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| El paso de corrección era ~8000 veces más chico de lo debido con imágenes reales <sup>10</sup>                                                                                                                                        | el programa devolvía casi la foto de partida: todo lo real anterior quedó invalidado, incluida la corrida multiespectral de diciembre | un agente que investigaba otra cosa; las pruebas usaban imágenes de 16–32 píxeles |
| La imagen de referencia (Zeiss, objetivo 2,5x, 2,344 $\mu\text{m}/\text{píxel}$ <sup>11</sup> ) tenía menos detalle que una foto cruda                                                                                                | no servía para validar ganancia de resolución                                                                                         | rastreando su origen                                                              |
| Fotos sin corregir por exposición; escala inicial equivocada; las corridas de diciembre suponían otro objetivo                                                                                                                        | reconstrucciones sesgadas; geometría equivocada                                                                                       | revisando datos; el objetivo, al confirmar el hardware                            |
| Código previo ( <code>ptyco-full-simulator</code> ): el gradiente caía en frecuencias corridas (error de adjunto 1,41; 0 es correcto) <sup>12</sup> , la pupila ocupaba toda la imagen y la orientación de los LEDs estaba traspuesta | esas reconstrucciones no reflejan la muestra                                                                                          | al adaptarlo a los datos del 25/09; confirmado por un verificador independiente   |

## 5. Datos reales, color por color

Antes de mirar cada reconstrucción real se fijaron **cuatro criterios**, con umbrales calibrados en una simulación de la misma captura:

1. predice las fotos de LEDs que no usó;
2. dos reconstrucciones independientes, cada una con la mitad de los LEDs, coinciden en el detalle más allá del límite del objetivo;
3. no aparecen patrones que no están en la muestra;
4. aparece detalle nuevo.

**Verde, 24/09.** Predice fotos no vistas, pero está dominada por un patrón en red que cambia con decisiones del programa. Más señal no alcanzó para sacarlo.

**Rojo, 25/09, set 3.** Es la primera reconstrucción real que se parece a la muestra: se ven las partículas y su fase, sin el patrón en red.

- **Criterio 1, pasa:** error 0,517 contra 0,991 sin reconstruir (1 = no mejor que una constante) <sup>13</sup>.
- **Criterio 2, falla:** las mitades coinciden 0,026, cuando el umbral era 0,143; la simulación da 0,185 <sup>14</sup>.
- **Criterio 4:** se recupera la fase, no resolución.




Rojo, 25/09, set 3: foto cruda, brillo y fase reconstruidos de la misma zona de 128  $\mu\text{m}$ .

**Rojo, 25/09, set 1** (otra zona, con mucha más señal en campo oscuro; corrida del 28/09).

- En simulación, con esa señal, todo pasa: error 0,440, mitades 0,191 <sup>15</sup>.
- Con los datos reales no predice nada: 0,998 contra 1,000 sin reconstruir <sup>16</sup>.
- La causa se ve en las fotos. La luz inclinada está dominada por estrías que siguen la dirección de cada LED: luz dispersada por material fuera de foco, en el volumen de la muestra, que el modelo de muestra delgada no tiene. Es la explicación más directa de la "luz de más en campo oscuro" que también aparece, en menor medida, en el set 3.

Rojo, 25/09, dos zonas de la misma muestra: en la zona 1 el modelo no puede explicar la luz inclinada

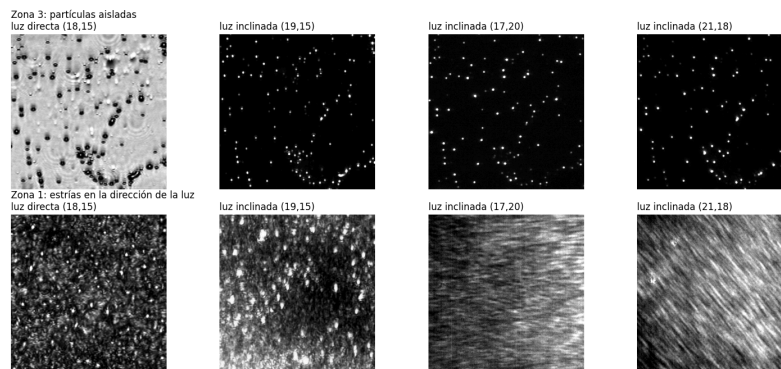


Las dos zonas del 25/09 con los mismos LEDs: en la zona 3, partículas aisladas; en la zona 1, estrías en la dirección de la luz.

Los tres colores del mismo campo, 28/09. Es la primera prueba multiespectral con datos reales.

- Las fotos crudas de los tres colores coinciden entre sí (correlación de 0,71 a 0,78) <sup>17</sup>: es el mismo campo.
- Las reconstrucciones solo coinciden dentro de la banda que el objetivo ya ve (hasta 0,52) <sup>18</sup>, y casi nada con todo el detalle (hasta 0,06) <sup>19</sup>. El detalle que agrega el programa no es el mismo en los tres colores, así que no es de la muestra. En ningún color coinciden tampoco las mitades (verde: 0,024) <sup>20</sup>.
- Solo el verde, el color enfocado, se parece a la muestra. En rojo y azul las partículas salen agrandadas y con textura de red, y reenfoarlos numéricamente no lo corrige.
- El rojo predice apenas las fotos no vistas: 0,901 contra 0,992 sin reconstruir <sup>21</sup>.

28/09, mismo campo en los tres colores: rojo y azul reenfocados numéricamente al plano del verde

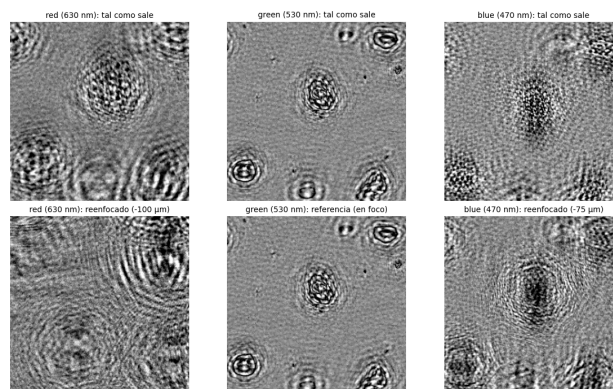

28/09, el mismo campo en los tres colores: arriba, tal como sale cada reconstrucción; abajo, rojo y azul reenfocados numéricamente. Solo el verde (en foco) muestra partículas nítidas.

Otros dos indicios del mismo tipo:

- La altura no se puede fijar desde las imágenes. Con datos reales, el error sigue bajando, con altibajos, hasta  $z = 115$  mm, donde llega a 0,437 <sup>22</sup>. En la simulación, el mínimo cae en el valor verdadero:  $z$  está compensando un error del modelo.

- Poco solapamiento entre LEDs vecinos: solo 31 %<sup>23</sup>, en el límite bajo de lo recomendado para FPM.

## 6. Conclusión respecto del objetivo, y próximos pasos

---

El pipeline existe y funciona **en simulación**: por color, multiespectral y con agentes. Con datos reales se llegó a reconstruir la fase de un color. **El paso multiespectral real no se alcanzó**. La primera comparación entre colores del mismo campo (28/09) muestra que el detalle reconstruido no coincide entre colores. Hacen falta primero reconstrucciones por color confiables, y la muestra real sale del modelo de muestra delgada (set 1). Los agentes fueron más útiles para **auditar** (encontrar errores que nadie había visto) que para **juzgar** resultados reales sin referencia.

Próximos pasos:

1. **Repetir la captura RGB con los oscuros bien tomados y el foco de cada color registrado**, e incluir el foco de cada color en el modelo (desenfoco en la pupila), porque hoy solo el color enfocado da una reconstrucción creíble.
2. **Muestras más delgadas y menos densas**, o un modelo de muestra gruesa (multi-slice); y una muestra con detalle conocido más fino que el límite, como una placa de calibración o las pistas de un CD (1,6  $\mu\text{m}$ ).
3. **Separar volumen de celda**: fotos de la celda solo con DMSO y de la muestra desenfocada. En la misma toma, cuatro LEDs extra fijan la orientación de la matriz con signo.
4. **Más solapamiento**: matriz más lejos o LEDs más juntos.

## 7. Dónde está cada cosa

---

- Código del simulador, la reconstrucción y la cadena multiespectral: `src/ptyco_full_simulator/`. Agentes: `agents/`.
- Reconstrucciones del 25/09: `results/captura_2026-09-25_red/` (set 3) y `results/captura_2026-09-25_red_set1/` (set 1), cada una con su `INFORME.md` y sus `criterios.md`.
- Historia de decisiones y hallazgos: `docs/roadmap_agentic_multispectral_pipeline.md`, secciones 6.x.
- Código previo, copia adaptada y parche: `scripts/lucas_tpwfp/`.
- Qué resolvieron los agentes y qué no: el informe aparte (<https://claude.ai/code/artifact/de7eab31-d9e0-4828-a62d-285ba0d46a98>) y la presentación.
- Este resumen: `report/resumen/` (`make_figs.py`, `build.py`). Cada número tiene su fuente en `data/numbers.json` (anexo).

## Anexo: fuente de cada número

Cada número del texto está en `data/numbers.json`, escrito por `scripts/compute_numbers.py`, y se verifica con `scripts/check_provenance.py` report/resumen/resumen.md.

1. Límite de resolución (Abbe) del objetivo 2.5x NA 0.07 en luz verde, en  $\mu\text{m}$   
`lambda/(2 NA)` con `lambda = 0.53 um` y `NA = 0.07`
2. Captura 08/07/2026, verde, 1 ms: LEDs (de 182) con al menos 10 % del brillo del LED más brillante (`channels.green.census.n_ge_10pct_peak`)  
`results/esferas_2026-07-08/sanity/radiance_census.json`
3. Captura 24/09, verde con enfoque verde, 100 ms: LEDs (de 169) con señal estructural/ruido > 3 (fórmula de `results/captura_2026-09-24/stats_por_led/an.py`)  
`scripts/resumen_numbers.py::leds utiles_2409`
4. Captura 12/12/2025: fila del eje óptico ajustada con el brillo por LED (`main_z76_poly4.row`; la columna es `main_z76_poly4.col`)  
`results/led_geometry_2025-12-12/center_from_radiance.json`
5. Simulación sin ruido con la geometría real (2.5x, z = 75 mm, 100 iteraciones): correlación del brillo reconstruido con el de la muestra (`runs[hoy_2.5x_z75, 100].amplitude_correlation`)  
`results/captura_2026-09-24/synth_overlap/summary.json`
6. La misma simulación: correlación de la fase (`runs[hoy_2.5x_z75, 100].phase_correlation`)  
`results/captura_2026-09-24/synth_overlap/summary.json`
7. La misma simulación con la matriz a 100 mm, es decir más solapamiento entre LEDs vecinos (`runs[2.5x_z100, 100].phase_correlation`)  
`results/captura_2026-09-24/synth_overlap/summary.json`
8. correlation between the milestone-2 coupled pipeline's recovered sample-thickness field and the true field, on a synthetic 3-channel dispersion object reconstructed through the actual Wirtinger flow solver (not injected phase)  
`scripts/compute_numbers.py::multispectral_thickness_correlation`
9. how many times smaller the coupled (unwrap + dispersion-fit) pipeline's thickness RMSE is than a naive baseline that treats each channel's raw wrapped phase as already-unwrapped OPL, on a synthetic dispersion signal large enough to require real unwrapping  
`scripts/compute_numbers.py::unwrapping_error_reduction_factor`
10. Cuántas veces más chico que el paso ePIE unitario era el paso de Wirtinger flow con recortes de 400 px (roadmap sección 6.9)  
`lr_n_px / step_max = (400*400)/20, src/ptyco_full_simulator/reconstruction.py (step_max = 20)`
11. Tamaño de píxel en la muestra de la imagen de referencia Zeiss, en  $\mu\text{m}$   
`~/Documents/AleYLu/elefante/2025-12-02/3x3/3x3_Metadata.tif.xml` (Scaling Distance X = `2.344e-6 m`; objetivo Plan-Neofluar 2.5x/0.075)
12. Error relativo del operador inverso original (`common.py` de `ptyco-full-simulator`) frente al adjunto exacto del operador directo (0 = correcto)  
`scripts/resumen_numbers.py::error_adjunto_original`
13. Rojo 25/09 set 3, método A+init: error de predicción de LEDs no vistos, promedio de 5 folds (`cv.A+init.mean`; 1 = no mejor que una constante)  
`results/captura_2026-09-25_red/resumen_real.json`
14. Rojo 25/09: coincidencia (FRC) entre las dos mitades de LEDs en la banda 0.222-0.45  $1/\mu\text{m}$ , más allá del límite del objetivo (`C2.frc_sel`)  
`results/captura_2026-09-25_red/resumen_real.json`
15. Simulación con los niveles de señal y ruido del set 1 (muestra delgada): error de predicción de LEDs no vistos (`sintetico.C1.sel_mean`)  
`results/captura_2026-09-25_red_set1/veredicto.json`
16. Rojo 25/09 set 1 (otra zona), A+init: error de predicción de LEDs no vistos (`C1.sel_mean`)  
`results/captura_2026-09-25_red_set1/veredicto.json`
17. RGB 28/09: correlación entre colores de la foto cruda (18,15), registrada (mínimo de rojo-verde y azul-verde)  
`results/captura_2026-09-28_rgb/fotos_crudas_entre_colores.json`
18. RGB 28/09: correlación del brillo reconstruido entre colores dentro de la banda del objetivo (máximo de los tres pares; el mínimo es 0.18)  
`results/captura_2026-09-28_rgb/multispectral_por_banda.json`
19. RGB 28/09: la misma correlación con todo el espectro reconstruido (máximo de los tres pares)  
`results/captura_2026-09-28_rgb/multispectral_por_banda.json`
20. RGB 28/09, verde: coincidencia entre mitades de LEDs en la banda  $[2NA/\lambda, 0.45] 1/\mu\text{m}$  (el rojo da 0.014 y el azul 0.009, mismo archivo)  
`results/captura_2026-09-28_rgb/multispectral.json`
21. RGB 28/09, rojo, A+init: error de predicción de LEDs no vistos (5 folds, `C1_rojo`)  
`results/captura_2026-09-28_rgb/multispectral_registrado.json`

22. Rojo 25/09, método B con  $z = 115$  mm: error de predicción de LEDs no vistos (results/captura\_2026-09-25\_red/out/tasks/real\_B\_z115.0\_f\*.json)  
scripts/resumen\_numbers.py::cv\_heldout
23. Solapamiento entre las pupilas de dos LEDs vecinos en el espectro,  $z = 74$  mm, en % del área  
scripts/resumen\_numbers.py::solapamiento\_vecinos\_pct