

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

Controladora Elber — arquivo de histórico .IBR

Arquivo	T.IBR
ID da controladora	1596
Número de série	202112200844
Período inicial	24/08/2026 20:26:48
Período final	01/09/2026 08:05:39
Total de registros	1.454
Setpoint	4.0 °C
Histerese	1.0 °C

Resumo das temperaturas


Indicador	Sensor 1 (°C)	Sensor 2 (°C)
Mínima	3.9	4.5
Máxima	15.3	15.0
Média	4.6	4.9
Leituras	1454	1454

Eventos e estados

Evento	Quantidade de registros	Interpretação
Alarme ativo	62	Registros em que o alarme = ON
Porta aberta	85	Registros em que a porta = aberta
Rede elétrica OFF	74	Registros sem rede elétrica
Compressor ligado	995	Registros com compressor = ON

Faixa de referência calculada: 3.0 °C a 5.0 °C. O Sensor 1 ficou fora dessa faixa em 517 registros.

Gráfico do histórico

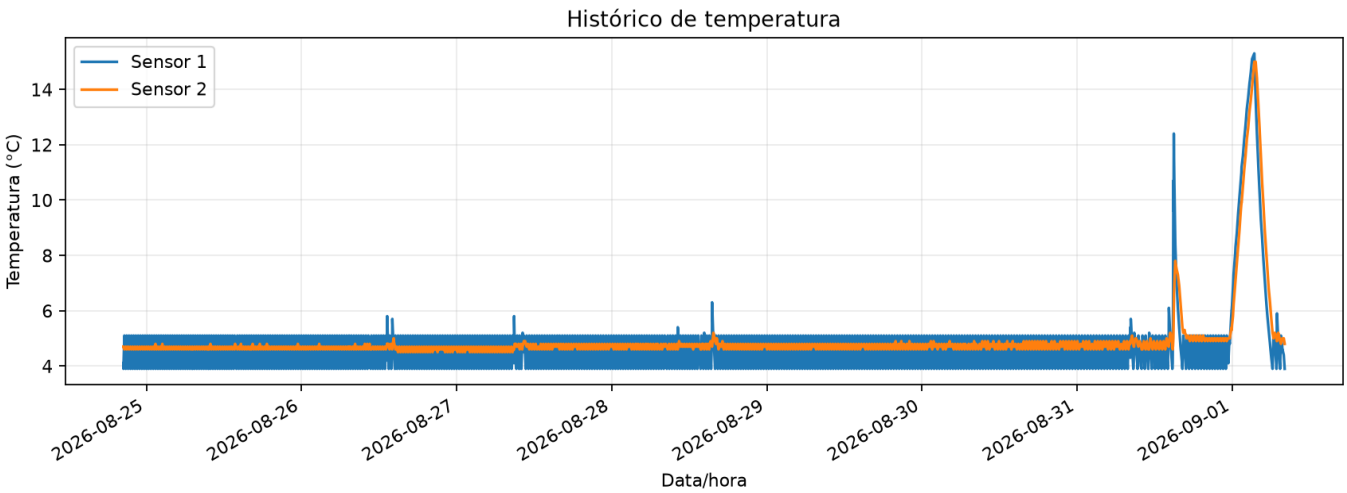

Últimas leituras

Data/hora	T1 °C	T2 °C	Bateria	Rede	Porta	Alarme	Compressor
01/09/2026 04:00:30	11.3	13.5	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:12:34	10.3	12.6	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:24:43	9.3	11.6	13.1	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:36:53	8.6	10.6	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 04:49:03	7.8	9.8	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 05:01:12	7.1	8.9	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 05:13:16	6.4	8.2	13.0	Ligada	Fechada	Ativo	Ligado
01/09/2026 05:25:21	5.8	7.5	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 05:37:25	5.3	6.8	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 05:49:29	4.8	6.3	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:01:33	4.3	5.7	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:13:11	3.9	5.2	13.0	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
01/09/2026 06:22:49	5.1	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:34:52	4.8	5.2	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:46:56	4.1	5.1	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:49:33	3.9	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
01/09/2026 06:52:18	4.1	4.9	13.1	Ligada	Aberta	Normal	Desligado
01/09/2026 06:52:44	5.1	4.9	13.1	Ligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 06:52:53	5.6	4.9	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 06:54:07	5.9	4.9	13.0	Ligada	Aberta	Normal	Ligado
01/09/2026 06:54:13	5.9	4.9	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:06:17	4.9	5.2	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:18:21	4.2	5.0	13.2	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:23:15	3.9	4.9	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Desligado
01/09/2026 07:30:37	5.1	4.8	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:42:40	4.7	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:44:48	4.5	5.0	13.1	Ligada	Aberta	Normal	Ligado

Data/hora	T1 °C	T2 °C	Bateria	Rede	Porta	Alarme	Compressor
01/09/2026 07:45:09	4.6	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 07:57:13	4.4	5.0	13.1	Ligada	Fechada	Normal	Ligado
01/09/2026 08:05:39	3.9	4.8	13.2	Ligada	Fechada	Normal	Desligado

Atenção: 5 registro(s) possuem data/hora anômala e foram mantidos nos dados, mas excluídos do cálculo do período e do gráfico.

Observação: este relatório interpreta o formato do arquivo .IBR fornecido. Os estados Rede, Porta, Alarme e Compressor são apresentados conforme a definição da própria configuração gravada no arquivo.