

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Amylase (AMY) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (U/l)

Gruppe: 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:21:37 · n = 2089 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Amylase (AMY) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (U/l)

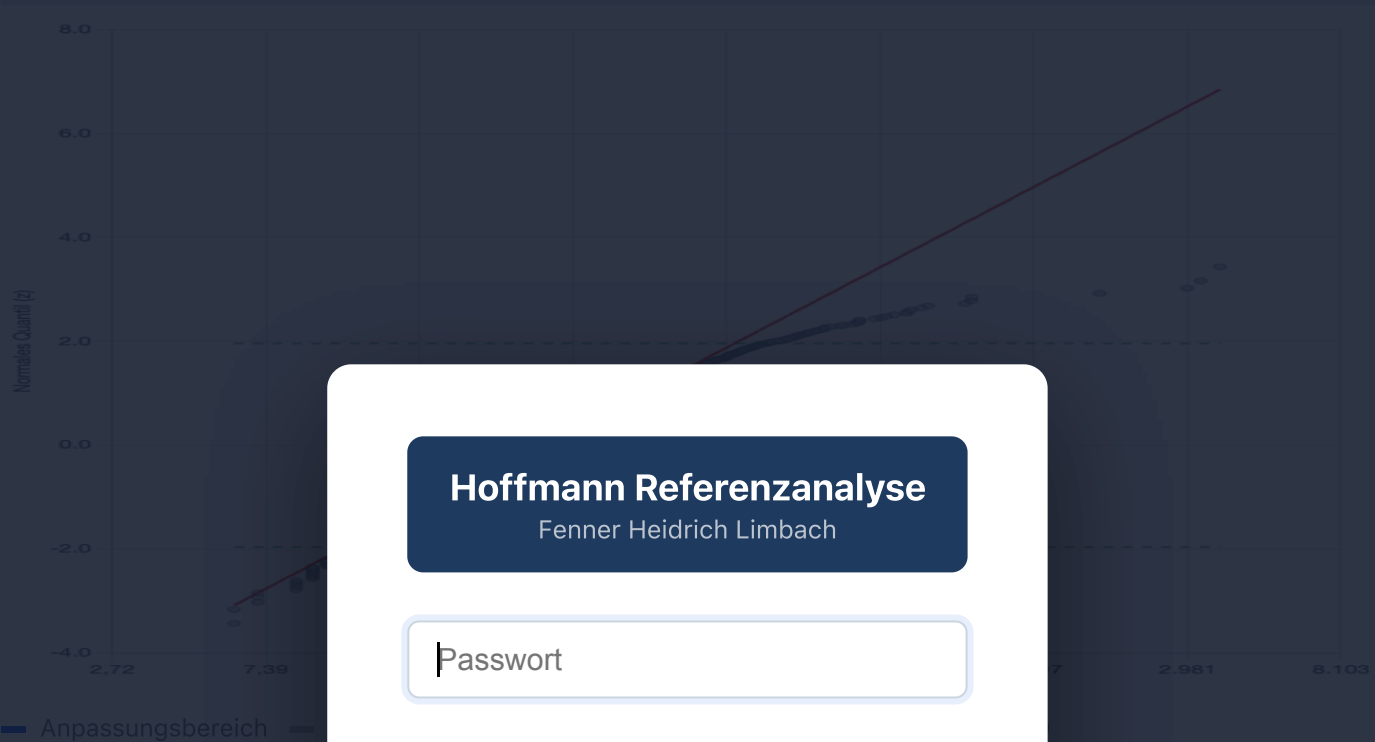

Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

Ergebnisse: Amylase (A

Deskriptive Statistik (Rohda

Anzahl Messwerte (n)	2089
Minimum	6,00 U/l
Maximum	3.681,00 U/l
Median	43,00 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	44,03 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,909 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	17,08 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.9%

Verwendeter Bereich	1838 von 2089 Werten (5.0 % – 93.0 %)
---------------------	---------------------------------------

5. – 97,5. Perzentile)


12,40 – 156,28

U/l

Regression: $z = 1,54708 \cdot x - 5,85535$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung

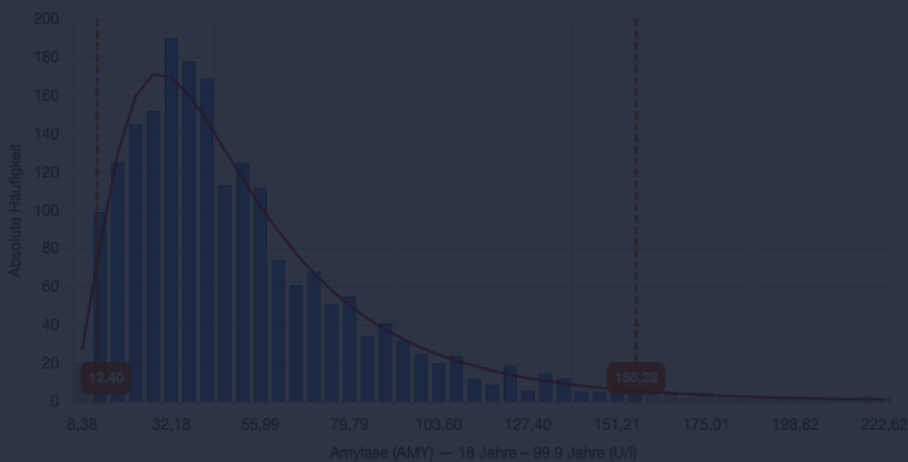

Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Amylase (AMY) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (U/l)

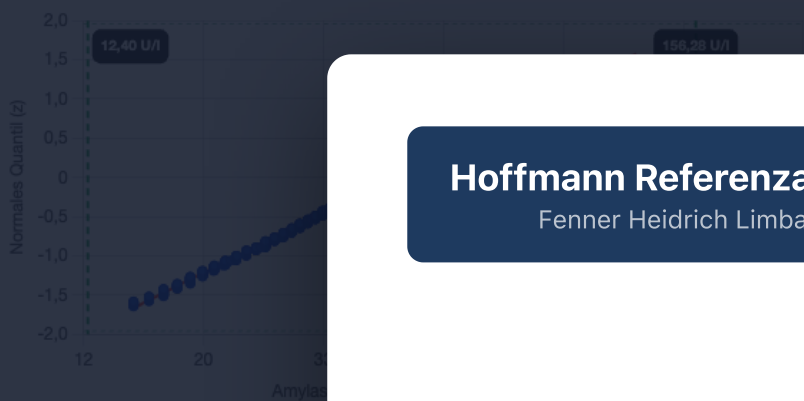

Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Bereich ist dargestellt. Die Referenzgrenzen liegen bei 12,40 U/l und 166,28 U/l. Die Standardabweichung beträgt 1,96 SD.