

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Phosphor anorg. (PO4) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage

Erstellt am 20.5.2026, 11:24:01 · n = 59 Messwerte

Hoffmann-Plot: Phosphor anorg. (PO4) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)

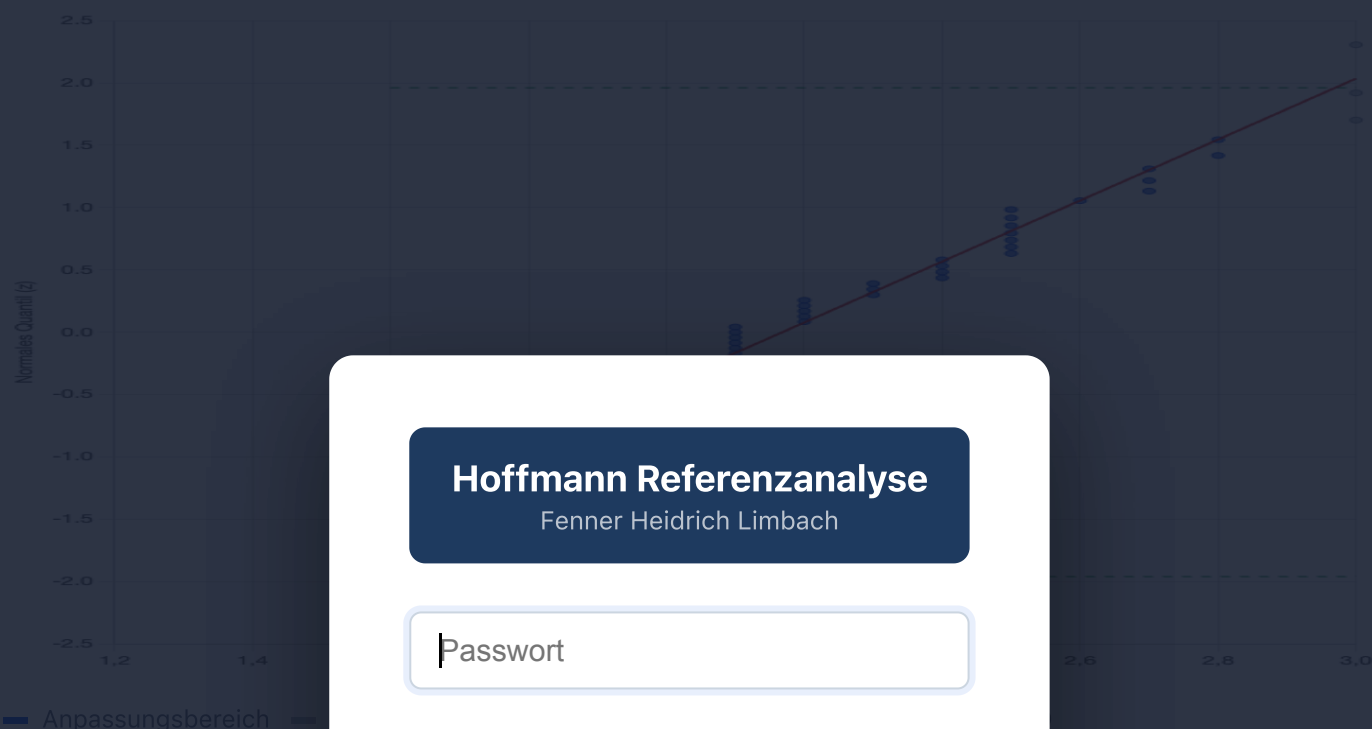

Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Phosphor anorg. (PO4) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	59
Minimum	1,60 mmol/l
Maximum	3,00 mmol/l
Median	2,10 mmol/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	2,17 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,41 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	18,86 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.1%

Verwendeter Bereich 53 von 59 Werten (5.1 % – 94.9 %)

1. – 97.5. Perzentile)

1,37 – 2,97

mmol/l

Regression: $z = 2,44634 \cdot x - 5,30349$


$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

$n = 59 < 120$: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung

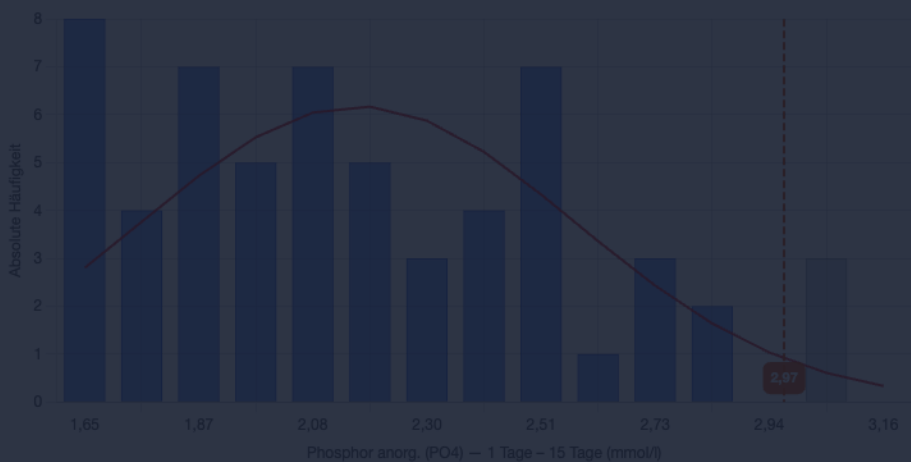

Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Phosphor anorg. (PO4) — 1 Tage – 15 Tage (mmol/l)

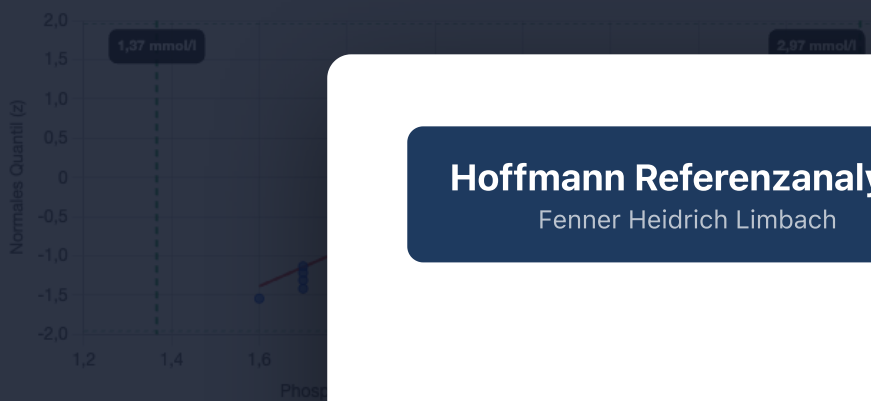

Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... ±1,96 SD.