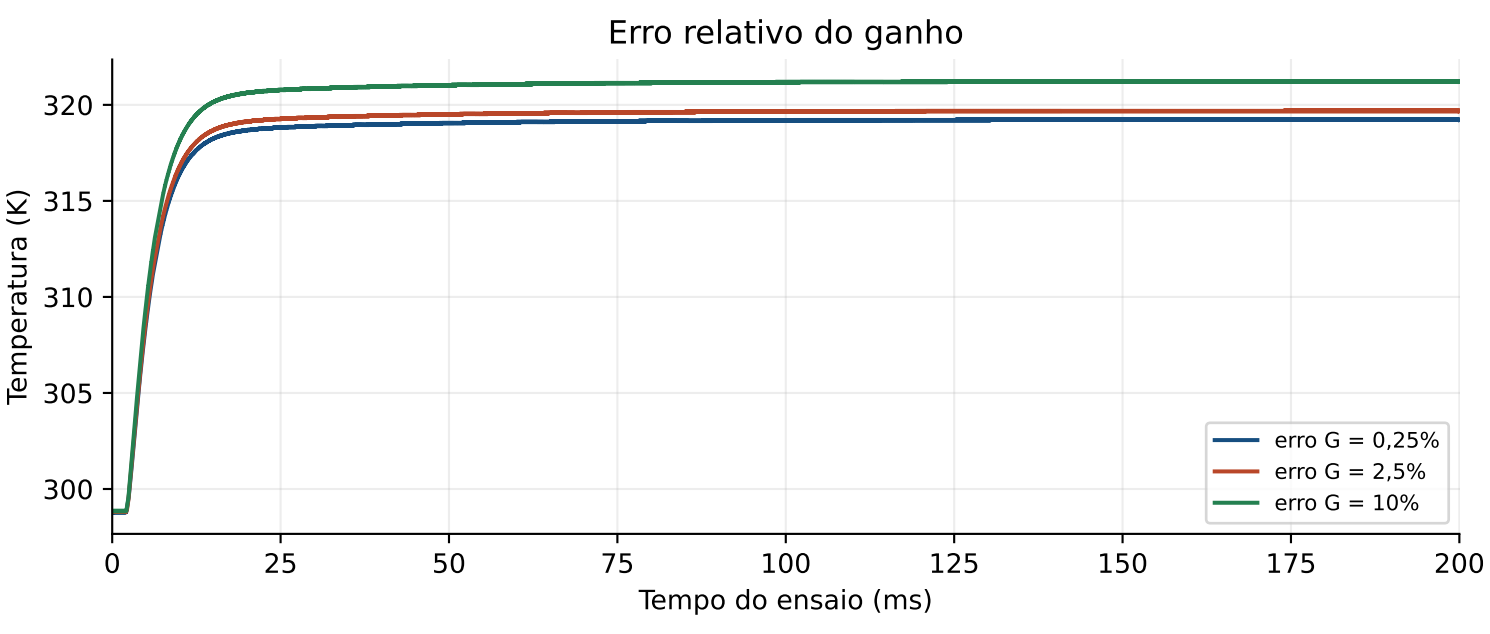

Erro relativo do ganho
Temperatura (K)
300
305
310
315
320
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Tempo do ensaio (ms)
erro G = 0,25%
erro G = 2,5%
erro G = 10%