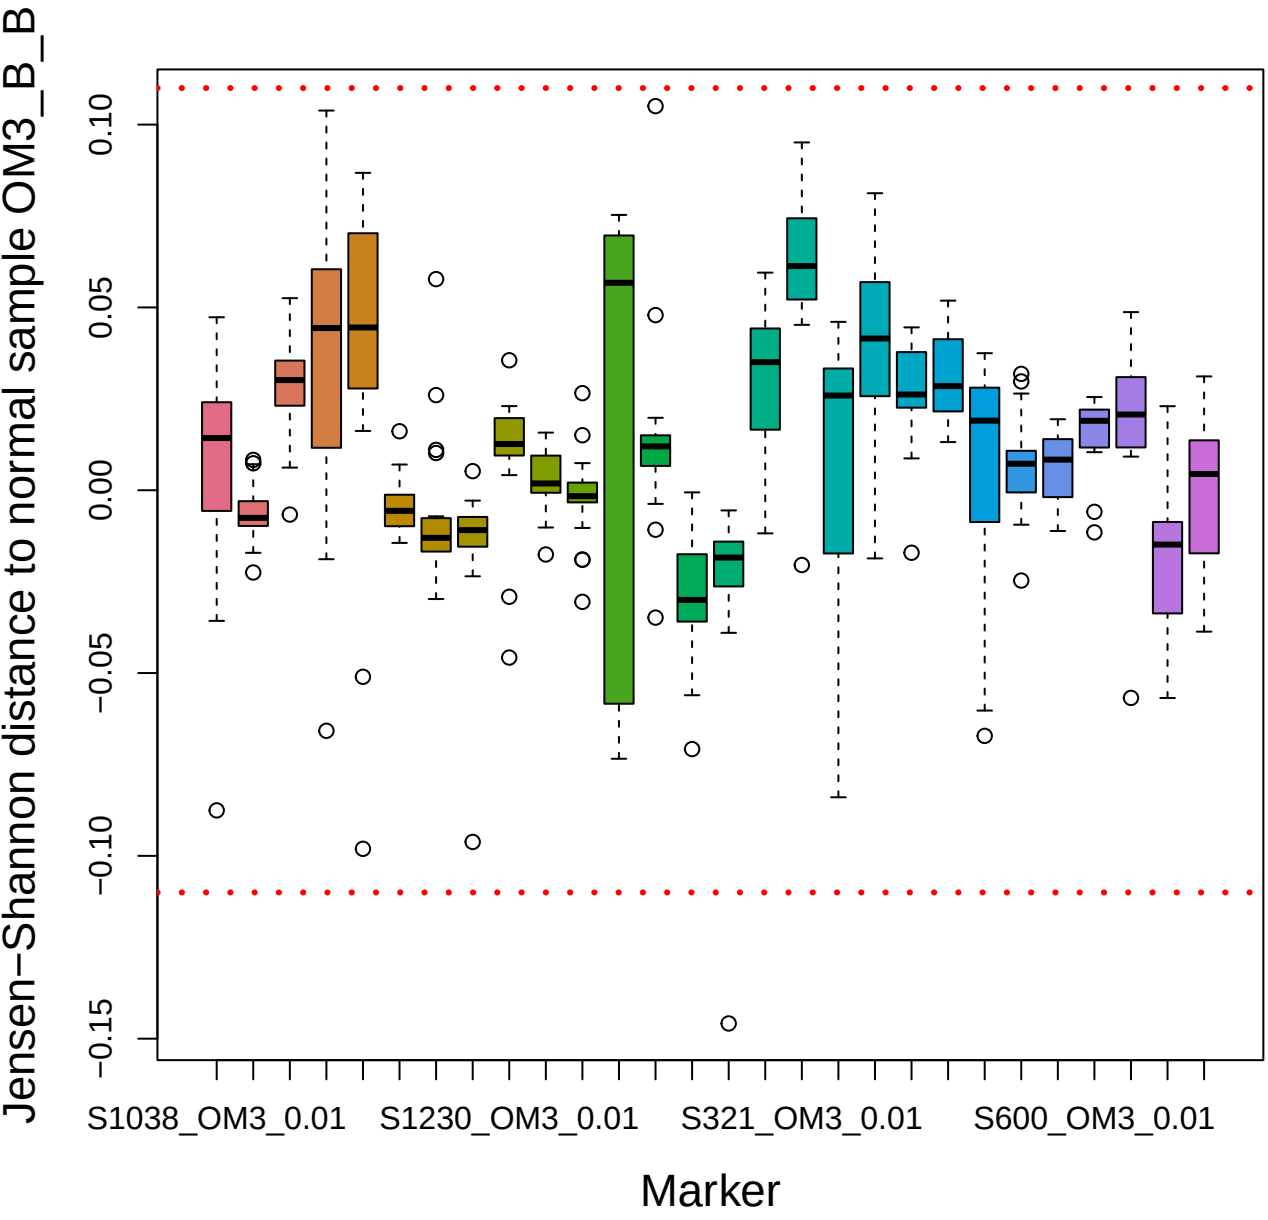
Jensen−Shannon distance to normal sample OM3_B_B
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
S1038_OM3_0.01
S1230_OM3_0.01
S321_OM3_0.01
S600_OM3_0.01
Marker