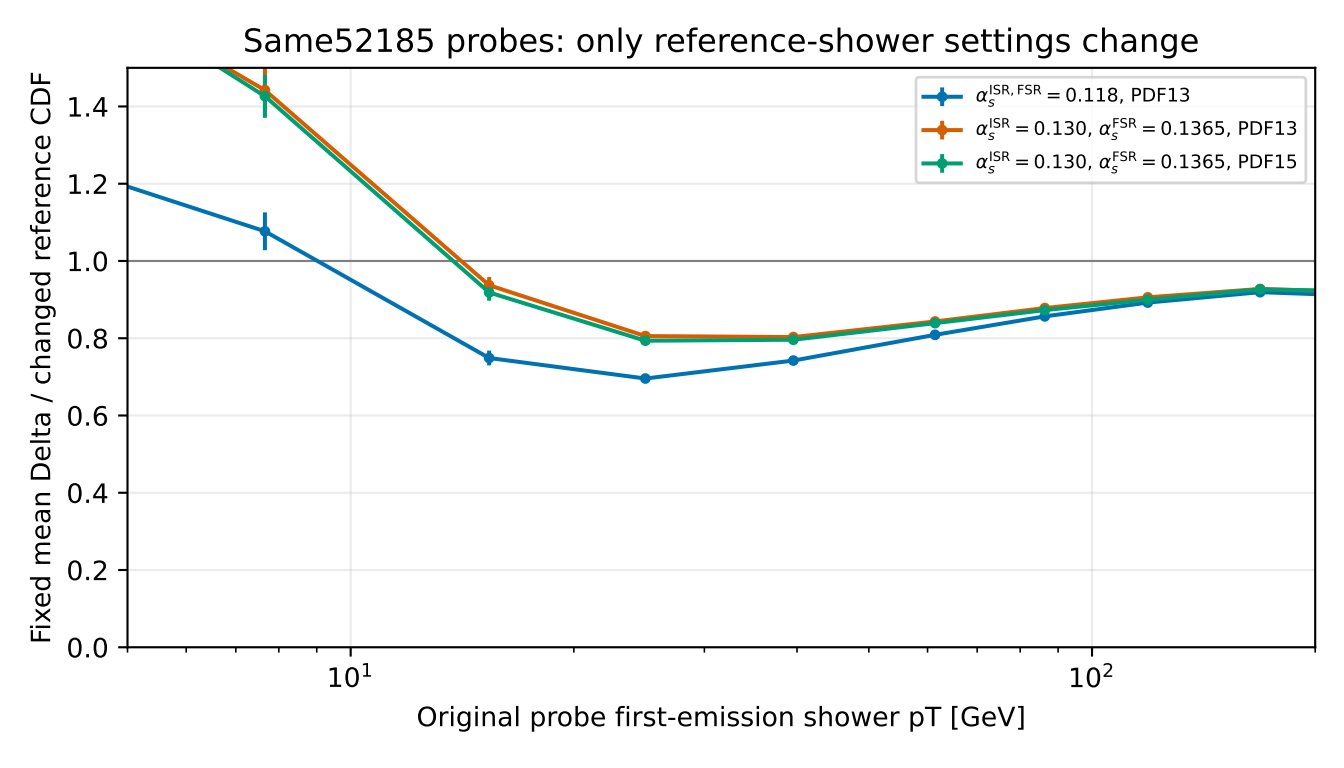
Same52185 probes: only reference-shower settings change
Fixed mean Delta / changed reference CDF
Original probe first-emission shower pT [GeV]
$\alpha_s^{\mathrm{ISR,\,FSR}} = 0.118$, PDF13
$\alpha_s^{\mathrm{ISR}} = 0.130$, $\alpha_s^{\mathrm{FSR}} = 0.1365$, PDF13
$\alpha_s^{\mathrm{ISR}} = 0.130$, $\alpha_s^{\mathrm{FSR}} = 0.1365$, PDF15
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
10^1
10^2