

CAS CL3000P · iç alan 119 × 146 mm · hücre 14 × 15,33 mm · ayraç 1 mm · 8×9 tuş

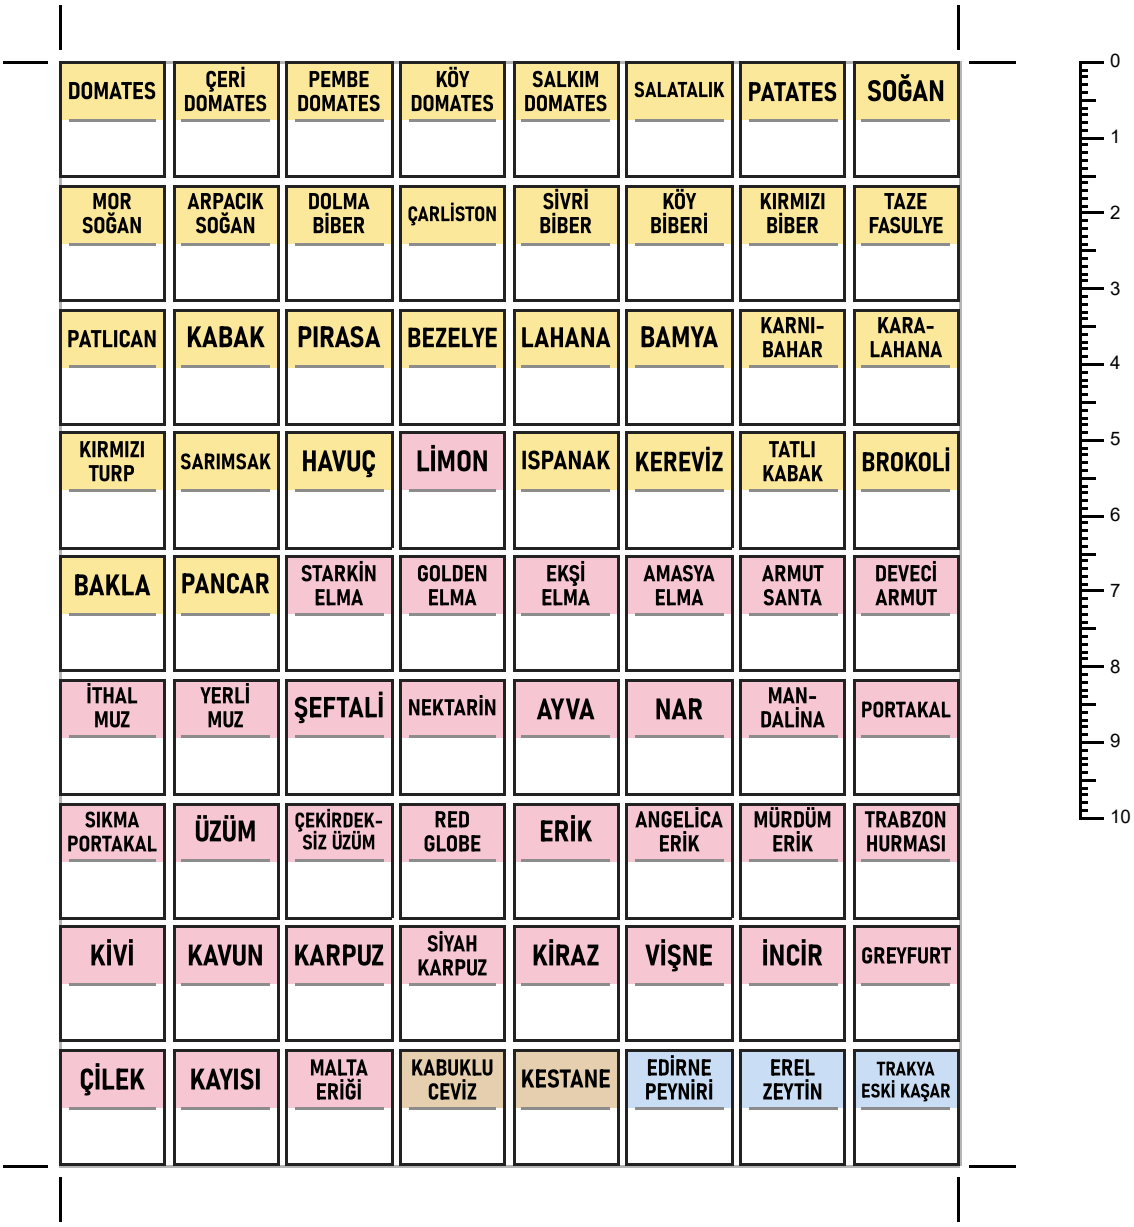



Bu cetvel tam 100 mm (10 cm) olmalı. Değilse ölçtüğün değeri Kalibrasyon kutusuna yaz.
Yazdırırken ölçek %100 (Varsayılan) olsun, "sayfaya sığdır" kapalı olsun.