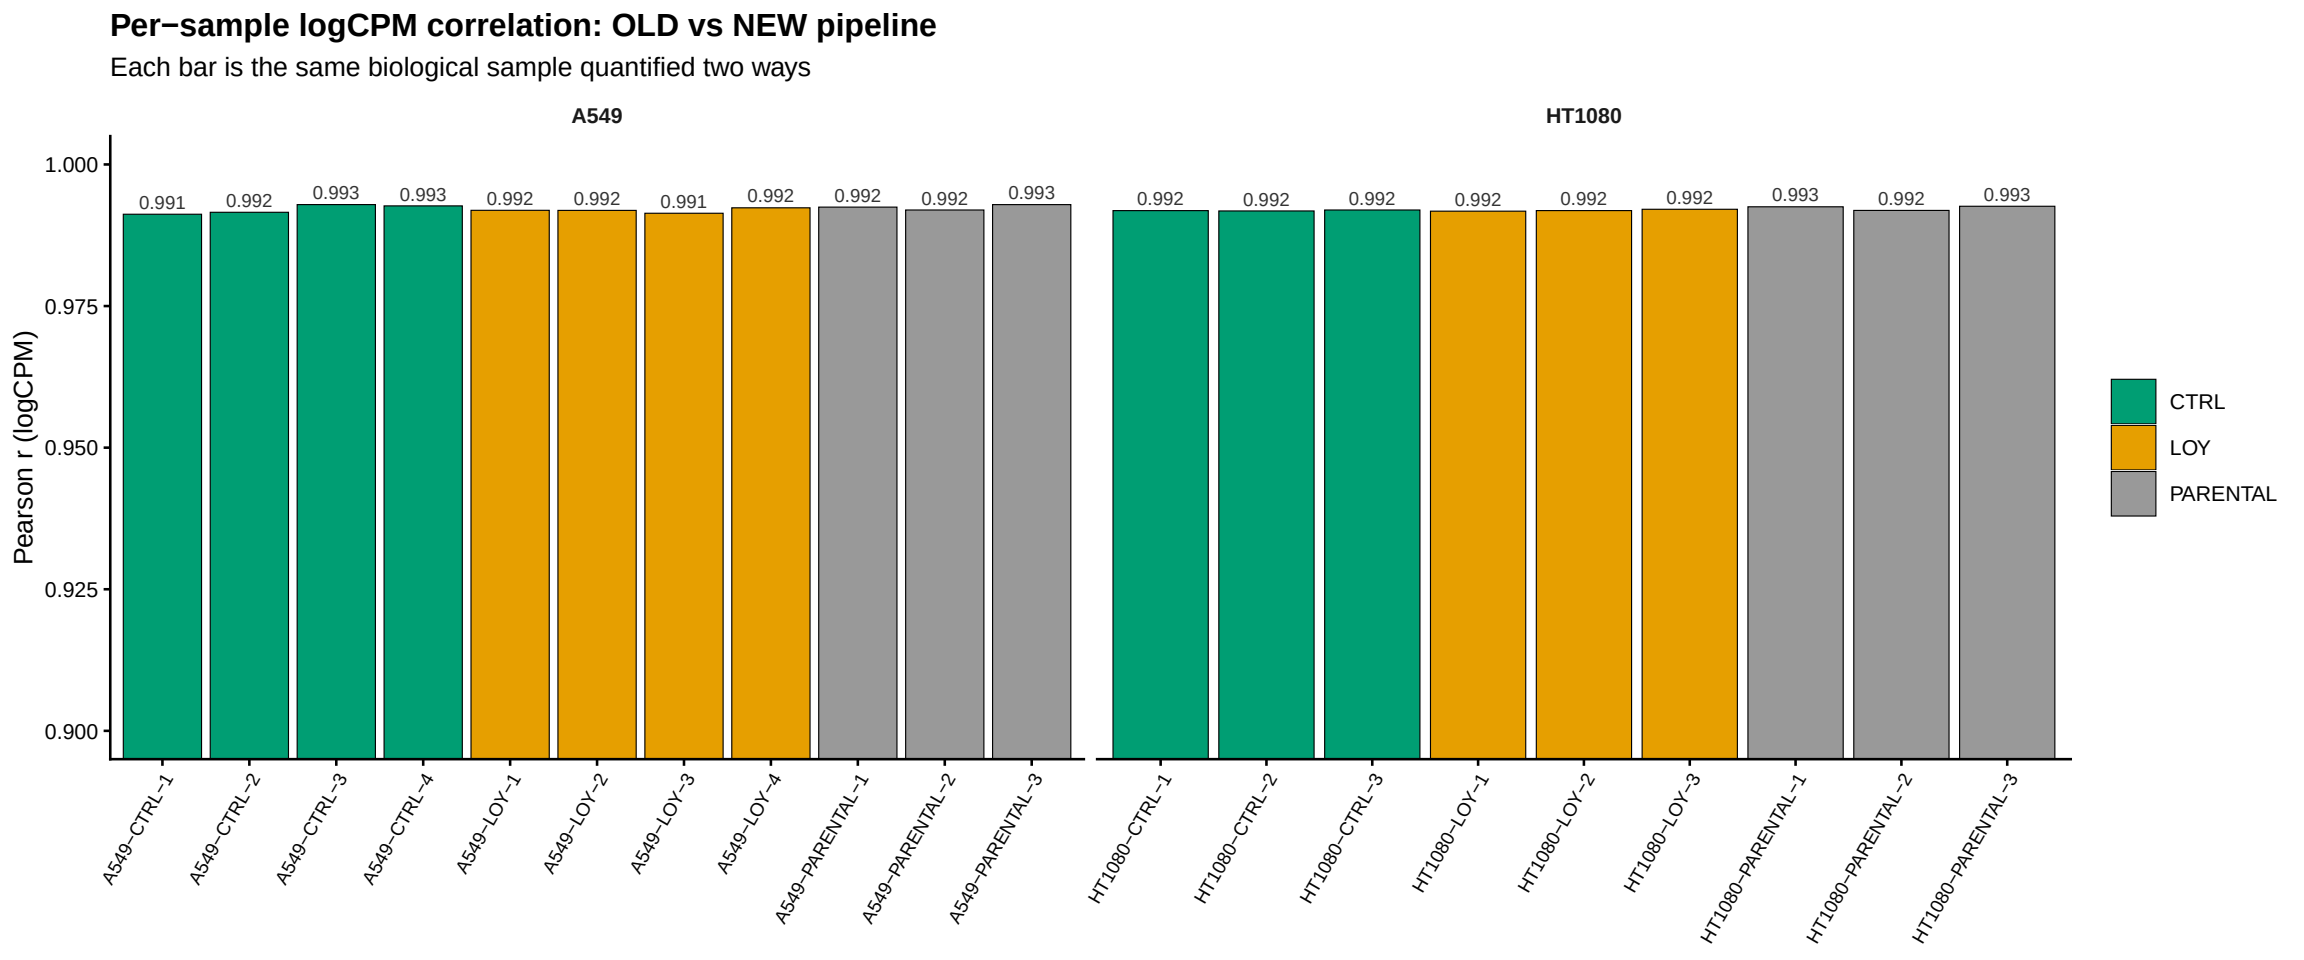
Per−sample logCPM correlation: OLD vs NEW pipeline
Each bar is the same biological sample quantified two ways
A549
HT1080
Pearson r (logCPM)
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.991
0.992
0.993
0.993
0.992
0.992
0.991
0.992
0.992
0.992
0.993
0.992
0.992
0.992
0.992
0.992
0.992
0.993
0.992
0.993
A549−CTRL−1
A549−CTRL−2
A549−CTRL−3
A549−CTRL−4
A549−LOY−1
A549−LOY−2
A549−LOY−3
A549−LOY−4
A549−PARENTAL−1
A549−PARENTAL−2
A549−PARENTAL−3
HT1080−CTRL−1
HT1080−CTRL−2
HT1080−CTRL−3
HT1080−LOY−1
HT1080−LOY−2
HT1080−LOY−3
HT1080−PARENTAL−1
HT1080−PARENTAL−2
HT1080−PARENTAL−3
CTRL
LOY
PARENTAL