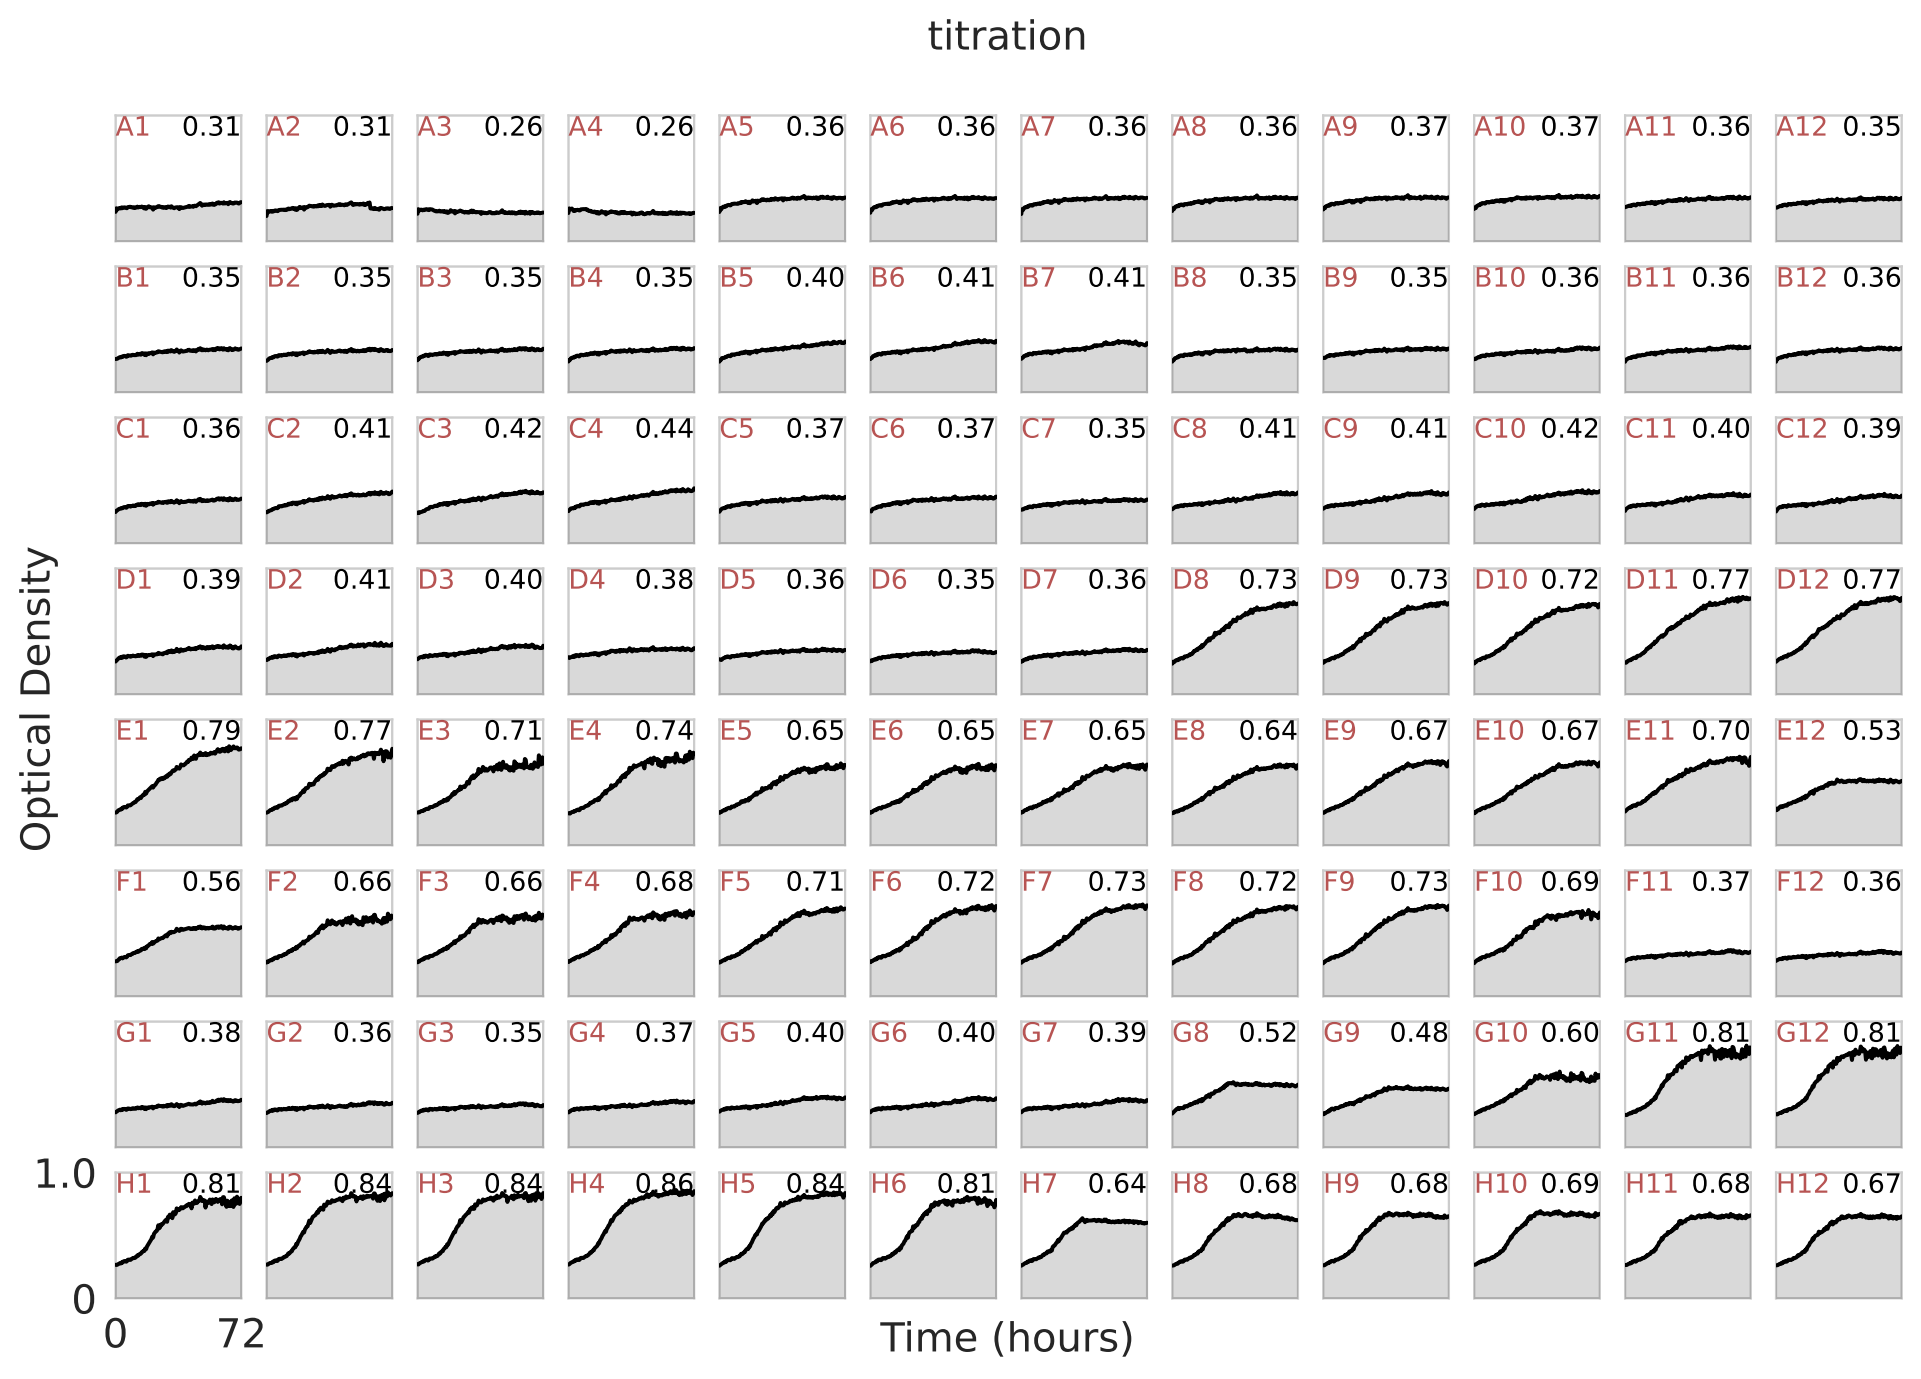

titration
A1 0.31
A2 0.31
A3 0.26
A4 0.26
A5 0.36
A6 0.36
A7 0.36
A8 0.36
A9 0.37
A10 0.37
A11 0.36
A12 0.35
B1 0.35
B2 0.35
B3 0.35
B4 0.35
B5 0.40
B6 0.41
B7 0.41
B8 0.35
B9 0.35
B10 0.36
B11 0.36
B12 0.36
C1 0.36
C2 0.41
C3 0.42
C4 0.44
C5 0.37
C6 0.37
C7 0.35
C8 0.41
C9 0.41
C10 0.42
C11 0.40
C12 0.39
D1 0.39
D2 0.41
D3 0.40
D4 0.38
D5 0.36
D6 0.35
D7 0.36
D8 0.73
D9 0.73
D10 0.72
D11 0.77
D12 0.77
E1 0.79
E2 0.77
E3 0.71
E4 0.74
E5 0.65
E6 0.65
E7 0.65
E8 0.64
E9 0.67
E10 0.67
E11 0.70
E12 0.53
F1 0.56
F2 0.66
F3 0.66
F4 0.68
F5 0.71
F6 0.72
F7 0.73
F8 0.72
F9 0.73
F10 0.69
F11 0.37
F12 0.36
G1 0.38
G2 0.36
G3 0.35
G4 0.37
G5 0.40
G6 0.40
G7 0.39
G8 0.52
G9 0.48
G10 0.60
G11 0.81
G12 0.81
H1 0.81
H2 0.84
H3 0.84
H4 0.86
H5 0.84
H6 0.81
H7 0.64
H8 0.68
H9 0.68
H10 0.69
H11 0.68
H12 0.67
Optical Density
1.0
0
0
72
Time (hours)