



1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																
A						A																																																																																																																																															
B	NOTES: <table><thead><tr><th>SHEET_NAME</th><th>SHT_NUM</th><th>REV</th></tr></thead><tbody><tr><td>BLOCK</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>INPUT</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>HVDC</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>AXIAL DRIVE</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>LVAC</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>CUSTOMER I/O</td><td>7</td><td></td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th>REVISION</th><th>PCN NUMBER</th><th>DATE</th><th>SIGN OFF</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <tr><td>C</td><td colspan="5"></td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td colspan="5"><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>REV</td><td>QTY</td><td>改单号</td><td>FZ2 No.</td><td>签字</td><td>MADE BY</td><td>日期</td><td>DATE</td><td>描述</td><td>DESCRIPTION</td></tr><tr><td colspan="9">GEHW MEDICAL SYSTEMS</td><td>名称</td><td>NGPDU SCH</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>TITLE</td><td></td></tr><tr><td>设计</td><td>DESIGNER</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">比例</td><td>SCALE</td><td rowspan="4">文件代号</td><td rowspan="4">DOC.NO</td></tr><tr><td>审核</td><td>CHECKER</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td>复审</td><td>RECHECKER</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标审</td><td>STANDARD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>批准</td><td>APPROVAL</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">sheet</td><td>1 of 7</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>					SHEET_NAME	SHT_NUM	REV	BLOCK	2		INPUT	3		HVDC	4		AXIAL DRIVE	5		LVAC	6		CUSTOMER I/O	7		REVISION	PCN NUMBER	DATE	SIGN OFF													C						C	D	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>REV</td><td>QTY</td><td>改单号</td><td>FZ2 No.</td><td>签字</td><td>MADE BY</td><td>日期</td><td>DATE</td><td>描述</td><td>DESCRIPTION</td></tr><tr><td colspan="9">GEHW MEDICAL SYSTEMS</td><td>名称</td><td>NGPDU SCH</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>TITLE</td><td></td></tr><tr><td>设计</td><td>DESIGNER</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">比例</td><td>SCALE</td><td rowspan="4">文件代号</td><td rowspan="4">DOC.NO</td></tr><tr><td>审核</td><td>CHECKER</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td>复审</td><td>RECHECKER</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标审</td><td>STANDARD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>批准</td><td>APPROVAL</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">sheet</td><td>1 of 7</td><td></td><td></td></tr></table>																							标记	REV	QTY	改单号	FZ2 No.	签字	MADE BY	日期	DATE	描述	DESCRIPTION	GEHW MEDICAL SYSTEMS									名称	NGPDU SCH										TITLE		设计	DESIGNER				比例				SCALE	文件代号	DOC.NO	审核	CHECKER								复审	RECHECKER				标审	STANDARD				批准	APPROVAL				sheet				1 of 7		
SHEET_NAME	SHT_NUM	REV																																																																																																																																																			
BLOCK	2																																																																																																																																																				
INPUT	3																																																																																																																																																				
HVDC	4																																																																																																																																																				
AXIAL DRIVE	5																																																																																																																																																				
LVAC	6																																																																																																																																																				
CUSTOMER I/O	7																																																																																																																																																				
REVISION	PCN NUMBER	DATE	SIGN OFF																																																																																																																																																		
C						C																																																																																																																																															
D	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>REV</td><td>QTY</td><td>改单号</td><td>FZ2 No.</td><td>签字</td><td>MADE BY</td><td>日期</td><td>DATE</td><td>描述</td><td>DESCRIPTION</td></tr><tr><td colspan="9">GEHW MEDICAL SYSTEMS</td><td>名称</td><td>NGPDU SCH</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>TITLE</td><td></td></tr><tr><td>设计</td><td>DESIGNER</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">比例</td><td>SCALE</td><td rowspan="4">文件代号</td><td rowspan="4">DOC.NO</td></tr><tr><td>审核</td><td>CHECKER</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td>复审</td><td>RECHECKER</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标审</td><td>STANDARD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>批准</td><td>APPROVAL</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">sheet</td><td>1 of 7</td><td></td><td></td></tr></table>																							标记	REV	QTY	改单号	FZ2 No.	签字	MADE BY	日期	DATE	描述	DESCRIPTION	GEHW MEDICAL SYSTEMS									名称	NGPDU SCH										TITLE		设计	DESIGNER				比例				SCALE	文件代号	DOC.NO	审核	CHECKER								复审	RECHECKER				标审	STANDARD				批准	APPROVAL				sheet				1 of 7																																																				
标记	REV	QTY	改单号	FZ2 No.	签字	MADE BY	日期	DATE	描述	DESCRIPTION																																																																																																																																											
GEHW MEDICAL SYSTEMS									名称	NGPDU SCH																																																																																																																																											
									TITLE																																																																																																																																												
设计	DESIGNER				比例				SCALE	文件代号	DOC.NO																																																																																																																																										
审核	CHECKER																																																																																																																																																				
复审	RECHECKER																																																																																																																																																				
标审	STANDARD																																																																																																																																																				
批准	APPROVAL				sheet				1 of 7																																																																																																																																												

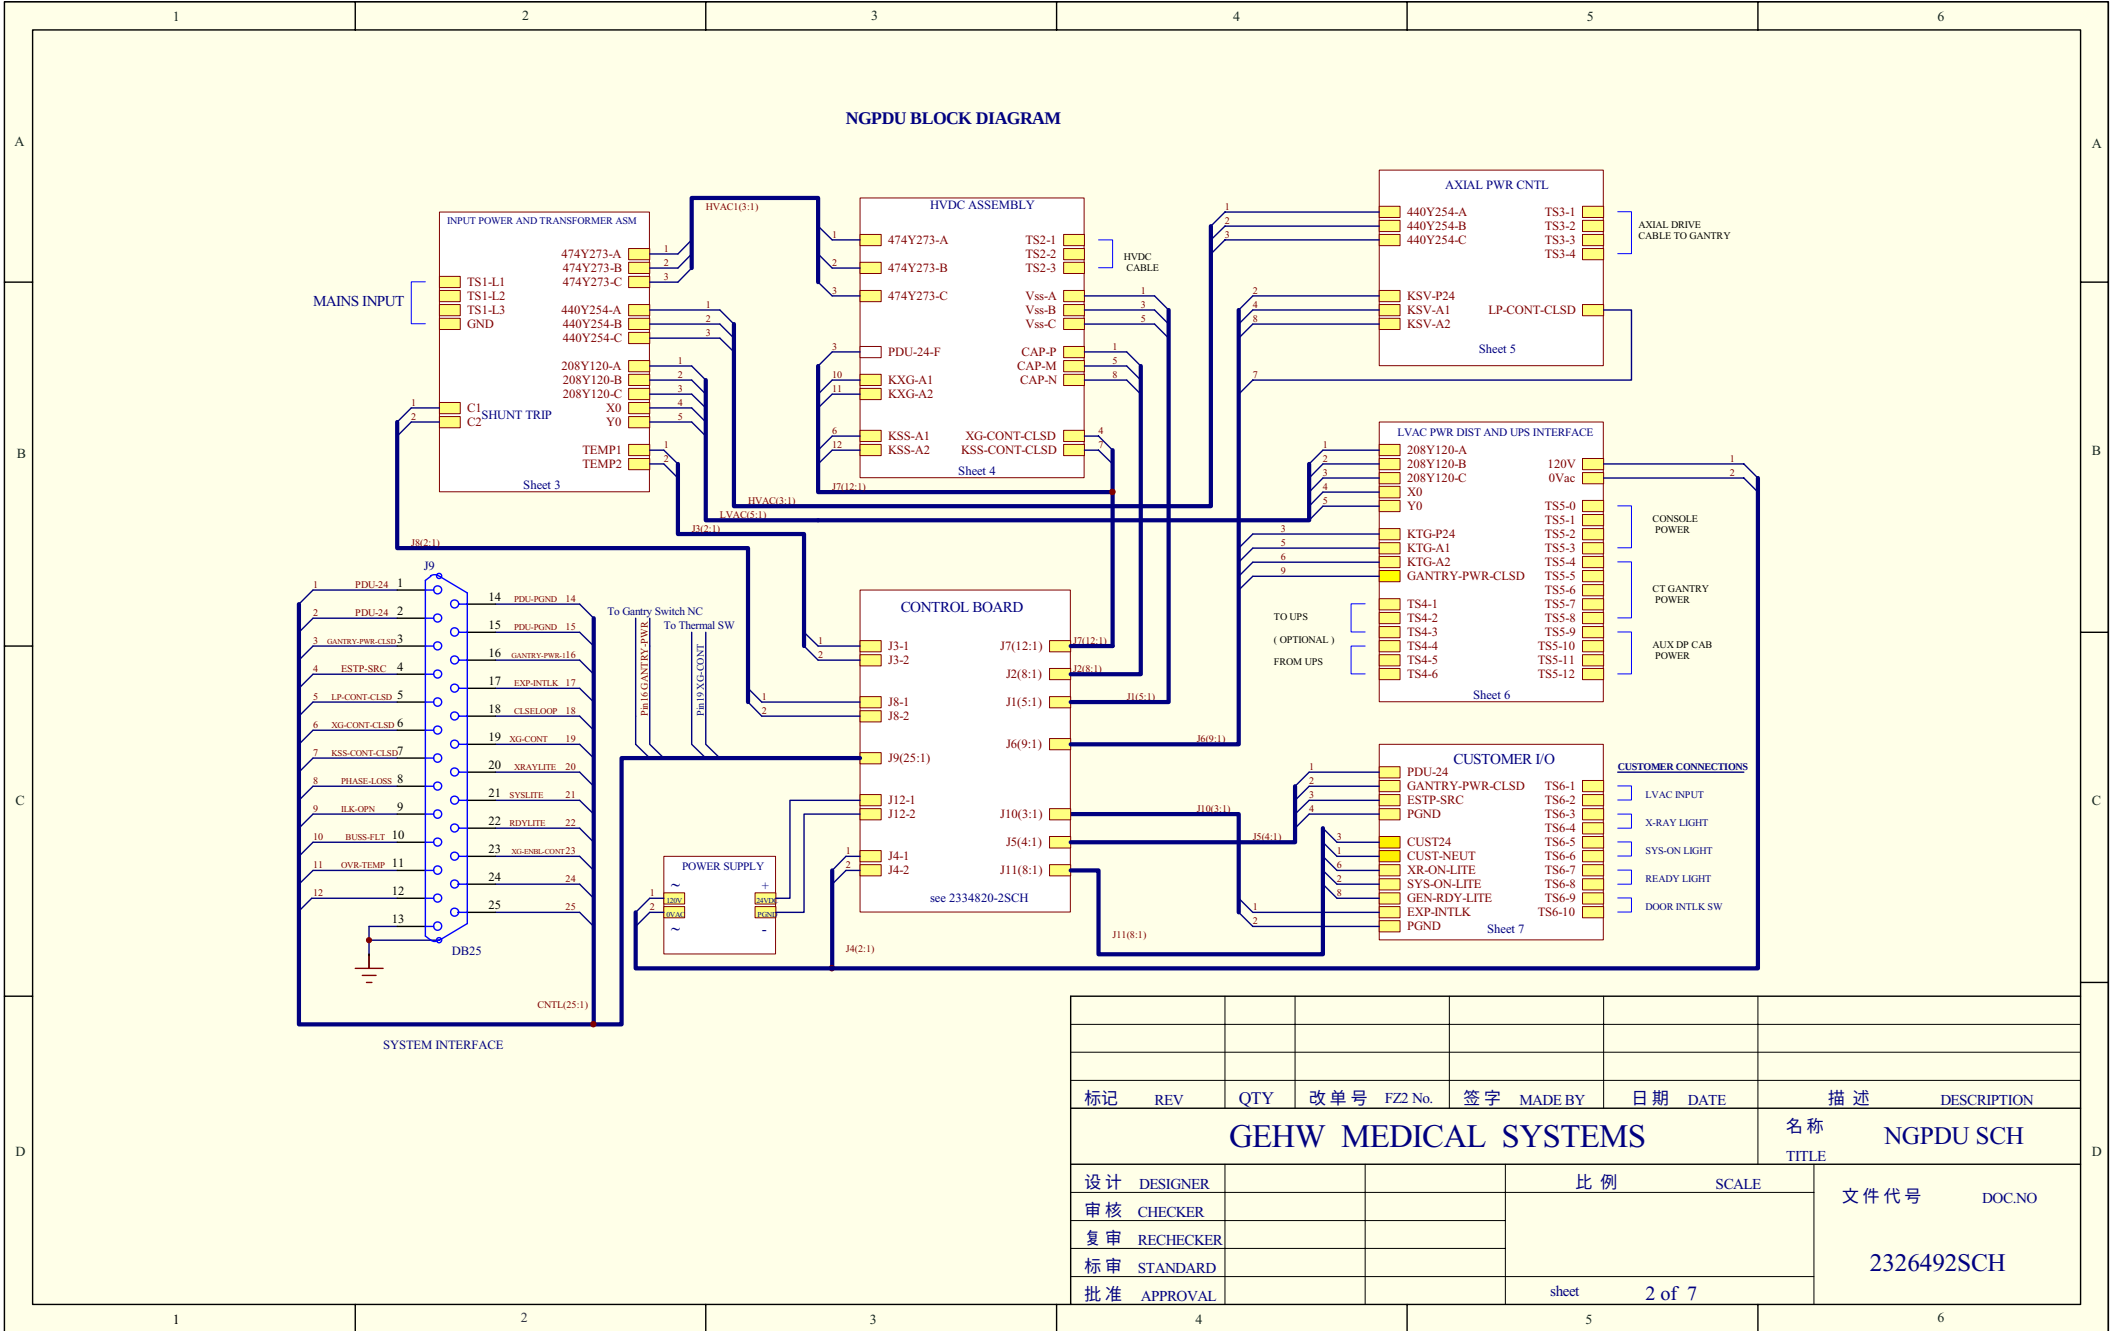

C1,C2,C3 = 6.0 UF, 370VAC
LOADING WYE CONFIGURATION
REQUIRED FOR EMC PREVENTION
GE97F9595, OR MALLORY C32FD3706 OR EQUAL.

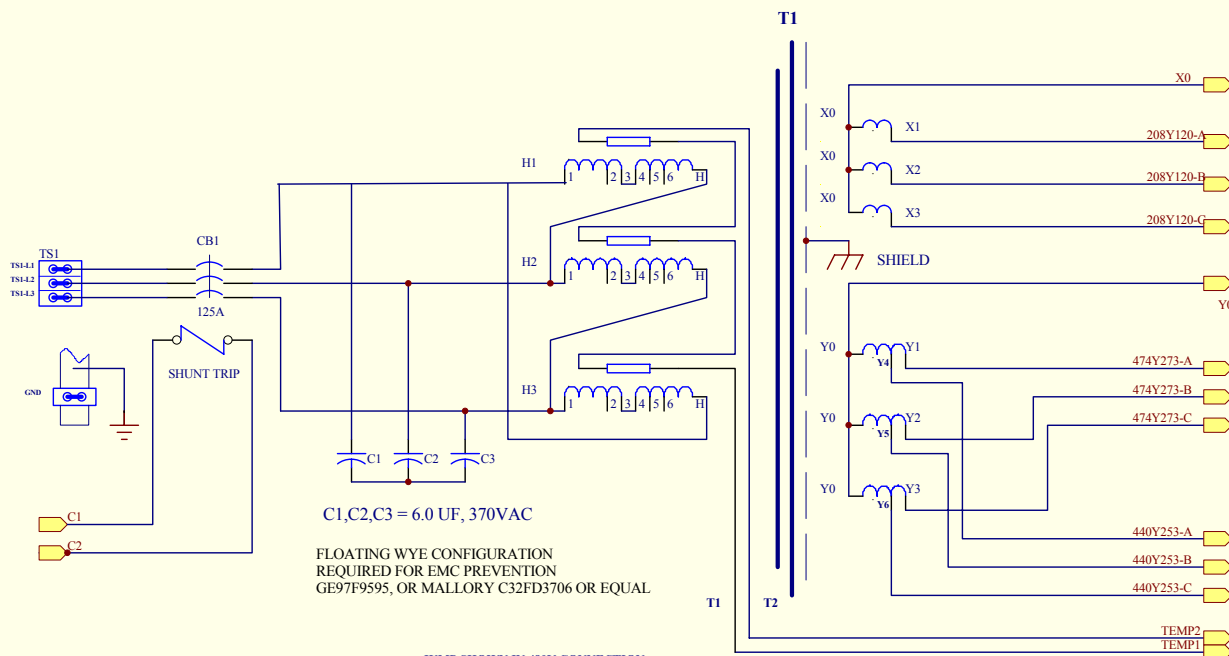

JUMP SHOWN IN 480V CONNECTION

PRIMARY		SECONDARY	
VOLTAGE	LEAD CONNECTION	VOLTAGE	LEAD CONNECTION
380v	2-6	208Y120	X1,X2,X3,X0
400v	2-5		
420v	2-4		
440v	3-6		
460	3-5		
480v	3-4	474Y273	Y1,Y2,Y3,Y0
		440Y253	Y4,Y5,Y6,Y0

标记	REV	QTY	改单号 FZ2 No.	签字 MADE BY	日期 DATE	描述	DESCRIPTION
GEHW MEDICAL SYSTEMS						名称 TITLE	NGPDU SCH
设计	DESIGNER			比例		文件代号	DOC.NO
审核	CHECKER						
复审	RECHECKER						
标审	STANDARD						
批准	APPROVAL			sheet	3 of 7		2326492SCH

